



QuikRead go Plus Instrument

155450-1

- Slovenčina
- Srpski
- Hrvatski
- Ελληνικά

	Pojasnilo simbolov	Objašnjenje simbola	Objašnjenje simbola	Επεξηγήσεις συμβόλων
	In vitro dijagnostični medicinski pripomoček	In vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo	In vitro dijagnostički medicinski proizvod	Ιατροτεχνολογικό βιόθημα που χρησιμοποιείται για διάγνωση in vitro
	Pripomoček za testiranje ob pacientu	Proizvod za testiranje u blizini pacijenta	Proizvod za testiranje u blizini pacijenta	Τεχνολογικό προϊόν για διαγνωστικές εξετάσεις κοντά στον ασθενή
	Serijska številka	Serijski broj	Serijski broj	Σειριακός αριθμός
	Kataloška številka	Kataloški broj	Kataloški broj	Αριθμός καταλόγου
	Proizvajalec	Proizvođač	Proizvođač	Катаструсастија
	Datum proizvodnje	Datum proizvodnje	Datum proizvodnje	Ημερομηνία Παραγωγής
	Vsebina	Sadržaj	Sadržaj	Περιεχόμενα
	Analizator	Instrument	Aparat	Όργανο
	Električni priključek	Napajanje električnom energijom	Napajanje	Παροχή ρεύματος
	Električni kabel	Mrežni kabl	Mrežni kabel	Κεντρικό καλώδιο
	Sledi navodilu za uporabo	Pogledajte uputstvo za upotrebu	Pogledajte uputstvo za uporabu	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Pozor	Oprez	Oprez	Προσοχή
	Temperaturne meje	Temperaturna granica	Temperaturna granica	Περιορισμοί θερμοκρασίας
	Lomljivo, ravnaj previdno	Lomljivo, rukovati pažljivo	Lomljivo, pažljivo rukovati	Εύθραυστο, να χρησιμοποιείται με προσοχή
	Čuvaj na suhem	Čuvati na suvom	Čuvati na suhom	Na διατηρείται στεγνό
	China RoHS GB/T 26572	China RoHS GB/T 26572	China RoHS GB/T 26572	China RoHS GB/T 26572
	Odpadni električni in elektronski opremi	Otpad električne i elektronske opreme	Otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi	τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

	Pojasnilo simbolov	Objašnjenje simbola	Objašnjenje simbola	Επεξηγήσεις συμβόλων
	Ta izdelek izpoljuje zahteve predpisov Evropskega parlamenta in Sveta o <i>in vitro</i> diagnostičnih medicinskih pripomočkih	Ovaj proizvod ispunjava zahteve Evropskog parlamenta i Saveta o <i>in vitro</i> dijagnostičkim medicinskim sredstvima	Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve Europskog parlamenta i Vijeća za <i>in vitro</i> dijagnostičke medicinske uređaje	Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα <i>in vitro</i> διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
	Pooblaščeni zastopnik v Švici	Ovlašteni zastupnik u Švicarskoj	Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελβετία
	USB	USB	USB	USB
	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
	Moč	Struja	Struja	Iσχύς
	Gumb za vklop/izklop	Prekidač za uključivanje-isključivanje	Prekidač za uklj./isklj.	Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
	Omejitev	Ograničenje	Ograničenje	Περιορισμός

	Okrajšava	Skrácenica	Kratica	Συντομογραφία
HIS	Bolnični informacijski sistem	Bolnički informacioni sistem (eng. Hospital information system)	Bolnički informacijski sustav	Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου
ID	Identifikator	Identifikator	Identifikacijska oznaka	Αναγνωριστικό
IP	Internetni protokol	Internet protokol	Internetski protokol	Πρωτόκολλο διαδικτύου
LIS	Laboratorijski informacijski sistem	Laboratorijski informacioni sistem	Laboratorijski informacijski sustav	Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου
POCT01	Povezljivost Point-of-Care	Povezanost na mestu zdravstvene njege	Povezivanje na mjestu skrbi	Συνδεσμότητα παρά την κλίνη του ασθενούς
QC	Kontrola kakovosti	Kontrola kvaliteta	Kontrola kvalitete	Ποιοτικός έλεγχος
SVHC	Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljjenost	Supstance koje izazivaju veliku zabrinutost	Posebno zabrinjavajuće tvari	Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
USB	Univerzalno serijsko vodilo	Univerzalna serijska magistrala	Univerzalna serijska sabirница	Ενιαίος σειριακός δίσιλος

O teh navodilih za uporabo

Navodila za uporabo analizatorja QuikRead go Plus Instrument vas bodo vodila pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju analizatorja. V navodilih za uporabo so pojasnjeni tudi načelo testiranja, funkcije kontrole kakovosti in pomočki za odpravljanje težav.

Pred analizo vzorcev bolnika ali vzorcev za kontrolno kakovost natančno preberite navodila za uporabo in vse dokumente z navodili za uporabo reagenta QuikRead go, ki so priloženi vsakemu kompletu reagensa.

Simboli

Embalaža analizatorja QuikRead go Plus Instrument in simboli zaščite naprave, glejte stran 2.


O ovom Uputstvu za upotrebu

Uputstvo za upotrebu za QuikRead go Plus Instrument će vas usmeravati pri instalaciji, upotrebi i održavanju vašeg instrumenta. Uputstvo za upotrebu takođe objašnjava princip testiranja, funkcije kontrole kvaliteta i pomaže kod rešavanja problema.

Prije analize uzorka pacijenata ili uzorka za kontrolu kvaliteta, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sve dokumente s uputama za uporabu reagensa QuikRead go isporučene sa svakim kompletom reagensa.

Simboli

Simboli pakovanja i zaštite sredstva za QuikRead go Plus Instrument, pogledajte stranicu 2.



O ovim uputama za uporabu

Upute za uporabu proizvoda QuikRead go Plus Instrument vodit će vas u instalaciji, upotrebi i održavanju instrumenta. U uputama za uporabu objašnjeno je i načelo testiranja, funkcije kontrole kvalitete i pomažu u rješavanju problema.

Prije analize uzorka pacijenata ili uzorka za kontrolu kvalitete, pažljivo pročitajte upute za uporabu i sve dokumente s uputama za uporabu reagensa QuikRead go isporučene sa svakim kompletom reagensa.

Simboli

Simbole na ambalaži i kućištu proizvoda QuikRead go Plus Instrument pogledajte na 2. stranici.

Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης

Στις οδηγίες χρήσης του QuikRead go Plus Instrument, παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου σας. Στις οδηγίες χρήσης, εξηγούνται επίσης η αρχή της δοκιμασίας, οι λειτουργίες πιοιτικού ελέγχου και παρέχεται βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πριν από την ανάλυση δειγμάτων ασθενών ή δειγμάτων πιοιτικού ελέγχου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και όλα τα έγγραφα οδηγιών χρήσης των αντιδραστηρίων QuikRead go που παρέχονται με κάθε κιτ αντιδραστηρίου.

Σύμβολα

Σύμβολα της συσκευασίας και της θωράκισης της συσκευής QuikRead go Plus Instrument. Ανατρέξτε στη σελίδα 2.

Navodila za uporabu – Slovenščina 6

Upustvo za upotrebu – Srpski 30

Upute za uporabu – Hrvatski 54

Οδηγίες χρήσης – Ελληνικά 78

VSEBINA

1 UVOD	7
Namen uporabe.....	7
QuikRead go Plus Instrument	7
Varnostne informacije	7
Previdnostni ukrepi in omejitve	7
2 ZAČETEK UPORABE	8
Odstranjevanje embalaže.....	8
Dodatna oprema.....	8
Deli analizatorja QuikRead go	
Plus Instrument	8
Dviganje ali prevažanje analizatorja	
QuikRead go Plus Instrument	10
Lokacija in okolje	10
Med uporabo	10
Med prevozom in skladiščenjem	10
Napajalni kabel in baterija	10
Konektorji in kabli	10
Prikllop napajalnega kabla	10
Vstavljanje akumulatorske baterije	10
VKLOP in IZKLOP	10
Vklap	10
Izklop napajanja.....	10
Uporaba zaslona na dotik	10
Prva nastavitev	11
Uporabniški vmesnik	12
Ikone območja stanja	12
Meni	13
Obvestila	13
Izbira jezika	13
Splošne nastavitev	14
3 DELOVANJE ANALIZATORJA....	14
Izvajanje merjenja	14
Merjenje vzorca bolnika	14
Prikaz rezultatov vzorca bolnika	15
Podrobni prikaz rezultatov vzorca	15
4 NASTAVITVE.....	18
Jezik, zaslon, zvok	19
Datum in čas	19
Varčevanje z energijo	19
Merjenje	19
Parametri testa	19
Dodatna oprema	20
Upravljanje uporabnikov	20
Nastavitev uporabnika	20
Nastavitev za bolnika	20
Nastavitev dodatnega ID	20
Povezljivost	21
LIS	21
TCP/IP	21
WLAN	21
5 UPRAVLJANJE KK.....	22
Nastavitev za KK	22
Dodaj novo KK	22
Seznam KK	22
Dodaj novo vialo KK za uporabo	23
6 MENI VZDRŽEVANJA.....	23
Posodobitev programske opreme	23
Dnevnik	23
Dnevnik napak	23
Dnevni revizije na USB	23
Dnevni merjenja na USB	23
Dnevni povezljivosti	23
7 POGLED O TEM	24
8 VZDRŽEVANJE ANALIZATORJA.	24
Umerjanje analizatorja	24
Čiščenje analizatorja	24
Posodobitev programske opreme	24
Menjava baterije ure	24
9 SPECIFIKACIJE ANALIZATORJA.	24
Izjava o skladnosti	24
Tehnične specifikacije	24
Fotometer	24
Zaslon na dotik	25
Dimenzije in zahteve za napajanje	25
Identifikator analizatorja	25
Pomnilnik	26
Napajanje	26
Radijski modul	26
Povezava s sistemom LIS	26
Povezava s sistemom USB	26
Servis	26
Garancija	26
Odstranjevanje	26
Zgodovina revizije	26
10 ODSTRANJEVANJE NAPAK	26
Pravice vlog uporabnika	29

1. UVOD

Namen uporabe

Analizator QuikRead go Plus Instrument je *in vitro* diagnostični testni sistem enostaven za uporabo. Zasnovan je bil za merjenje različnih analitov iz vzorcev bolnika, ki so potrebeni kot pomoč pri diagnostirjanju in spremeljanju zdravljenja. Sistem sestavljajo analizator QuikRead go Plus in kompleti reagentov QuikRead go. Analizator QuikRead go Plus Instrument je avtomatiziran analizator, zasnovan in umerjen za fotometrične in turbidimetrične merite. Analizator je namenjen kvantitativni in kvalitativni določitvi različnih analitov kompleta reagentov QuikRead go iz človeških vzorcev, kot so polna kri, serum, plazma, bris grla in fekalni vzorci, ki se uporabljajo kot pomoč pri diagnostiki in spremeljanju zdravljenja. Analizator QuikRead go Plus Instrument je namenjen zdravstvenemu osebju v kliničnem laboratoriju in nastaviti testiranja v bližini bolnika.

QuikRead go Plus Instrument

Analizator vas bo vodil skozi postopek testa z nizom sporočil in animacij, prikazanih na zaslonsu. Med zagonom analizator opravi samodiagnostiko, da zagotovi pravilno delovanje notranjih komponent analizatorja, kot so optični sistem in mehanski deli.

Analizator QuikRead go Plus Instrument meri absorbanco ali motnost vsebine kivete in pretvori vrednost v vrednost koncentracije analita ali v kvalitativni rezultat na podlagi prednastavljenih podatkov o umerjanju testa. Podatki o umerjanju za vsak test so kodirani na nalepki kivete. Te informacije se med merjenjem samodejno prenesejo v analizator QuikRead go Plus Instrument.

Testi se izvajajo v skladu z navodili za uporabo, ki so priložena vsakemu kompletu reagenta QuikRead go. Rezultati so na voljo v nekaj minutah. Analizator lahko deluje na omrežno napajanje ali z baterijo, ima USB povezave za zunanj tiskalnik, tipkovnico in bralnik črtnih kod.

Analizator QuikRead go Plus Instrument je mogoče povezati z oddaljenim laboratorijskim in bolnišničnim

informacijskim sistemom (LIS/HIS). Analizator uporablja standardiziran protokol za prenos podatkov. Za več podrobnosti se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Varnostne informacije

Za vašo varnost upoštevajte vsa opozorila in previdnostne izjave. Da vas opozorimo na morebitne električne ali obratovalne nevarnosti, so po potrebi na voljo opozorila in previdnostne izjave. Analizator QuikRead go Plus Instrument vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), kot je določeno v uredbi REACH (EU 1907/2006), za več informacij glejte [aidian.eu](#). Snovi SVHC so vezane na notranje komponente analizatorja QuikRead go Instrument. Posebni previdnostni ukrepi pri ravnanju niso potrebni.

Preden začnete uporabljati analizator QuikRead go Plus Instrument, natančno preberite naslednje previdnostne ukrepe in omejitve. V primeru resnega zapletka o tem obvestite proizvajalca ali njegovega zastopnika in/ali nacionalni organ.

Previdnostni ukrepi in omejitve

- Samo za *in vitro* diagnostično uporabo.
- Na analizator ali vanj ne polivajte tekočin in vanj ne mečite predmetov.
- Razlitje potencialno kužnega materiala je treba takoj obrisati z vpojno papirnato brisačko, kontaminirana območja pa obrisati s standardnim razkužilom ali 70-odstotnim etilnim alkoholom (glejte poglavje »Čiščenje analizatorja«).
- Material, ki se uporablja za čiščenje razlitij, vključno z rokavicami, zavržite kot biološko nevarne odpadke.
- Upoštevajte navodila za uporabo reagenta QuikRead go, ki so priložena vsakemu kompletu reagenta.
- Uporabljate lahko samo reagente QuikRead go.
- Potrebeni materiali, ki niso priloženi, so navedeni v navodilih za uporabo kompleta reagentov QuikRead go.
- Ne mešajte komponent z različnimi številkami serij ali različnimi testi.
- V analizator nikoli ne vstavljamte kivete brez tesno nameščenega pokrovčka reagenta.
- Ko je pokrovček odprt, v analizator ne vstavljamte

prstov ali zunanjih naprav.

- Prepričajte se, da je tesnilna folija kivete popolnoma odstranjena.
- Če močno pritisnete ali uporabite ostre predmete, lahko poškodujete zaslons.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen analizatorju, in se prepričajte, da je vtič nameščen tako, da ga je mogoče odstraniti.
- Z analizatorjem QuikRead go Plus Instrument uporabljajte samo uradno baterijo, ki jo dobavlja družba Aidian.
- Med prenosom podatkov ne odstranjujte ali izklopite USB pomnilnika.
- Za priključitev dodatne opreme na analizator uporabite USB kable, krajše od 3 m.
- Ne odpirajte pokrova analizatorja z odstranjevanjem vijakov. Če je garancijski pečat pokvarjen, garancija na analizator ni veljavna (glejte **sliko 3**).
- Pri povezovanju analizatorja QuikRead go s sistemom LIS/HIS prek lokalnega omrežja uporabite varno notranje omrežje ali navidezno zasebno omrežje (VPN).
- Če je garancijski pečat uničen, analizatorja ne uporabljajte in ga ne povežite z omrežjem LAN.
- Analizatorja ne puščajte odklenjenega na javno dostopnih območjih.
- Iz analizatorja izbrišite uporabniške račune, ki se več ne uporabljajo (vključno z njihovimi povezanimi lokalnimi podatki).
- Elektromagnetno okolje je treba oceniti pred uporabo analizatorja.
- Ta oprema je bila zasnovana in preizkušena v skladu s CISPR 11 razred A. V domačem okolju lahko povzroči radijske motnje, zato boste morda morali sprejeti ukrepe za ublažitev motenj.
- Če se oprema uporablja na način, ki ni določen s strani proizvajalca, se lahko poslabša zagotovljena zaščita opreme.

2. ZAČETEK UPORABE

Odstranjevanje embalaže

Odprite škatlo in preverite, ali vsebuje vse naslednje elemente:

- Analizator
- Navodila za uporabo
- Napajalnik
- Napajalni kabel
- Potrdilo o analizi

Pazljivo preglejte analizator, da se prepričate, da se med pošiljanjem ni poškodoval. Če je prišlo do poškode ali kateri del manjka, takoj obvestite lokalnega dobavitelja.

Škatlo analizatorja je mogoče shraniti za prevoz, tj. pri pošiljanju na servis.

Dodatna oprema

Dodatna oprema sistema QuikRead go omogoča učinkovitejšo, varnejšo in enostavnejšo uporabo. Več informacij lahko najdete na spletnem mestu aidian.eu.

Razpoložljiva dodatna oprema:

Tiskalnik

- Na analizator lahko priključite zunanji tiskalnik. Seznam združljivih tiskalnikov in parametrov konfiguracije je na voljo na spletnem mestu aidian.eu.
- Tiskalnik povežite z USB vrati. Ko je tiskalnik povezan, se v vrstici stanja prikaže ikona tiskalnika.

Čitalnik črtnih kod

- Na analizator lahko priključite zunanji čitalnik črtnih kod. Seznam združljivih čitalnikov črtnih kod lahko najdete na spletnem mestu aidian.eu.
- Čitalnik črtnih kod povežite z USB vrati. Ko je čitalnik črtnih kod povezan, se v vrstici stanja prikaže ikona čitalnika črtnih kod.


Tipkovnica

- Na analizator lahko priključite zunanjou tipkovnico.
- Tipkovnico povežite na USB vrata. Ko je tipkovnica povezana, se v vrstici stanja prikaže ikona tipkovnice.

Opomba! Za priključitev dodatne opreme na analizator ne uporabljajte USB kablov dolžine 3 m ali več.

Deli analizatorja QuikRead go Plus Instrument


Deli analizatorj so prikazani na [sliki 1](#), [sliki 2](#) in [sliki 3](#).

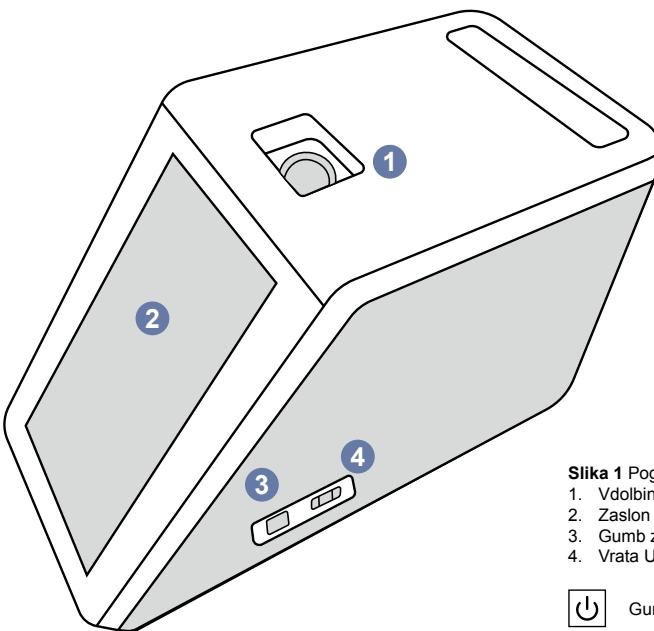

Slika 1 Pogled od spredaj
1. Vdolbina za merjenje
2. Zaslon na dotik
3. Gumb za vklop/izklop
4. Vrata USB (tip A)



Gumb za vklop/izklop

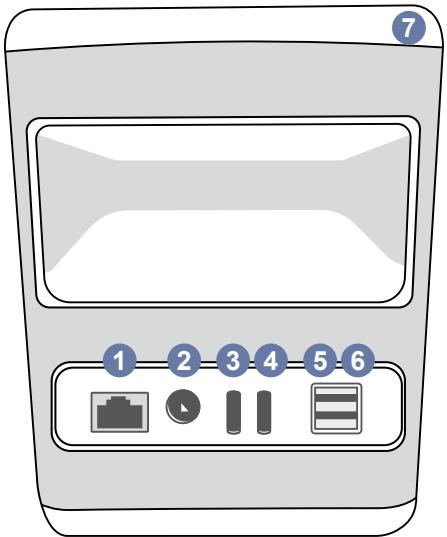

Slika 2 Pogled od zadaj

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Vrata RJ-45 | 4. Vrata USB (tip C) |
| 2. Konektor za napajanje | 5. Vrata USB (tip A) |
| 3. Vrata USB (tip C) | 6. Vrata USB (tip A) |
| 7. Ročaj | |



Sledi
navodilu za
uporabo





RJ-45



Moč



USB

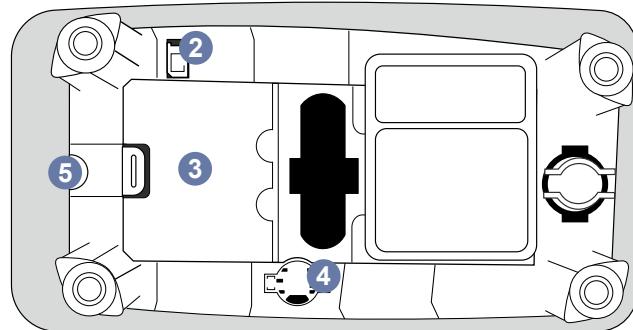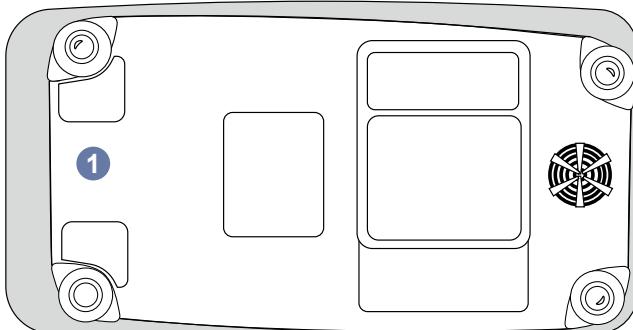

Slika 3 Spodnja stran

1. Pokrov enote baterije
2. Konektor baterije
3. Enota baterije
4. Baterija ure
5. Garancijski pečat

Dviganje ali prevažanje analizatorja QuikRead go Plus Instrument

Pri dviganju ali prevažanju analizatorja vedno ravnjajte previdno. Za dviganje analizatorja uporabite ročaj na zadnji strani analizatorja (*slika 2*).

Lokacija in okolje

Med uporabo

Analizator QuikRead go Plus Instrument morate postaviti na ravno čisto, vodoravno površino in upoštevati naslednje:

- Uporaba v zaprtih prostorih
- Nadmorska višina do 2.000 m
- Temperatura okolja mora biti med 15 °C in 35 °C.
- Najvišja relativna vlažnost 80 % pri temperaturah do 31 °C, ki se linearno zmanjšuje do 67 % relativne vlažnosti pri 35 °C (brez kondenzacije).
- Analizatorja ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Analizatorja med merjenjem ne premikajte in ga ne izpostavljajte stresanju.
- Ne merite v premikajočem se vozilu.
- Nihanja napajalne napetosti do ±10 % nazivne napetosti.
- Analizator namestite tako, da ga lahko enostavno izklopite in izključite napajalni kabel.
- Analizatorja ne polnite z zunanjim baterijo.
- Ne priključujte zunanjih naprav, ki jih družba Aidian ni odobrila. EMC je lahko presežena
- V analizator ne vstavljajte USB ključka za mobilne podatke LTE
- Vsi zunanjti tokokrogi naprav, priključenih na opremo, morajo imeti vsaj dvojno izolacijo od električnega omrežja.
- Analizatorja ne postavljajte v močno magnetno ali električno polje.
- Analizatorja ne uporabljajte v bližini virov močnega elektromagnetskoga sevanja (npr. nezaščitenih namernih virov RF), ker lahko motijo pravilno delovanje.
- Stopnja onesnaženosti 2.
- Kategorija vgradnje II (2.500 V prehodna).

- Omejitve: Te naprave WiFi ali Bluetooth ni dovoljeno uporabljati v polmeru 20 km od središča Ny-Ålesund na Svalbaru na Norveškem.



Med prevozom in skladiščenjem

- Temperatura okolja mora biti med 2 °C in 35 °C.
- Zaščitite pred dežjem in vlogo.
- Z analizatorjem ravnajte previdno.

Napajalni kabel in baterija

Analizator QuikRead go Plus Instrument lahko uporabljate z napajalnim kablom ali baterijo. Ko je napajalni kabel priključen, se baterija samodejno polni. Seznam primernih baterija najdete na strani [aidian.eu](#).

Konektorji in kabli

Analizator ima na strani vrata USB-A (*slika 1*) in pet priključkov: dva vhoda USB-A, dva vhoda USB-C in en priključek LAN na zadnji strani analizatorja (*slika 2*), ena vrata USB-A pa so nameščena na desni strani analizatorja. Shema ozičenja je opisana na spletnem mestu [aidian.eu](#).

Priklop napajjalnega kabla

Napajalni kabel priključite na hrbtno stran analizatorja (glejte *slika 2*). Napajalnik priključite v električno vičnico.

Vstavljanje akumulatorske baterije

Pri vstavljanju akumulatorske baterije v analizator natančno upoštevajte spodnje korake (glejte *slika 3*).

1. Izklopite analizator (če je vklopljen) in izključite napajalni kabel.
2. Analizator obrnite na stran na ravni površini in odprite pokrov enote za baterijo.
3. Priklopite konektor baterije na enoto baterije.
4. Baterijo potisnite v ustrezno mesto in se prepričajte, da je pravilno nameščena.
5. Zaprite pokrov enote baterije in analizator obrnite nazaj v pokončni položaj.

VKLOP in IZKLOP

Vklop

Za vklop analizatorja pritisnite gumb za vklop/izklop na stranski plošči (glejte *slika 1*), dokler osvetlitev ozadja zaslona ne zasveti. Lučka na gumbi za vklop označuje, da je analizator vklopljen. Če se nič ne zgodi, preverite, ali je napajalni kabel priključen. Če se analizator uporablja z baterijo in se ne zažene s pritiskom gumba za vklop, je baterija morda izpraznjena. Za zagon analizatorja s prazno baterijo priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop.

Izklop napajanja

Za izklop analizatorja pritisnite gumb za vklop. Prikaže se pojavno okno za potrditev zaustavitve. Če potrdite, se analizator izklopi. Če gumb za vklop pridržite za več sekund, se bo zaustavitev potrdila tudi brez dotika pojavnega okna na zaslono.

Če je kiveta med izklonom v analizatorju, se kiveta dvigne in na analizatorju se prikaže poziv, da jo odstranite.

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik uporablja kapacitivno tehnologijo na dotik in podpira kretnje, kot je drsenje, kjer je to predvideno v uporabniškem vmesniku. Zaslon lahko uporabljate z golimi prsti, z rokavicami za enkratno uporabo ali s peresom na dotik. Zaslon na dotik pri interakciji ne zahteva veliko pritiska. Na voljo so multisenzorične povratne informacije, ko se dotaknete gumba. Gumb prikaže dotik tako vizualno, s spreminjanjem videza in zvokom. Ukaž se registrira, ko prst spustite iz virtualnega gumba, ki se ga dotaknete. Če je pritisk spuščen izven območja začetnega gumba, ukaž ni naznan.

Prva nastavitev

Ob prvem zagonu analizatorja QuikRead go Plus Instrument mora uporabnik nastaviti skrbniško geslo. Nato bo analizator prikazal pozive za vodeno nastavitev, ki jo lahko uporabnik preskoči in uporabi tovarniške privzete nastavitev (**slika 4**). Ko končate prvo nastavitev ali jo preskočite, se zaslon odpre na začetnem zaslonu (**slika 5**).

Če želite pozne spremeniti nastavitev, odprite *Meni* → *Nastavitev*.

Opomba! Če želite več informacij o nastavitvi, tapnite ikono *Informacije* ⓘ poleg nastavitev na analizatorju QuikRead go Plus Instrument.

Opomba! Nastavite, poslane iz vmesne programske opreme POCT01-A2, bodo preglasile nastavitev analizatorja, razen če ni drugače navedeno.




Slika 4
Nastavite skrbniško geslo

Opomba! Za povezave uporabite le najmočnejši varnostni pravilnik, ki je na voljo

Prva nastavitev:

1. Jezik
 - Izberite jezik sistema.
2. Zaslom, zvok
 - Z drsnikom prilagodite svetlost zaslona, glasnost opozorila in glasnost tipkovnice.
3. Datum in čas
 - Izberite obliko zapisa datuma in nastavite trenutni datum.
 - Izberite obliko zapisa ure in nastavite trenutni čas.
4. Varčevanje z energijo
 - Z drsnikom izberite obdobje nedejavnosti, po ka-

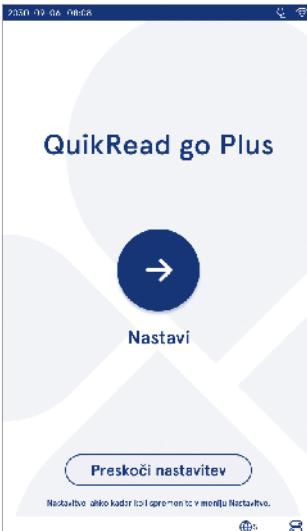

Slika 5
Prva nastavitev

terem analizator preide v način mirovanja.

- Izberite funkcijo načina mirovanja.
5. Merjenje
 - Omogočite lahko zaporedno merjenje.
 - » Ko je ta možnost omogočena, analizator samodejno začne novo merjenje vzorca bolnika po sprejetju ali zavrniti prejšnjega rezultata.
 - Izberete lahko, da omogočite merjenje v sili.
 - » Če je omogočeno, lahko uporabnik izvede test z merjenjem v nujnem primeru ne da bi se moral prijaviti. Če je možnost omogočena, nastavite število dovoljenih merjenj v nujnem, primeru.
 - 6. Parametri testa
 - V pogledu so prikazani trenutno razpoložljivi testi in trenutno izbrane izbire enot. Izberite test, za katerega želite prilagoditi parametre testa.
 - » Za podrobnejši opis nastavitev parametrov testa glejte poglavje »Parametri testa«.
 - 7. Tiskanje
 - Izberete lahko, da omogočite tiskanje. Če je tiskanje omogočeno, lahko omogočite samodejno tiskanje.
 - 8. Nastavitev upravljalca
 - Izberete lahko, da omogočite ID uporabnika. Ko je ta možnost omogočena, bo analizator uporabnika pozval, naj med izvajanjem merjenja vnese ID uporabnika.
 - » Če je možnost omogočena, lahko omogočite, da analizator vsakič predlaga predhodno vneseni ID uporabnika.
 - Izberete lahko, da je prijava uporabnika obvezna. Če je omogočena, se mora uporabnik prijaviti z uporabniškim imenom in geslom.
 - » Če je možnost omogočena, lahko z drsnikom izberete obdobje nedejavnosti, po katerem bo uporabnik samodejno odjavljen. Izberete lahko tudi možnost za samodejno odjavno uporabnika po vsakem merjenju.
 - » Če je možnost omogočena, lahko izberete, ali želite dovoliti seznam oddaljenih uporabnikov.
 - Če je možnost omogočena, bodo lokalno shranjeni računi za prijavo onemogočeni in računi vmesne programske opreme LIS bodo aktivni. Za pravilno delovanje potrebujete ak-

- tivno povezavo POCT01-A2. Glejte poglavje »Povezljivost za nastavitev povezave s sistemom LIS«.
- Splošne uporabniške nastavitev
 - Izberite, ali si lahko splošni uporabniki ogledajo seznam rezultatov.
 - Izberite, ali si lahko splošni uporabniki ogledajo seznam KK.
 - Opomba!** Ko ste prijavljeni kot skrbnik, sta seznam rezultatov in seznam KK vedno na voljo za ogled.
 - Nastavitev ID bolnika in nastavitev dodatnega ID
 - Izberete lahko, da omogočite ID bolnika. Ko je ta možnost omogočena, bo analizator uporabnika pozval, naj med izvajanjem merjenja vnese ID bolnika.
 - Izberete lahko, da omogočite dodatni ID. Ko je ta možnost dodatnega ID omogočena, bo analizator uporabnika pozval, naj med izvajanjem merjenja vnese dodaten ID.
 - Preberite več o upravljanju dodatnih ID-jev v razdelku »Upravljanje dodatnih ID-jev«.
 - Shranjevanje rezultatov
 - Izberite, kako dolgo analizator hrani rezultate bolnika v pomnilniku. Po izbranem času analizator samodejno izbriše starejše rezultate iz pomnilnika. Če pustite prazno, analizator rezultatov ne bo izbrisal glede na čas.
 - Izberite leta, dneve ali ure.
 - Izberite največje število rezultatov bolnika, ki jih želite shraniti. Ko je dosežena omejitve, analizator samodejno izbriše najstarejši rezultat iz pomnilnika.

Uporabniški vmesnik

Analizator QuikRead go Plus Instrument uporablja grafični uporabniški vmesnik, zasnovan za usmerjanje ob uporabi. V tem poglavju so pojasnjena glavna načela uporabniškega vmesnika.


Na zaslonu so prikazani navidezni gumbi in informacije o delovanju in stanju analizatorja. Zaslon omogoča prilaganje drsnikov s pritiskom in premikanje z drsenjem po zaslonu. Podobno lahko pri določenih pogledih z več vsebine, kot jo lahko naenkrat prilagodite zaslonu,

pogled pomaknete navzgor in navzdol tako, da pritisnete na zaslonu zunaj aktivnega območja izbire in ga premaknete.

Vsek pogled prikazuje območje stanja in njegove simbole, menijsko vrstico, glavni pogled in spodnje bližnje za izbiro jezika ter splošne nastavitev za svetlost in nastavitev glasnosti zaslona.

Vsi uporabniki lahko spremenijo nastavitev jezika, zaslona in zvoka. Te spremembe, ki jih izvede splošni uporabnik, se povrnejo, ko analizator izklopite ali se uporabnik odjaví.

Dotaknite se ikon na zaslonu za interakcijo z analizatorjem.

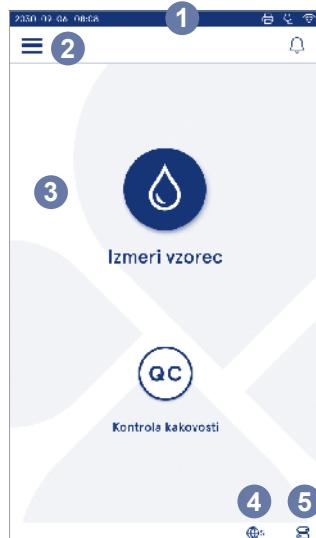

Slika 6 Začetni zaslon
 1. Območje stanja
 2. Menijska vrstica
 3. Pogled
 4. Izberi jezika
 5. Splošne nastavitev

Simboli uporabniškega vmesnika analizatorja QuikRead go Plus Instrument

	Izmeri vzorec		Dejanja seznama
	Kontrola kakovosti		Začetni zaslon
	Meni		Obvestilo
	Tiskanje		Izbira jezika
	Komentar		Splošne nastavitev
	Zavnji/izbriši		Več informacij

Ikone območja stanja

	Indikator napoljenosti baterije		Napajalni kabel priključen (polnjenje baterije, če je priključen)
	Opozorilo o nizki napoljenosti baterije (rdeč simbol)		Stanje WIFI
	Povezan USB pomnilnik		Povezan s sistemom LIS
	Tipkovnica povezana		Povezava s sistemom LIS je prekinjena
	Čitalnik črtnih kod povezan		Rezultati sistema LIS brez povezave čakajo na pošiljanje
	Tiskalnik povezan		

Meni

Do vseh funkcij analizatorja lahko dostopate iz glavnega menija . V meniju je gumb **Izmeri vzorec**  v zgornji vrstici. Pritisnite to ikono za bližnjico do merjenja vzorca. V zgornji vrstici je tudi gumb za zapiranje menija in vrnitev v prejšnji pogled in gumb DOMOV za vrnitev na začetni zaslon.




Slika 7 Meni

Obvestila

Obvestila o analizatorju si lahko ogledate v možnosti **Seznam obvestil**  v menijski vrstici. Ikona se spremeni, ko so na voljo obvestila. Če izberete obvestilo s seznama, boste dobili več informacij in navodila za odpravljanje težav. Obvestila so razvrščena v tri razrede

- Nečasovna kritična obvestila so modra, tj. pripravljeno za merjenje.
- Pomembne napake so rumene, tj. napaka povezave s sistemom LIS.
- Napake sistema so rdeče, tj. samodiagnostika ni uspela.


Za več informacij o napakah in odpravljanju težav glejte poglavje 10 »Odpravljanje težav«.

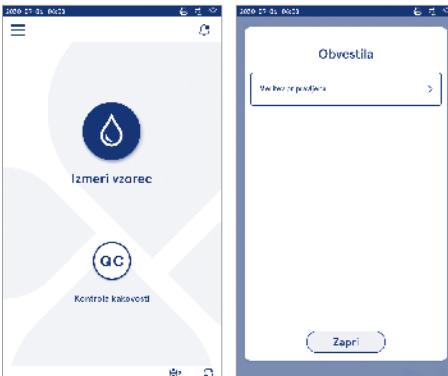

Izbira jezika

Jezik vmesnika lahko začasno spremeni vsi uporabniki v možnosti **Izbira jezika**  EN, ki je vidna v spodnjem desnem kotu zaslona. Izbira jezika vpliva na jezik menjiva in navodil ter razporeditev tipkovnice. Ta izbira se povrne v jezik sistema, ko se uporabniki odjavijo ali ko instrument izklopite.

Uporabnik skrbnik lahko spremeni jezik sistema v možnosti **Meni**  → **Nastavitev** → **Jezik, zaslon, zvok**.

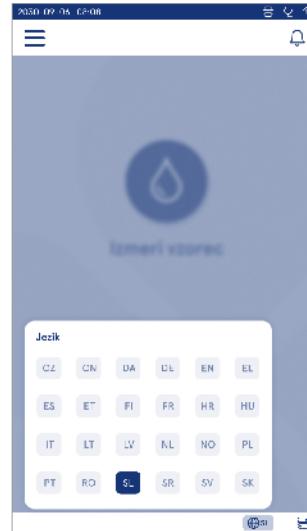


Spošne nastavitev

Spošne nastavitev lahko začasno spremenijo vsi uporabniki v bližnjici *Spošne nastavitev* ☰, ki je vidna v spodnjem desnem kotu zaslona. Uporabnik lahko spremeni svetlost zaslona, glasnost opozorila in glasnost tipkovnice. Te izbire se povrnejo v privzete nastavitev sistema, ko se uporabniki odjavijo ali ko instrument izklopite.

- Svetlost zaslona lahko prilagodite s premikanjem drsnika.
- Glasnost opozorila lahko prilagodite s premikanjem drsnika. Opozorila lahko izklopite tako, da drsnik nastavite skrajno levo.
- Glasnost tipkovnice lahko prilagodite s premikanjem drsnika. Tipkovnico lahko izklopite tako, da drsnik nastavite v skrajno levo.

Uporabnik skrbnik lahko spremeni te spošne nastavitev v možnosti *Meni* ━━ → *Nastavitev* → *Jezik, zaslon, zvok*.

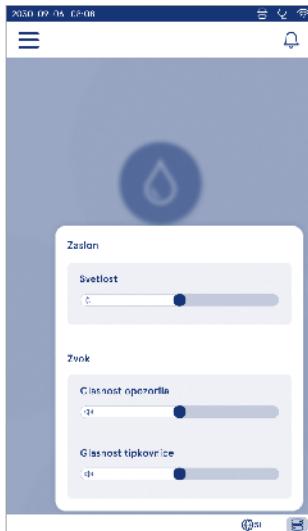

3. DELOVANJE ANALIZATORJA

Uporabo analizatorja QuikRead go Plus Instrument lahko razdelimo na tri glavne postopke:

- Izvajanje merjenja
- Ogled rezultatov
- Spreminjanje nastavitev analizatorja

Izvajanje merjenja

Analizator se lahko uporablja v dveh načinih merjenja: merjenje vzorca bolnika in merjenje vzorca kontrole kakovosti. Oba načina lahko spremenite v nastavitevah.

Opomba! Za izvedbo testa lahko uporabite samo komplete reagentov QuikRead go. Pred uporabo preberite navodila za uporabo ustreznega kompleta reagentov QuikRead go. V navodilih so podrobnejše informacije o izvajanjju testov in ravnanju z vzorci.


Merjenje vzorca bolnika

Ko želite analizirati vzorec bolnika, na zaslolu izberite *Izmeri vzorec* ⓘ. Analizator bo uporabnika vodil k izvedbi testa QuikRead go na vzorcu bolnika, ki ga bo analizator analiziral in prikazal rezultat na zaslunu, ko bo končan.

Izvajanje merjenja:

1. Na zaslunu izberite *Izmeri vzorec* ⓘ in sledite navodilom na zaslunu.
2. Vstavite kiveto v vdolbino za merjenje tako, da je črtna koda kivete obrnjena naprej (glejte **sliko 8**)
3. Pokrov se zapre in analizator začne z merjenjem. Potek analize je prikazan na zaslunu.
4. Merjenje lahko prekinete tako, da izberete možnost *Prekliči*. To bo dvignilo kiveto in vrnilo pogled na začetni zaslons.
5. Med merjenjem si lahko uporabnik ogleda prejšnje rezultate bolnika in rezultate KK ter prek menija dostopa do pogleda Vizitka. Ko je v drugih pogledih prikazana ikona napredka, bo na zaslunu prikazana ikona napredka, analizator pa bo uporabnika obvestil, ko bo merjenje pripravljeno.
6. Ko je analiza končana, je prikazan rezultat in kiveta se dvigne.

7. Odstranite kiveto, izberite možnost *Sprejmi* ✓ ali *Zavrnji* ━ za rezultat in zaslons se vrne na začetni zaslons. Prejšnje rezultate si lahko ogledate na seznamu rezultatov bolnika v možnosti *Meni* ━━.

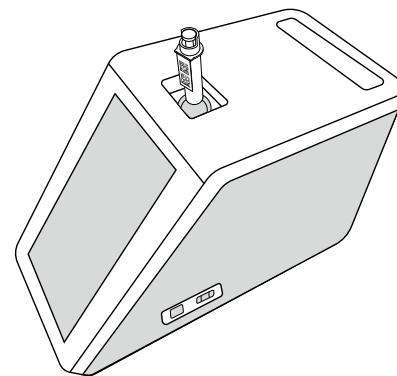

Slika 8

Vstavite kiveto v vdolbino za merjenje tako, da je črtna koda obrnjena naprej.

- Skrbnik lahko omogoči več funkcij za merjenje vzorca bolnika (glejte poglavje »Merjenje«).
- Omogočite lahko ID uporabnika, ID bolnika in dodatni ID, analizator pa bo zahteval, da uporabnik vnese te izbrane ID-je za dokončanje meritve. Več o dodatnem ID-ju preberite v razdelku »Nastavitev dodatnega ID«.
- ID-je lahko vnesete z zaslonom na dotik ali z čitalnikom črtnih kod ali zunanjim tipkovnico. Ko je prijava onemogočena, lahko analizatorju omogočite, da v pozivu predlaga zadnji uporabljeni ID uporabnika.
- Prijava se lahko omogoči tudi, da se uporabnik prijavi v analizator z uporabniškim imenom in geslom. Prijava samodejno vnese ID uporabnika za vsako merjenje.

- Omogočeno je lahko merjenje v nujnem primeru. Če je omogočeno, lahko uporabnik izvede test z merjenjem v nujnem primeru ne da bi se moral prijaviti. Če je možnost omogočena, nastavite število dovoljenih merjenj v nujnem, primeru. Nastavite lahko število sprejemljivih meritev v sili.
- Omogočite lahko način serijskih meritev. Ko je ta možnost omogočena, analizator samodejno začne novo merjenje vzorca bolnika, ko uporabnik sprejme ali zavrne prejšnji rezultat.
- Tiskanje rezultatov in pošiljanje rezultatov v sistem LIS lahko omogočite v nastavitevah.

Prikaz rezultatov vzorca bolnika

Prikaz rezultatov vzorca bolnika je na voljo po končani analizi. Prikazejo se rezultati analize in podatki o testu. Uporabnik lahko sprejme rezultat in bo shranjen na seznamu rezultatov bolnika z ikono . Rezultat lahko natisnete tako, da izberete , če je tiskanje omogočeno in če je tiskalnik priključen. K rezultatu lahko pripnete komentar. Če želite napisati komentar, izberite . Uporabnik se lahko odloči, da zavrne rezultat tako, da izbere . Ob zavrnitvi mora uporabnik navesti komentar. Rezultat bo shranjen na seznamu rezultatov bolnika kot zavrnjen, podrobne informacije pa si lahko še vedno ogledate.



Podroben prikaz rezultatov vzorca

Podroben prikaz rezultatov vzorca je na voljo v možnosti *Meni* → *Rezultati bolnika* z izbiro vrstice z rezultati. Podroben prikaz rezultatov vzorca dodatno prikazuje serijski ID analizatorja, komentarje in dodatne informacije o bolniku. Za rezultate testa CRP bo prikazana vrsta vzorca. Komentarje lahko dodate tako, da izberete in vnesete dodatne informacije o bolniku.



Merjenje vzorca kontrole kakovosti

Analizator ima ločen način merjenja za vzorce kontrole kakovosti, ki se merijo kot vzorci bolnika v možnosti *Kontrola kakovosti* ☰ na začetnem zaslolu. Rezultati so shranjeni ločeno od rezultatov bolnika in si jih lahko ogledate v rezultatih KK v možnosti *Meni* ☰.

Za izvajanje kontrole kakovosti izberite možnost *Kontrola kakovosti* ☰ na začetnem zaslolu in sledite navodilom na zaslolu.

Skrbnik lahko omogoči več funkcij za merjenje vzorca kontrole kakovosti (glejte razdelek »Nastavite KK«).

Kontrolni ID je lahko omogočen in analizator bo od uporabnika zahteval, da ga vnese za izvajanje kontrole kakovosti.

Preverjanje KK je mogoče omogočiti, če želite označiti, ali je rezultat KK znotraj nastavljenega razpona za vzorec KK.

Ko je omogočeno zaklepanje KK, lahko omogočite, da omejite uporabo analizatorja v primeru, da zadnja meritev KK ni uspela ali je razpored KK potekel. Ko je potekel, uporabnik ne more izmeriti vzorcev bolnika, preden ne izvede potekajoče kontrole kakovosti.

Prikaz rezultatov KK

Prikaz rezultatov KK je na voljo po končanem merjenju KK. Prikažejo se rezultat in podatki o testu. Uporabnik lahko sprejme rezultat in bo shranjen na seznamu rezultatov KK z ikono ⓘ. Rezultat lahko natisnete tako, da izberete 🖨, če je tiskanje omogočeno in če je tiskalnik priključen. K rezultatu lahko pridete komentar. Če želite napisati komentar, izberite 🎁.



Podroben prikaz rezultatov KK


Podroben prikaz rezultatov KK je na voljo v možnosti *Meni* ☰ → *Rezultati KK* z izbiro vrstice z rezultati. Podroben prikaz rezultatov KK dodatno prikazuje koncentracijo KK, dodatne informacije KK in komentarje. Komentarje lahko dodate z izbiro možnosti 🎁.



Rezultati

Rezultate si lahko ogledate v možnosti **Meni** . Rezultati so shranjeni v ločenih seznamih za možnosti **Rezultati bolnika**, **Rezultati KK** in **Rezultati sistema LIS brez povezave**. Po pregledu rezultatov se lahko pomikate s podrsavanjem. Če izberete rezultat, se prikažejo njegove podrobne informacije. Sezname rezultatov lahko razvrstite tako, da se dotaknete naslova stolpca.

V pogledu seznama bolnika lahko iščete po **ID bolnika** in ga razvrščate po možnostih **Datum**, **Test** in **ID Upravljalca**. Pogled seznama rezultatov KK lahko filtrirate po možnostih **Test**, **ID Uporabnika**, **Datum KK** in **ID Upravljalca**. Če želite filtrirati seznam, odprite možnost **Dejanja seznama**  v menijski vrstici.

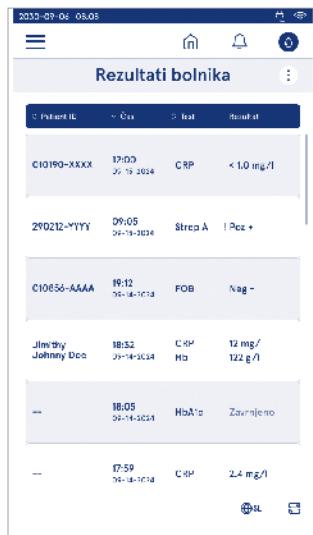

The screenshot shows a list of patient results. Each result row contains the patient ID, test date, test name, and result value. The results are grouped by patient and sorted by date.

Patient ID	Date	Test	Result
C10190-XXXX	17/03 09-03-2014	CRP	< 1.0 mg/l
290212-YYYY	09/05 09-05-2014	Strep A	+ Pos +
C10055-AAAA	09-12 09-09-2014	FOB	Neg -
John Smith Johnny Doe	18/02 09-14-2014	CK-MB	12 mg/l 122 g/l
--	18/05 09-14-2014	HbA _{1c}	Zavrnjeno
--	07-59 09-04-2014	CRP	2.4 mg/l

Natisnete lahko posamezne rezultate in sezname rezultatov. Sezname lahko natisnete s filtri ali brez njih in jih prenesete v USB pomnilnik. Seznam rezultatov morate filtrirati, preden je omogočen prenos prek USB-ja. Če želite natisniti posamezen rezultat, izberite vrstico z rezultati in izberite Natisni v pogledu rezultatov. Če želite natisniti seznam, odprite možnost **Dejanja seznama**  v menijski vrstici.

Brisanje rezultatov

Skrbnik lahko iz pomnilnika analizatorja izbriše posamezne rezultate. Na seznamu izberite rezultat in na dnu pogleda izberite Izbrisni rezultat. Analizator bo zahvalil dodatno potrditev.

Seznam LIS brez povezave


Meni  → **Seznam LIS brez povezave**

Rezultati, ki jih je ustvaril analizator z omogočeno povezavo LIS, medtem ko ni povezan, so shranjeni v možnosti **Seznam LIS brez povezave**. Rezultati se shranijo v primeru prekinitve povezave, npr. zaradi trenutne težave z omrežjem. Rezultate lahko pošljete v sistem LIS po ponovni vzpostavitvi povezave. Ko so rezultati preneseni v LIS, so odstranjeni s seznama LIS brez povezave.

Če želite rezultate brez povezave poslati v LIS, izberite rezultate tako, da tapnete potrditveno polje v vrstici z rezultati in izberete možnost **Poslji**. Če želite izbrisati rezultate, izberite rezultate, ki jih želite izbrisati, in izberite Izbrisni rezultat. Vse rezultate lahko izberete istočasno, tako da tapnete potrditveno polje v naslovni vrstici tabele z rezultati.

Ko je v splošnih nastavitevah LIS omogočen samodejni prenos rezultatov brez povezave in je povezava s sistemom LIS obnovljena, se prikaže pojavno okno za pošiljanje rezultatov brez povezave v sistem LIS. Instrument preveri povezavo sistema LIS med zagonom in po vsaki meritvi.

4. NASTAVITVE

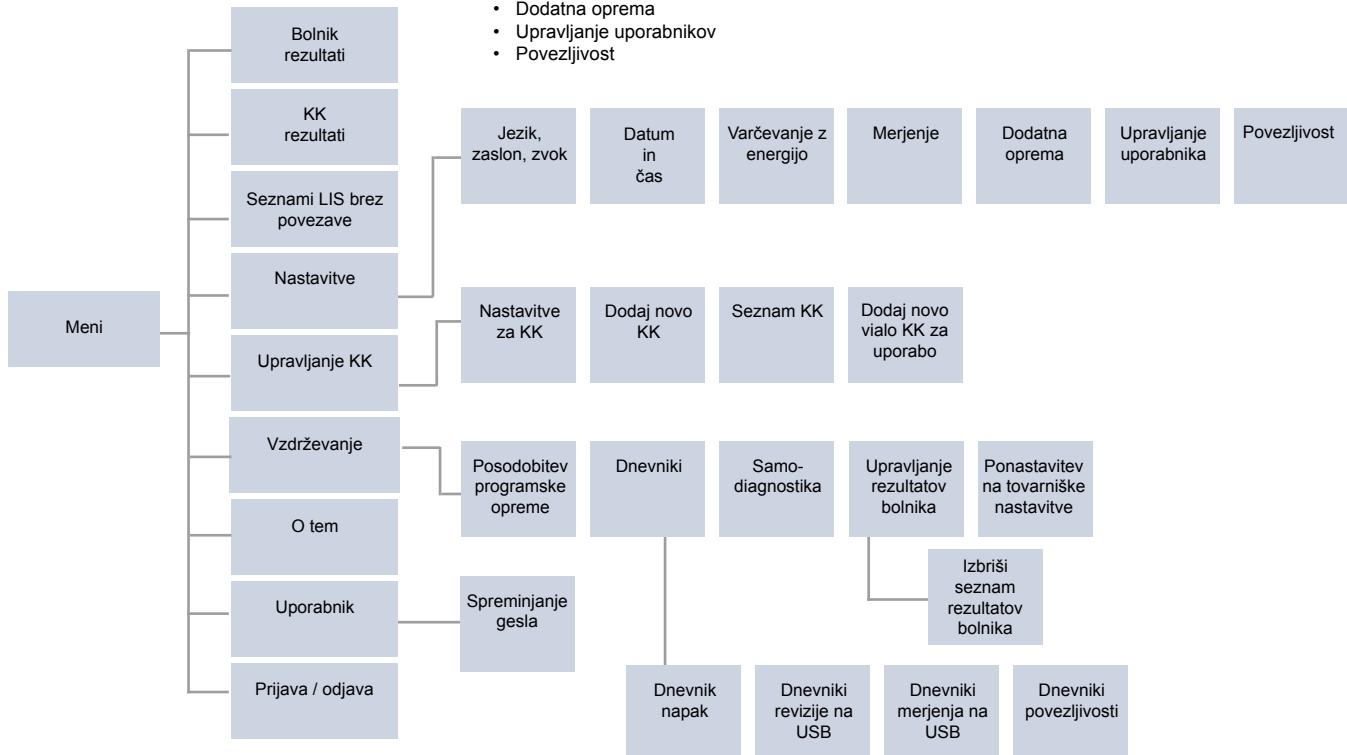

Do nastavitev lahko dostopate v možnosti **Meni** tako, da izberete **Nastavitev**. V nastavitvah lahko uporabnik z vlogo skrbnika nastavi trajne nastavitev za naslednje. Splošni uporabniki lahko spremenijo nekatere nastavitev in si ogledajo tiste, ki zahtevajo skrbniško avtorizacijo.

- Jezik, zaslon, zvok
- Datum in čas
- Varčevanje z energijo
- Merjenje
- Dodatna oprema
- Upravljanje uporabnikov
- Povezljivost

Opomba! Sistem uporablja funkcijo **Samodejno shranjevanje Shranjeno ✓**. Vse spremembe v spremembah bodo samodejno shranjene. Ko je samodejno shranjevanje aktivno, je v menijski vrstici prikazano **Shranjeno ✓**.

Jezik, zaslon, zvok

Meni → Nastavitve → Jezik, zaslon, zvok

- Jezik sistema lahko spremenite tako, da izberete jezik iz izbora. Izbira jezika vpliva na jezik menija in navodil ter razporeditev tipkovnice.
- Svetlost zaslona lahko prilagodite s premikanjem drsnika.
- Glasnost opozorila lahko prilagodite s premikanjem drsnika. Alarne lahko utišate tako, da drsnik nastavite v skrajno levo.
- Glasnost tipkovnice lahko prilagodite s premikanjem drsnika. Tipkovnico lahko utišate tako, da drsnik nastavite v skrajno levo.

Datum in čas

Meni → Nastavitve → Datum in čas

- Obliko zapisa datuma lahko spremenite iz izbora. Datum lahko spremenite tako, da nastavite nov datum.
- Obliko zapisa ure lahko spremojte med 24-urnim in 12-urnim. Trenutni čas lahko spremenite tako, da nastavite nov čas.

Opomba! Analizator preveri datum poteka roka uporabnosti reagentov QuikRead go pred merjenjem. Nastavitev napačnega datuma lahko omeji uporabo reagentov zaradi neuspešnega preverjanja datuma poteka roka uporabnosti.

Varčevanje z energijo

Meni → Nastavitve → Varčevanje z energijo

- Zakasnitev načina mirovanja lahko spremenite s premikanjem drsnika. Po tem obdobju analizator preide v način mirovanja.
- Funkcijo načina mirovanja lahko spremenite iz izbire.
 - » Polno stanje pripravljenosti: V načinu mirovanja analizator zapre pokrov in zatemni zaslon, preden ga izklopi. Zaslon lahko prebudite z dotikom zaslona ali hitrim pritiskom gumba za vklop.
 - » Samo zapiranje pokrova: V načinu mirovanja instrument zapre pokrov in zaslon je zatemnjen.

Merjenje

Meni → Nastavitve → Merjenje

- Spremenite parametre testa tako, da izberete test. Vsak analit ima določene nastavitev za to vrsto testa.
- Način zaporednih meritev lahko omogočite ali onemogočite. Ko je ta možnost omogočena, instrument samodejno začne novo merjenje vzorca bolnika po sprejetju ali zavrnitvi prejšnjega rezultata.
- Način merjenja v nujnem primeru lahko omogočite ali onemogočite. Če je omogočeno, lahko uporabnik izvede test z merjenjem v nujnem primeru ne da bi se moral prijaviti. Če je možnost omogočena, nastavite število dovoljenih merjenj v nujnem primeru.
- Če je možnost omogočena, nastavite število dovoljenih merjenj v nujnem primeru.

Parametri testa

Meni → Nastavitve → Merjenje → Parametri testa

- Spremenite izbiro enote, s katero(imi) enoto(ami) so prikazani rezultati testa. Pri nekaterih testih je mogoče preklopiti med kvantitativnimi in kvalitativnimi rezultati.
- Če je za prikaz rezultatov izbranih več enot in lahko izberete enoto, v kateri je rezultat poslan v sistem LIS.
- Mejne vrednosti indikatorjev lahko določite za vsak test. Omejite lahko nastavite za nizke, zmanjšane, povečane in/ali visoke rezultate. V prikazu rezultatov testa bodo prikazane nastavljene omejitve indikator-

jev in rezultat. Če je rezultat pod omejitvijo za zmanjšanje, se ob rezultatu prikaže ena puščica navzdol. Podobno, če je rezultat pod mejo za nizko, bosta prikazani dve puščici navzdol in če je rezultat nad mejo za povečano, se prikaže ena puščica navzgor, če je rezultat nad mejo za visoko, pa bosta prikazani dve puščici navzgor.



- Za kvalitativne rezultate lahko indikator nastavite za »Pos +« ali »Neg -«. Če je rezultat vzorca glede na izbiro, se poleg rezultata prikaže klicaj. Ko je omogočen pogled rezultatov, se za vse rezultate prikaže besedilo »Indikator rezultata vklopljen«.



Za nekatere teste lahko omogočite označevanje vrste vzorca. Ko je ta možnost omogočena, analizator prikaže napako, ko nazna napačno vrsto vzorca med merjenjem.



Dodatna oprema

Meni → Nastavitev → Dodatna oprema

Tiskanje lahko omogočite ali onemogočite. Če je tiskanje omogočeno in je povezan združljiv tiskalnik, lahko omogočite samodejno tiskanje. Pri samodejnem tiskanju so rezultati vsakega vzorca samodejno poslani tiskalniku.

CRP	21 mg/l	QuikRead go Plus
Hb	100 g/l	38/A22064512288
Patient ID	Joe Smith	
Operator ID	Nurse 1	 JE45
Time	2021-01-29 10:18	 JF08
Sample type	Whole blood	 2025-01-29

Slika 9 Natisnjen rezultat QuikRead go Plus

Upravljanje uporabnikov

Meni → Nastavitev → Upravljanje uporabnikov

Nastavitev uporabnika

- ID uporabnika lahko omogočite ali onemogočite. Ko je ta možnost omogočena, bo analizator uporabnika pozval, naj med izvajanjem merjenja vnese ID uporabnika.
- Ko je ta možnost omogočena, lahko omogočite, da bo vsakič predlagan predhodno vneseni ID uporabnika.
- Prijavo lahko omogočite ali onemogočite. Če je omogočena, se mora uporabnik prijaviti z gesлом.
- Ko je ta možnost omogočena, lahko z drsnikom izberete, po katerem obdobju nedejavnosti bo uporabnik samodejno odjavljen. Izberete lahko tudi možnost za samodejno odjavo uporabnika po vsakem merjenju.
- Opomba!** Priporočljivo je, da omogočite prijavo z geslom, da zagotovite varnost informacij, zlasti v okoljih z nizkimi fizičnimi varnostnimi ukrepi, kot so delovni prostori v skupni rabi ali odklenjeni delovni prostori ali ob obiskih bolnikov.
- Če je prijava omogočena, lahko izberete omogočanje seznama oddaljenih uporabnikov. To možnost lahko omogočite, če ima analizator omogočeno povezavo POCT01-A2. Ko je seznam uporabnikov

omogočen, ga upravlja vmesna programska oprema sistema LIS in ga ni mogoče urejati prek analizatorja. Če omogočite prijavo, onemogočite prejšnjo predlagano izbiro.

- Ogled seznama rezultatov bolnika lahko omogočite ali onemogočite za splošne uporabnike.
- Ogled seznama rezultatov KK lahko omogočite ali onemogočite za splošne uporabnike.

Opomba! Ko ste prijavljeni kot skrbnik, sta seznam rezultatov bolnika in seznam KK vedno na voljo za ogled.

Upravljanje upravljalcev

Meni → Nastavitev → Upravljanje uporabnikov → Upravljanje upravljalcev

- Skrbnik lahko doda nove uporabnike, si ogleda celoten seznam uporabnikov in vlog ter ureja račune.
- Pri dodajanju novega ID uporabnika:
- Izberite možnost *Vloga uporabnika* (Splošno/Skrbnik)
 - » Vnesite ID uporabnika
 - » Vnesite geslo
 - » Vnesite ime uporabnika
- Pri urejanju računov lahko spremenite uporabniško geslo.

Glejte tabelo pravic za vloge uporabnika na strani 29.

Nastavite za bolnika

ID bolnika lahko omogočite ali onemogočite. Ko je ta možnost omogočena, bo analizator uporabnika pozval, naj med izvajanjem merjenja vnese ID bolnika.

Nastavite dodatnega ID

Dodatni ID lahko uporabite kot dodatno besedilno polje ali za izbiro iz vnaprej določenega seznama elementov dodatnih ID-jev za vsako meritev vzorca bolnika. Ko je možnost dodatnega ID omogočena, bo analizator uporabniku prikazal zahtevo, naj med izvajanjem merjenja vnese dodaten ID.


Če želite vnesti elemente seznama dodatnih ID-jev ali prilagoditi ime seznama, izberite *Upravljanje dodatnih ID-jev*.

Upravljanje dodatnih ID-jev

Meni → Nastavitev → Upravljanje uporabnikov → Upravljanje dodatnih ID-jev

Elemente seznama dodatnih ID-jev vnesite tako, da izberete *Dodaj element seznama*. Če dodate element seznama, se ob besedilnem polju aktivira gumb seznama, ko izvedete meritev (**slika 10**).

Ime seznama prilagodite tako, da poleg imena seznama izberete *Uredi* . To bo zamenjalo naslov *Dodatni ID* pri izvajanju meritve (**slika 10**).

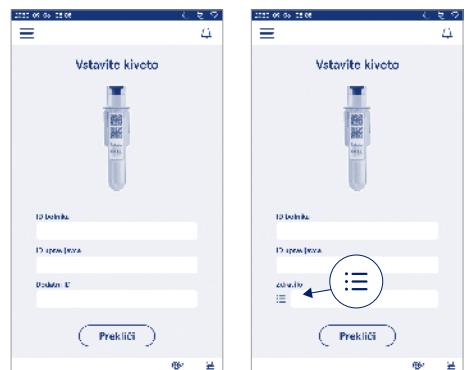

Slika 10 Dodatni ID

Ko so elementi seznama dodatnega ID vnaprej določeni, se ob besedilnem polju (desno) aktivira gumb seznama. Ko uredite ime seznama dodatnih ID-jev, bo ime prikazano nad besedilnim poljem (desno).

Povezljivost

Meni → Nastavitev → Povezljivost

Analizator lahko poveže z laboratorijskim ali bolnišničnim informacijskim sistemom (LIS/HIS) s povezavo LAN ali WLAN. Te povezave lahko uporabite za samodejni prenos podatkov med analizatorjem in sistemom za oddaljeno upravljanje in ogled rezultatov.

Za več informacij o povezljivosti se obrnite na svojega dobitelja.

Opomba! Za nastavitev povezljivosti se obrnite na skrbnika sistema.

LIS

Meni → Nastavitev → Povezljivost → LIS

- Povezavo s sistemom LIS lahko omogočite ali onemogočite. Ko je omogočen samodejni prenos rezultatov, ga lahko izberete. Če ga povezava prekinjena, bodo rezultati, ki so bili ustvarjeni, vendar niso poslani na LIS, vidni v pogledu rezultatov brez povezave sistema LIS (glejte razdelek »Seznam LIS brez povezave«)
- Izberete lahko vrsto povezave. Razpoložljive vrste povezav so:
 - » POCT1-A2
 - » LIS01-A2 (TCP/IP)
 - » LIS01-A2 (RS232)
- Naslov strežnika LIS in vrata TCP lahko spremenite.
- Interval pogovora lahko spremenite z drsnikom.
- Omogočite lahko šifriranje TLS. Potrdilo TLS lahko prenesete iz pomnilnika USB.
- Omogočite lahko preverjanje identifikatorja bolnika. Ko je ta možnost omogočena, analizator preveri ID bolnika iz vmesne programske opreme POCT01-A2. Če vneseni ID bolnika ni veljaven, analizator prikaže sporočilo o napaki.
- Omogočite lahko podatke bolnika. Ko je ta možnost omogočena, analizator pridobi podatke o bolniku iz vmesne programske opreme POCT01-A2 na podlagi vnesenega ID bolnika.

- Prenos rezultatov brez povezave lahko preklapljate med samodejnim in ročnim načinom. Ko je izbrana možnost Samodejno, bodo rezultati brez povezave s sistemom LIS samodejno preneseni, ko je povezava znova vzpostavljena. Ko je izbran ročni način, bo moral uporabnik izbrati rezultate, ki jih bo prenesel v sistem LIS.

TCP/IP

Meni → Nastavitev → Povezljivost → TCP/IP

- Vrsto IP-naslova lahko preklapljate med statičnim IP in dinamičnim IP.
- IP-naslov lahko spremenite.
- Masko podomrežja lahko spremenite.
- Privzeti prehod lahko spremenite.
- Strežnik DNS lahko spremenite.

WLAN

Meni → Nastavitev → Povezljivost → WLAN

Povezavo s sistemom WLAN lahko omogočite ali onemogočite. Ko je omogočeno, lahko povezavo nastavite z iskanjem razpoložljivih omrežij WLAN tako, da izberete Iskanje ali z ročno nastavitevijo. Iskanje bo prikazalo seznam razpoložljivih omrežij WLAN. Na seznamu izberite želeno omrežje. Če je omrežje zaščiteno z gesлом, se prikaže pojavno okno za geslo.

5. UPRAVLJANJE KK

Do upravljanja KK lahko dostopate v možnosti Meni  tako, da izberete Upravljanje KK. Nastavitev upravljanja KK nadzorujejo funkcionalnost merjenja kontrole kakovosti, ki je namenjena spremjanju delovanja instrumenta z uporabo kompletov reagentov QuikRead go in kontrol.

Nastavitev za KK

Meni  → Upravljanje KK → Nastavitev za KK

Kontrolni ID je lahko omogočen in analizator bo od uporabnika zahteval, da ga vnese za izvajanje kontrole kakovosti.

Če je omogočeno, lahko omogočite preverjanje KK, če želite označiti, ali je rezultat KK znotraj nastavljenega razpona za vzorec KK. Ko je preverjanje KK omogočeno in je rezultat KK znotraj sprejetega razpona, je prikazano *Uspešna KK*. Če je rezultat KK izven razpona, je prikazano *Neuspešna KK*. *Rezultat izven dosega* bo prikazan z rezultatom.



Ko je omogočeno zaklepanje KK, lahko omogočite, da omejite uporabo analizatorja v primeru, da zadnja meritve KK ni uspela ali je razpored KK potekel. Ko je potekel, uporabnik ne more izmeriti vzorcev bolnika, preden ne izvede potekajoče kontrole kakovosti. Nastavite urnik in izberite Dnevno, po izbranem številu testov ali izbranih dneh. Analizator bo zahteval vnos za zadnja dva. Če je urnik nastavljen za dnevno, bo zaklepanje KK naslednji dan aktivno, če meritve KK niste izvedli. Če je urniki nastavljeni za izbrane dni, bo zaklepanje KK naslednji dan aktivno, če meritve KK niste izvedli pravočasno.

Dodaj novo KK

Meni  → Upravljanje KK → Dodaj novo KK

Dodaj novo KK se uporablja za vnos informacij o novi kontroli kakovosti (KK), ko je v nastavitev KK omogočena nastavitev ID kontrole. Dodana KK bo na voljo za izbiro pri izvajaju meritev za KK. Analizator bo uporabil informacije kontrole pri določanju, ali je KK uspešna ali neuspešna.

Ime KK lahko vnesete za nastavitev imena, ki je vidno v izbiri seznama KK. Enoto KK, prikazano z rezultati, lahko spremenite. Razpon KK je obvezen in se uporablja za določanje, ali je meritve KK z ID kontrole uspešno ali neuspešno opravljena. Koncentracija KK je obvezna in je ciljna vrednost meritve kontrole. Potek raka uporavnosti serije KK je obvezen in se uporablja za preverjanje, ali se za KK uporabljajo pretečeni reagenti.

Nastavite lahko datum poteka raka uporavnosti viale KK, ki jo uporabljate. Viale kontrole kompleta reagentov QuikRead go imajo po odprtju datum poteka raka uporavnosti in ločen rok uporavnosti med uporabo. Za pomoč pri upravljanju viale KK v obdobjih poteka raka uporavnosti instrument ponuja možnost vnosa datuma zadnje uporabe odprte viale KK. Ko izvajate KK in izberete ID kontrole, če je datum poteka raka uporavnosti odprte viale potekel, analizator prikaže pojavno okno. Pojavno okno predlaga odpiranje nove viale in vnos datuma poteka raka uporavnosti nove odprte viale.

Za vsak ID kontrole lahko vnesete dodatne informacije za KK.

Opomba! Pri vnašanju informacij za novo kontrolo si oglejte nalepko in navodila za uporabo kontrole.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new KK. At the top, there's a header bar with icons for time (20:50), battery (75%), signal, and notifications. Below the header, the title 'Dodaj novo KK' is displayed. The form has several fields: 'ID kontrola*' with a placeholder 'Vnesite tukaj' and a 'Vnesite tukaj' button; 'Ime KK' with a placeholder 'Vnesite tukaj' and a 'Vnesite tukaj' button; 'Izbira enote KK' with units 'mg/l' (selected) and 'mg/dl'; and 'Razpon KK*' with a 'Shrani' button. There are also 'Dosežek je v obsegu' and 'Dosežek je izven obsega' buttons below the unit selection.

Seznam KK

Meni  → Upravljanje KK → Seznam KK

Podatki ID-jev kontrol si lahko ogledate in jih spremeni v seznamu KK. Pogled seznama prikazuje ime, datum poteka raka uporavnosti, test in obseg za vsako kontrolo.

Seznam lahko razvrstite z naslovi stolpcev.

Dodaj novo vialo KK za uporabo

Meni → Upravljanje KK → Dodaj novo vialo KK za uporabo

Za obstoječi ID kontrole lahko vnesete nov datum početka roka uporabnosti viale KK. Na seznamu izberite ID kontrole, ki ji želite dodati novo vialo KK v uporabi, z datumom početka roka uporabnosti. Odpri se bo pojavo okno, ki vas bo vodilo pri nastaviti.

Datum lahko dodata kot datum ali kot število dni od datuma vnosa. Predhodno vneseni datum početka roka uporabnosti odprete vialo lahko izbrisete.

Opomba! Čas početka roka uporabnosti med uporabo preverite v navodilih za uporabo kontrole.

6. MENI VZDRŽEVANJE

Do menija Vzdrževanje lahko dostopate v možnosti Meni tako, da izberete Vzdrževanje.

Posodobitev programske opreme

Meni → Vzdrževanje → Posodobitev programske opreme

Različico programske opreme analizatorja lahko posodobite prek USB pomnilnika. Za več podrobnosti o posodobitvah programske opreme se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Dnevniki

Meni → Vzdrževanje → Dnevniki

Analizator v pomnilnik zapisuje meritve, napake, povzljivost in dnevниke. Za dodatne informacije preberite naslednje razdelke.

Dnevnik napak

Meni → Vzdrževanje → Dnevniki → Dnevnik napak

Napake analizatorja se shranijo v pomnilnik. Prejšnje napake si lahko ogledate v dnevniku napak. Pogled lahko razvrstite tako, da se dotaknete naslova stolpca. Kode napak lahko prenesete v USB pomnilnik tako, da v menijski vrstici izberete prenos v USB.

Dnevniki revizije na USB

Meni → Vzdrževanje → Dnevniki → Dnevniки revizije na USB

Dnevni revizije vsebujejo podatke za prijavo, zapise dejanih merjenja vzorcev, zavrnite rezultatov, brisanje rezultatov in brisanje dnevnikov. Dnevnički lahko uporabljate za spremjanje uporabe instrumenta.

Dnevnički nadzora instrumenta lahko prenesete v USB pomnilnik.

Dnevnički merjenja na USB

Meni → Vzdrževanje → Dnevnički → Dnevnički merjenja na USB

Dnevnički meritev se uporabljajo za odpravljanje težav s strani družbe Aidian, na primer v primeru pritožbe stranke. Dnevnički meritev so šifrirani in na voljo samo

za osebe družbe Aidian. Vsebujejo dnevnike delovanja analizatorja brez podatkov o bolniku ali uporabniku.

Dnevnički povezljivosti

Meni → Vzdrževanje → Dnevnički povezljivosti

Dnevnički povezljivosti lahko shranite v pomnilnik. Sprememba zbirke dnevnikov LIS.

Dnevnički povezljivosti lahko prenesete v USB pomnilnik.

Samodiagnostika

Meni → Vzdrževanje → Samodiagnostika

Analizator izvaja preverjanje delovanja, da zagotovi pravilno delovanje. Če želite samodiagnostiko izvesti ročno, izberite Da. Sistem se po zaključku vrne na začetni zaslon.

Upravljanje rezultatov bolnika

Meni → Vzdrževanje → Upravljanje rezultatov bolnika

Trajanje shranjevanja rezultatov bolnika lahko nastavite ali spremenite. Nastavite čas shranjevanja v letih, dneh ali urah. Starejši rezultati bolnikov so po izbranem času samodejno izbrisani. Če pustite prazno, instrument rezultatov ne bo izbrisal glede na čas.

Največje število rezultatov pri shranjevanju lahko spremenite. Ko je dosežena omejitve, analizator samodejno izbriše najstarejši rezultat iz pomnilnika.

Izbriši seznam rezultatov bolnika

Meni → Vzdrževanje → Izbriši seznam rezultatov bolnika

Izbrišete lahko celoten seznam rezultatov bolnika. To možnost lahko uporabite za namene varstva podatkov.

Ponastavitev na tovarniške nastavitev

Meni → Vzdrževanje → Ponastavitev na tovarniške nastavitev

Analizator lahko ponastavite na tovarniške nastavitev.

7. POGLED O TEM

Pogled O tem prikazuje serijsko številko analizatorja, trenutno različico programske opreme in informacije o povezavi. Dodatno lahko analizator tudi poimenujete. Ko analizatorju dodelite ime, je v vseh pogledih prikazano v spodnjem levem kotu zaslona.

To možnosti O tem lahko dostopate v možnosti Meni tako, da izberete O tem.

8. VZDRŽEVANJE ANALIZATORJA

Analizator QuikRead go Plus Instrument je bil zasnovan tako, da je uporabniku priazen in ne zahteva rednega vzdrževanja. Za zahteve glede popravil in servisiranja se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Umerjanje analizatorja

Analizator je umerjen v tovarni. Pravilno delovanje analizatorja se preverja s postopkom samostojnega preverjanja med zagonom in pri vsaki meritvi. V primeru nepravilnega delovanja se prikaže sporočilo o napaki. Podatki umerjanja, ki določajo vsak test, so kodirani na nalepkah kivet. Analizator ob vsaki meritvi samodejno prebere te informacije.

Čiščenje analizatorja

Zunanost analizatorja redno čistite s krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z vodo. Posebno pozornost posvetite čiščenju zaslona. Pazite, da skozi robove zaslona, odprtino vdolbine za merjenje ali priključke ne vstopi tekočina. Po potrebi lahko uporabite blag detergent. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih snovi. Razlitje potencialno kužnega materiala je treba takoj obrisati z vpojno papirnatno tkivo, kontaminirana območja pa obrisati s standardnim razkužilom ali 70-odstotnim etilnim alkoholom. Materiali, ki se uporabljajo za čiščenje razlij, vključno z rokavicami, zavrzhite kot biološko nevarne odpadke.

Sprejemljiva razkužila:

- 70-odstotni etil alkohol
- 70-odstotni izopropanol
- 0,5-odstotni natrijev hipoklorit
- 2-odstotni glutaraldehid

Posodobitev programske opreme

Programsko opremo analizatorja lahko posodobite. Do posodobitve programske opreme dostopajte skozi Meni → Vzdrževanje → Posodobitev programske opreme in sledite navodilom na zaslonsu. Za več informacij se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Menjava baterije ure

Analizator ima baterijo za notranjo uro, ki ohranja čas, ko je izklopjen. Če je baterija ure skoraj prazna, se prikaže opozorilo. Baterijo ure lahko zamenjate z baterijo tipa CR 2032 3 V (slika 3).

9. SPECIFIKACIJE ANALIZATORJA

Izjava o skladnosti

Analizator QuikRead go Plus Instrument je v skladu z Uredbo (EU) 2017/746 o *in vitro* diagnostičnih medicinskih pripomočkih, direktivo 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, skupaj z delegirano direktivo (EU) 2015/863 o spremembni Prilogi II k Direktivi 2011/65/EU in Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Analizator QuikRead go Plus Instrument izpolnjuje zahteve glede elektromagnetskih emisij in odpornosti, opisane v standardu IEC 61326-2-6:2012. Analizator izpolnjuje zahteve FCC razreda A. Instrument QuikRead go Plus Instrument je skladen z uredbo (EU) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Analizator je skladen tudi z direktivo o radijski opremi 2014/53/EU. Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Tehnične specifikacije

Analizator ima vnaprej programiran mikroprocesor, ki nadzoruje korake testa in obdelavo podatkov. Podatki o identifikaciji testa, časovni razporeditvini in krivulji umerjanja ali mejni vrednosti so na črtini vsaki kiveti na črtni kodi. Ko ga mikroprocesor aktivira z oznako kivete, nadzira in vodi vse korake analize ter pretvori vrednosti absorbance vzorcev v koncentracijske enote ali mejne vrednosti.

Fotometer

Fotometer QuikRead go Plus Instrument je sestavljen iz vdolbine za merjenje, treh LED-lučk in detektorjev svetlobe. Fotometer je bil zasnovan in umerjen za fotometrične kot turbidimetrične meritve.

Zaslonski dotik

Uporabniški vmesnik temelji na kapacitivnem zaslonsu na dotik, ki je enostaven za uporabo. Uporabniku posreduje sporočila, pozive in animacije za izvajanje posameznega koraka testa ter prikaže rezultate testov in sporočila o napakah.

Dimenzijske in zahteve za napajanje

- Teža: 2,0 kg brez napajanja
- Velikost: 26,9 x 16,6 x 13,9 cm
- Zahtevano napajanje
 - Napetost: 100–240 V AC
 - Frekvenca: 50–60 Hz
 - Poraba energije:
 - Mirovanje 4 W
 - Stanje pripravljenosti 1 W
 - Najv. 35 W (brez zunanjih dodatnih opreme)
 - Vhod 18V = 3.3A

Identifikator analizatorja

Vsek instrument QuikRead go Plus Instrument ima edinstveno serijsko številko, ki jo lahko najdete na nalepki na dnu analizatorja in v pogledu O tem, ki je dostopen v možnosti Meni.

Pomnilnik

Analizator QuikRead go Plus Instrument ima notranji pomnilnik za zgodovino rezultatov in dnevnike. Analizator lahko shrani 6.000 rezultatov za bolnika in 6.000 rezultatov KK.

Napajanje

Analizator se napaja z napajalnikom, ki je priložen analizatorju. Poleg napajanja iz omrežja lahko analizator kot vir napajanja uporablja baterijo. Notranje stikalo v kabelskem priključku samodejno preklopi iz baterijskega napajanja na omrežno napajanje. Za navodila o namestitvi baterije glejte poglavje »Vstavljanje akumulatorske baterije«.

Radijski modul

Model Panasonic z dvopasovnim Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz in modulom Bluetooth: PAN9028.

Povezava s sistemom LIS

Povezavo lahko vzpostavite s:

- priključkom RJ-45 in podprtjo ethernetno povezavo 10BASET/ 100BASE-TX/1000BASE-TX. Uporabiti morate kabel z zvitim parom brez oplaščenja.
- Povezavo WLAN.
- Napajanje prek etherneta (PoE) ni podprt.

Za več podrobnosti se obrnite na dobavitelja.

Povezava s sistemom USB

Analizator ima tri priključke USB tipa A in dva priključka USB tipa C. Te priključke lahko uporabite za tiskalnike, čitalnike črtnih kod, tipkovnice in USB pomnilnike.

Servis

Analizator QuikRead go Plus Instrument je zasnovan tako, da ne potrebuje rednega vzdrževanja z vgrajenimi postopki samopreverjanja. V primeru ovake analizatorja se obrnite na lokalnega dobavitelja. Pred pošiljanjem analizatorja na servis izbrišite vse rezultate bolnika iz pogleda vzdrževanja tako, da izberete Izbrisí seznam rezultatov bolnika in očistite zunanjost analizatorja. Glejte razdelek »Čiščenje analizatorja«.

Garancija

Garancija proizvajalca za analizator QuikRead go Plus Instrument zajema napake v materialih ali proizvodnji za obdobje dveh let od datuma nakupa. Za veljavnost garancije mora biti garancijski pečat ([slika 3](#)) nedotaknjen. Proizvajalec se strinja, da bo analizator popravljen ali zamenjal, če zaradi ovare katerega koli notranjega dela analizatorja le-ta ne deluje. Garancija ne krive škode, ki je posledica neprimerne uporabe. Proizvajalec ni dolžan spremeniti ali posodobiti izdelanega analizatorja, razen če je ugotovljena proizvodna napaka. V primeru ovare analizatorja se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Odstrojanje

Analizator QuikRead go Plus Instrument je nizkonapetostna elektronska naprava. Uporabljeni analizator QuikRead go Plus Instrument je treba obravnavati kot potencialno biološko nevarne odpadke. Analizator mo-

rate odstraniti kot odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE 2012/19/EU), če lokalna in nacionalna zakonodaja ne zahteva, da se analizator zberi in odvrže kot potencialno kužni klinični odpadek. Več informacij o odlaganju analizatorjev lahko najdete na našem spletnem mestu [aidian.eu](#).

Embalažni materiali so materiali, ki jih je mogoče reciklirati. Baterijsko enoto in notranjo baterijo ure zavrzite v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi za zbiranje baterij, ki temeljijo na Direktivi 2006/66/ES ali Uredbi 2023/1542/EU o baterijah.

Zgodovina revizij

Zgodovino revizije lahko najdete na spletnem mestu [aidian.eu](#).

Frekvenčni pasovi in njihove največje radio-frekvenčne moči:

Podprt tehnologije	Način delovanja	Pas	Frekvenčno območje	Največja dovoljena povprečna izhodna moč	Ojačanje antene (integrirana antena s čipom)	Največja sevana povprečna izhodna moč
					[dBi]	
Bluetooth	Osnovna hitrost (BR)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4	2.1	<10
Bluetooth	Izboljšana hitrost podatkov (EDR)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4	2.1	<10
Bluetooth	Nizka energija (le)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4	2.1	<10
WLAN	IEEE 802.11b/g/n	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	16	2.1	<19
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 150... 5 250	16	1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 250... 5 350	16	1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 470... 5 725	16	1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 725... 5 825	16	1.5	<18

10. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Analizator QuikRead go Plus Instrument prikaže sporočila o napakah in vodi uporabnika v primeru, da zazna napake. Sledite prikazanim navodilom in si oglejte tabelo za odpravljanje težav v teh navodilih za uporabo in navodila za uporabo kompleta QuikRead go.

Opomba! Za dodatno podporo za odpravljanje težav obiščite spletno mesto aidian.eu ali pa se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Sporočilo napake / Odpravljanje težav	Možen vzrok	Korektivni ukrep
Prikazano je sporočilo »Ponovno zaženite QuikRead go Plus«.	Začasno nepravilno delovanje analizatorja.	Znova zaženite analizator. Če se to sporočilo o napaki pogosto prikaže, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Prikaže se koda napake s sporočilom »Obrnite se na službo za pomoč strankam«.	Trajna okvara analizatorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
Prikazano je sporočilo napake »Nizka raven baterije. Priključite napajalni kabel za nadaljevanje delovanja.«.	Nizka napoljenost baterije.	Napajalno enoto priključite v napajalni priključek QuikRead go Plus instrument.
Prikazano je sporočilo napake »Nepravilen položaj kivete. Odstranite kiveto.«.	Ostanki tesnilne folije kivete ostanejo na robu kivete.	Ko analizator dvigne kiveto, jo odstranite. Pri naslednji meritvi se prepričajte, da so vsi ostanki odstranjeni.
	Mehanska okvara analizatorja.	Preverite zgornjo točko. Če ne ustreza, znova zaženite analizator. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Sporočilo napake / Odpravljanje težav	Možen vzrok	Korektivni ukrep
»Prepovedano merjenje.«	Manjka pokrovček reagenta ali uporaba kivete.	Prepričajte se, da ima kiveta pokrovček reagenta in da notranji barvni del pokrovčka ni pritisnjен navzdol.
	Branje podatkov serije iz črtne kode ni uspelo.	Poskusite znova. Če težava ni odpravljena, prekličite test.
	Pretečen rok uporabnosti kompleta serije.	Zavrzite pretečeno serijo kompleta. Uporabite novega.
	Prenizka temperatura kivete.	Počakajte, da se kiveta segreje na sobno temperaturo. Še enkrat opravite test z isto kiveto.
	Previsoka temperatura kivete.	Počakajte, da se kiveta ohladi na sobno temperaturo. Še enkrat opravite test z isto kiveto.
»Test je preklican.«	Previsoka prazna vrednost.	Še enkrat opravite test z isto kiveto. Postopek polnjenja še ni zaključen ali pa vzorec vsebuje moteče snovi. V slednjem primeru testa ni mogoče dokončati.
	Nestabilno prazno.	
	Napaka pri dodajanju reagenta.	Opravite nov test. Med dodajanjem reagenta se je pojavila težava. Prepričajte se, da je pokrovček pravilno zaprt.
	Okvara analizatorja.	Opravite nov test. Če se to sporočilo pogosto prikaže, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Analizator QuikRead go Plus Instrument se ne zažene.	Napajalna enota ni priključena.	Priklučite napajalno enoto in poskusite znova.
	Izpraznjena baterija.	Priklučite napajalni kabel in poskusite znova.
	Okvara elektronike analizatorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.

Sporočilo napake / Odpravljanje težav	Možen vzrok	Korektivni ukrep
Zaslon na dotik ne deluje pravilno.	Zaslon na dotik se sploh ne odziva.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
Zvoki alarma analizatorja se ne slišijo.	Glasnost je nastavljena na nizko raven.	Nastavite glasnost v skladu s postopkom, opisanim v razdelku »Jezik, zaslon, zvok«.
	Okvara zvočnega sistema analizatorja.	Ponovno zaženite analizator QuikRead go Plus Instrument. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Tiskalnik ne tiska.	Tiskalnik je izklopljen ali kabel tiskalnika ni priključen ali je tiskalnik okvarjen ali nastavitev niso pravilne.	Prepričajte se, da je tiskalnik priključen in vklopljen. Preverite nastavitev. Če se težava nadaljuje, zaženite instrument in tiskalnik ter poskusite znova začeti tiskati iz menija Rezultati. Če se težave še vedno pojavlja, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Čitalnik črtnih kod ne deluje.	Čitalnik črtnih kod ni povezan ali okvara čitalnika črtnih kod ali nepravilne nastavitev.	Prepričajte se, da je čitalnik črtnih kod povezan. Preverite nastavitev. Če se težava nadaljuje, zaženite analizator in znova poskusite znova odčitati črtno kodo. Če se težave še vedno pojavlja, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Baterija zahteva pogosto polnjenje.	Zmogljivost baterije se med njeno življenjsko dobo zmanjša.	Staro baterijo zamenjajte z novo v skladu s postopkom, opisanim v poglavju »Vstavljanje akumulatorske baterije«.
Prikazano je opozorilo baterije ure.	Notranja baterija ure je prazna.	Zamenjajte baterijo ure v skladu s postopkom, opisanim v razdelku »Zamenjava baterije ure«.

Pravice vlog uporabnika

Ukrep	Spošni uporabnik	Skrbnik
Meritev bolnika	X	X
Ogled seznama rezultatov bolnika	- / X*	X
Ogled seznama rezultatov seznama LIS brez povezave	- / X*	X
Merjenje KK	X	X
Ogled rezultatov KK	X	X
Dodajanje novega ID kontrole	X	X
Brisanje vseh podatkov o bolniku	-	X
Prenos rezultatov na USB	- / X*	X
Spreminjanje gesla	X**	X
Nastavite skrbniško geslo	-	X
Nastavitev	X***	X
Varčevanje z energijo	-	X
Začasna sprememba: Varčevanje z energijo	X	-
Jezik, svetlost zaslona, glasnost	-	X
Začasna sprememba: jezik, svetlost zaslona, glasnost	X	X
Vzdrževanje	-	X
Vzdrževanje: dnevnik napak	X***	X
O tem	X***	X

*Če možnost omogoči skrbnik

** samo lokalni uporabnik. Omejeno, ko je aktiven seznam oddaljenih uporabnikov.

*** Samo za ogled

SADRŽAJ

1 UVOD	31	Merenje uzorka za kontrolu kvaliteta.....	40	Samotestiranje	47
Namena	31	Pregled rezultata kontrole kvaliteta	40	Upravljanje rezultatima pacijenata	47
QuikRead go Plus Instrument	31	Detaljan pregled rezultata kontrole		Brisanje liste rezultata pacijenata	47
Bezbednosne informacije.....	31	kvaliteta	41	Resetovanje na fabrička podešavanja	47
Mere predostrožnosti i ograničenja	31	Resultati	41		
2 POČETAK.....	32	Brisanje rezultata	41	7 PRIKAZ O INSTRUMENTU.....	47
Raspakivanje.....	32	LIS lista van mreže	41		
Dodatna oprema.....	32			8 ODRŽAVANJE INSTRUMENTA.....	47
Delovi za QuikRead go Plus Instrument.....	32			Kalibracija instrumenta	47
Podizanje ili prevoz QuikRead go				Čišćenje instrumenta	48
Plus Instrument	34			Ažuriranje softvera	48
Lokacija i okruženje	34			Zamena baterije sata.....	48
Tokom upotrebe	34				
Tokom prevoza i skladištenja.....	34				
Kabl za napajanje strujom i baterija	34				
Prikљucići i kablovi	34				
Ukopčavanje kabla za napajanje strujom.....	34				
Umetanje punjive baterije	34				
UKLUĆENJE i ISKLJUĆENJE	34				
Uključivanje napajanja	34				
Isključivanje napajanja.....	34				
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir.....	34				
Prvo podešavanje.....	35				
Korisnički interfejs	36				
Ikone područja statusa	37				
Meni	37				
Obaveštenja	37				
Izbor jezika	38				
Opšta podešavanja.....	38				
3 RAD INSTRUMENTA	38				
Vršenje merenja	38				
Merenje uzorka pacijenata	38				
Prikaz rezultata uzorka pacijenata.....	39				
Detaljan prikaz rezultata uzorka	40				
4 PODEŠAVANJA	42				
Jezik, prikaz ekrana, zvuk	43				
Datum i vreme	43				
Ušteda energije	43				
Merenje	43				
Parametri testa	43				
Dodatna oprema	44				
Korisničko upravljanje	44				
Podešavanja operatera	44				
Podešavanja pacijenata	44				
Dodatna podešavanja ID	44				
Povezivanje	45				
LIS	45				
TCP/IP	45				
WLAN	45				
5 UPRAVLJANJE KONTROLOM KVALITETA	45				
Podešavanja kontrole kvaliteta.....	45				
Dodavanje nove kontrole kvaliteta	45				
Lista kontrole kvaliteta	45				
Dodavanje nove bočice u upotrebi za kontrolu kvaliteta	45				
6 MENI ZA ODRŽAVANJE	46				
Ažuriranje softvera	46				
Dnevniči	46				
Dnevnik grešaka	46				
Dnevniči revizije na USB	47				
Dnevniči merenja na USB	47				
Dnevniči povezivanja	47				
10 REŠAVANJE PROBLEMA	50				
Prava korisničke uloge	53				

1. UVOD

Namena

QuikRead go Plus Instrument je *in vitro* dijagnostički testni sistem jednostavan za upotrebu. Osmišljen je za merenje različitih analita iz uzoraka pacijenata potrebnih kao pomoć u dijagnostici i praćenju lečenja. Sistem se sastoji od QuikRead go Plus instrumenta i QuikRead go kompleta reagensa.

QuikRead go Plus Instrument je automatizovani instrument osmišljen i kalibriran kako za fotometrijska, tako i za turbidimetrijska merenja. Instrument je namenjen za kvantitativno i kvalitativno određivanje različitih analita uz pomoć QuikRead go reagensa iz ljudskih uzoraka kao što su puna krv, serum, plazma, brisevi grla i fekalni uzorci koji se koriste kako pomoći u dijagnostici i praćenju lečenja. QuikRead go Plus Instrument je namenjen za upotrebu od strane zdravstvenih radnika u kliničkoj laboratoriji i okruženju za testiranje u blizini pacijenata.

QuikRead go Plus Instrument

Instrument će vas voditi kroz proceduru analize koristeći niz poruka i animacija prikazanih na ekranu. Tokom pokretanja, instrument vrši samotestiranje kako bi se osigurala ispravna funkcionalnost unutrašnjih komponenti instrumenta kao što su optički sistem i mehanički delovi.

QuikRead go Plus Instrument meri apsorbanciju ili zamućenost sadržaja kivete i konverte vrednost u vrednost koncentracije analita ili u kvalitativni rezultat na osnovu unapred podešenih podataka o kalibraciji testa. Podaci o kalibraciji za svaki test su kodirani na etiketi kivete. Ove informacije se prenose na QuikRead go Plus Instrument automatski tokom merenja.

Testovi se izvode u skladu sa uputstvima za upotrebu koja prate svaki QuikRead go komplet reagensa. Rezultati su dostupni za nekoliko minuta. Instrument može da radi na mrežno napajanje ili sa baterijom, ima USB priključke za eksterni štampač, tastaturu i čitač bar kodova.

QuikRead go Plus Instrument se može povezati sa laboratorijskim i bolničkim informacionim sistemom (LIS/

HIS) na daljinu. Instrument koristi standardizovani protokol za prenos podataka. Obratite se svom lokalnom dobavljaču za više informacija.

Bezbednosne informacije

Radi vaše bezbednosti, pridržavajte se svih izjava koja se odnose na upozorenja i oprez. Da bi vas upozorili na potencijalne električne ili radne opasnosti, date se izjave koje se odnose na upozorenja i oprez gde je to primenljivo. QuikRead go Plus Instrument sadrži supstance koje izazivaju veliku zabrinutost (SVHC) kako je navedeno u Uredbi REACH (EU 1907/2006), za više informacija posetite aidian.eu. SVHC supstance su vezane za unutrašnje komponente instrumenta QuikRead go Instrument. Posebne mere opreza pri rukovanju nisu potrebne.

Pre nego što počnete da koristite QuikRead go Plus Instrument, pažljivo pročitajte sledeće mere predostrožnosti i ograničenja. U slučaju ozbiljnog incidenta, prijavite ga proizvođaču ili njegovom predstavniku i/ili nacionalnom organu.

Mere predostrožnosti i ograničenja

- Samo za *in vitro* dijagnostičku upotrebu.
- Nemojte prosipati nikakvu tečnost ili ispušтati bilo kakve predmete na ili u instrument.
- Potencijalno infektivni prosuti materijal treba odmah obrisati upijajućom papirnom maramicom, a kontaminirana područja prebrisati standardnim dezinfekcionim sredstvom ili 70% etil alkoholom (pogledajte odeljak „Čišćenje instrumenta“).
- Materijal koji se koristi za čišćenje prosutog materijala, uključujući rukavice, treba odložiti kao biološki opasan otpad.
- Sledite uputstva za upotrebu za QuikRead go reagens dostavljena sa svakim kompletom reagensa.
- Mogu se koristiti samo QuikRead go reagensi.
- Materijali koji su potrebni, ali nisu obezbeđeni, navedene su u uputstvima za upotrebu QuikRead go kompleta reagensa.
- Nemojte mešati komponente sa različitim brojevima serija ili različitim testovima.
- Nikada nemojte stavljati kivet u bez čvrsto postavljenog poklopca za reagens u instrument.
- Nemojte stavljati prste ili bilo koje spoljne uređaje u instrument kada je poklopac otvoren.
- Proverite da li je zaptivna folija kivete potpuno uklonjena.
- Snažni pritisak ili korišćenje oštih predmeta može oštetiti ekran.
- Koristite samo strujno napajanje priloženo uz instrument i proverite da li je utikač postavljen tako da se može ukloniti.
- Koristite samo zvaničnu bateriju za QuikRead go Plus Instrument kojom snabdeva kompanija Aidian.
- Nemojte uklanjati ili isključivati USB memoriju tokom prenosa podataka.
- Koristite USB kablove kraće od 3m za povezivanje dodatne opreme sa instrumentom.
- Nemojte otvarati poklopce instrumenta otvaranjem bilo kakvih zavrtanja. Ako je garantni pečat oštećen, garancija na instrument ne važi (videti **Sliku 3**).
- Koristite bezbednu internu mrežu ili virtualnu privatnu mrežu (eng. Virtual Private Network, VPN) kada povezujete QuikRead go sa LIS/HIS koristeći LAN.
- Nemojte koristiti niti povezivati instrument na LAN ako je garantni pečat oštećen.
- Nemojte ostavljati instrument otklučan na javno dostupnim mestima.
- Izbrišite korisničke naloge koji se više ne koriste sa instrumenta (uključujući njihove povezane lokalne podatke).
- Pre rada instrumenta treba proceniti elektromagnetsko okruženje.
- Ova oprema je konstruisana i testirana u skladu sa standardom CISPR 11 klasa A. U kućnom okruženju može izazvati radio smetnje, u kom slučaju ćete možda morati da preduzmete mere za ublažavanje ovih smetnji.
- Ako se oprema koristi na način koji nije propisao proizvođač, može biti narušena zaštita koju oprema pruža.

2. POČETAK

Raspakivanje

Otvorite pakovanje i proverite da li ono sadrži sve sledeće stavke:

- Instrument
- Uputstvo za upotrebu
- Napajanje strujom
- Strujni kabl
- Sertifikat analize

Pažljivo pregledajte instrument da biste potvrdili da nije oštećen tokom isporuke. Ako je došlo do oštećenja ili nedostaju neki delovi, odmah obavestite svog lokalnog dobavljača.

Pakovanje instrumenta se može čuvati da bi se koristilo za transport, odnosno, ako se šalje u servis.

Dodatna oprema

Sistemski dodatni opremi za QuikRead go čine sistem efikasnijim, bezbednijim i lakšim za korišćenje. Više informacija možete pronaći na aidian.eu.

Dostupna dodatna oprema:

Štampač

- Eksterni štampač se može povezati sa instrumentom. Spisak kompatibilnih štampača i konfiguracijskih parametara možete pronaći na aidian.eu.
- Povežite štampač na USB port. Nakon što se štampač poveže, ikona štampača se prikazuje na statusnoj traci.

Čitač bar kodova

- Eksterni čitač bar kodova može da se poveže sa instrumentom. Spisak kompatibilnih čitača bar kodova možete pronaći na aidian.eu.
- Povežite čitač bar kodova na USB port. Nakon što se čitač bar kodova poveže, ikona čitača bar kodova se prikazuje na statusnoj traci.


Tastatura

- Eksterna tastatura se može povezati sa instrumentom.
- Povežite tastaturu na USB port. Nakon što se tastatura poveže, ikona tastature se prikazuje na statusnoj traci.

Napomena! Nemojte koristiti USB kablove dužine 3m ili duže za povezivanje dodatne opreme sa instrumentom.

Delovi za QuikRead go Plus Instrument


Delovi za instrument su prikazani na **Slici 1**, **Slici 2** i **Slici 3**.

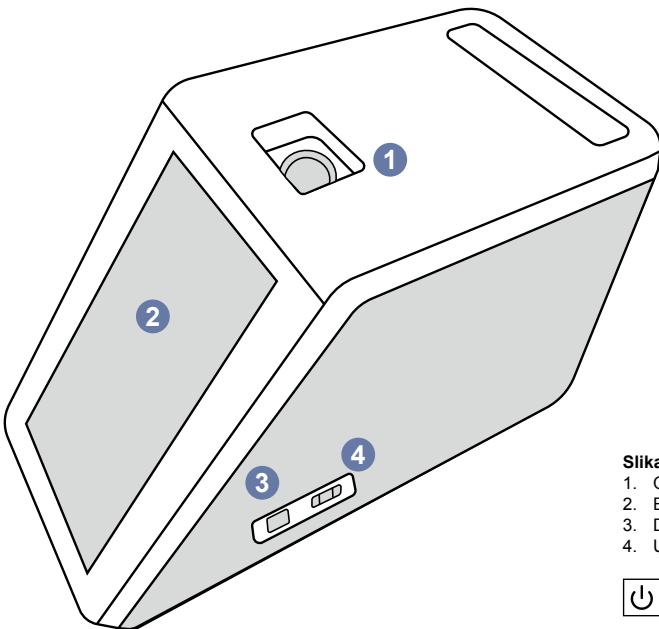

Slika 1 Pogled sa prednje strane
1. Otvor za merenje
2. Ecran na dodir
3. Dugme za pokretanje
4. USB port (tip A)



Prekidač za uključivanje-isključivanje

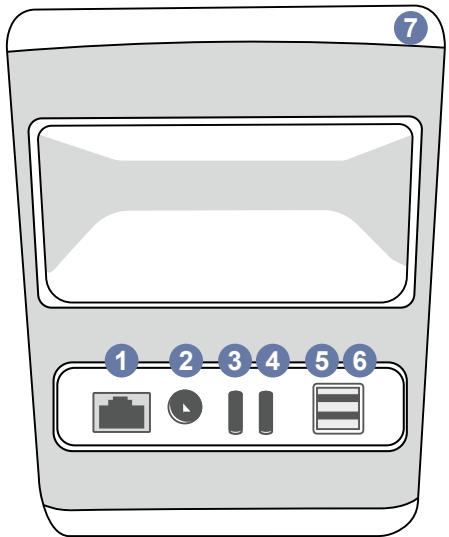

Slika 2 Pogled sa zadnje strane

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. RJ-45 port | 4. USB port (tip C) |
| 2. Priključak za napajanje strujom | 5. USB port (tip A) |
| 3. USB port (tip C) | 6. USB port (tip A) |
| | 7. Ručka |



Pogledajte uputstvo za upotrebu





RJ-45



Struja



USB

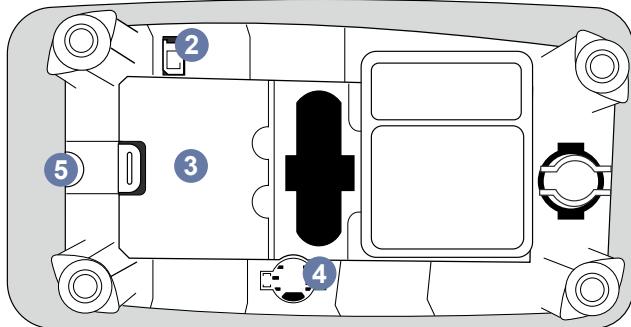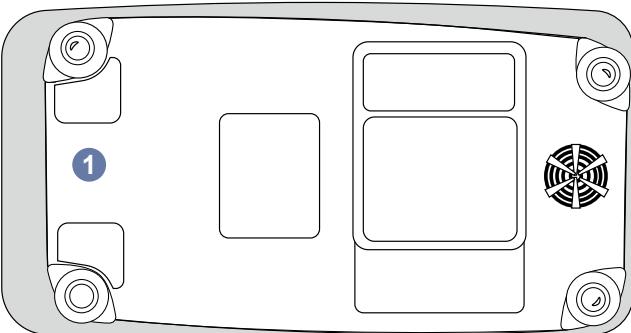

Slika 3 Donja strana

1. Poklopac baterije
2. Priključak za bateriju
3. Jedinica baterije
4. Baterija sata
5. Garantni pečat

Podizanje i prevoz QuikRead go Plus Instrument

Kada podižete ili transportujete instrument, uvek pažljivo rukujte njime. Za podizanje instrumenta koristite ručku na zadnjoj strani instrumenta ([Slika 2](#)).

Lokacija i okruženje

Tokom upotrebe

Tokom upotrebe QuikRead go Plus Instrument treba postaviti na ravnu, čistu, horizontalnu površinu i obratiti pažnju na sledeće:

- Unutrašnja upotreba
- Nadmorska visina do 2000m
- Temperatura okoline mora biti između 15°C i 35°C.
- Maksimalna relativna vlažnost 80% za temperature do 31°C opadajući linearno do 67% relativne vlažnosti na 35°C (bez kondenzacije).
- Nemojte stavljati instrument na direktnu sunčevu svetlost.
- Nemojte pomerati instrument i nemojte ga izlagati treskanju tokom vršenja merenja.
- Nemojte vršiti merenje u vozilu u pokretu.
- Oscilacije napona mrežnog napajanja do ±10% od nazivnog napona.
- Postavite instrument tako da je lako isključiti napajanje i iskopčati kabl za napajanje strujom.
- Nemojte puniti instrument eksternim punjačem.
- Nemojte povezivati eksterne uređaje koje nije odobrila kompanija Aidian. Elektromagnetska kompatibilnost (eng. ElectroMagnetic Compatibility, EMC) može biti veća
- Nemojte umetati LTE USB za prenos podataka u instrument
- Sva eksterna kola uređaja priključenih na opremu moraju imati najmanje dvostruku izolaciju u odnosu na mrežu.
- Nemojte stavljati instrument u jako magnetno ili električno polje.
- Nemojte koristiti ovaj instrument u blizini izvora jakog elektromagnetnog zračenja (npr., nezaštićeni namerni RF izvori), jer oni mogu da ometaju pravilan rad.
- Stepen zagadeњa 2.
- Kategorija instalacije II (2500 V prelazni).

- Ograničenja: WiFi ili Bluetooth ovog uređaja nije dozvoljeno koristiti u krugu od 20km od centra Ny-Alesund at Svalbard, Norveška.



Tokom prevoza i skladištenja

- Temperatura okoline mora biti između 2°C i 35°C.
- Zaštite od kiše i vlage.
- Pažljivo rukujte instrumentom.

Kabl za napajanje strujom baterija

QuikRead go Plus Instrument se može koristiti ili sa kablom za napajanje ili sa baterijom. Baterija se automatski puni kada je kabl za napajanje ukopčan. Lista kompatibilnih baterija se može naći na [aidian.eu](#).

Priklučci i kablovi

Instrument ima USB-A port na svojoj strani ([Slika 1](#)) i pet konektora: dva USB-A porta, dva USB-C porta i jedan LAN konektor na zadnjoj strani instrumenta ([Slika 2](#)) i jedan USB-A port je postavljen na desnoj strani instrumenta. Šema ožičenja je opisana na [aidian.eu](#).

Ukopčavanje kabla za napajanje strujom

Ukopčajte kabl za napajanje u zadnji deo instrumenta (pogledati [Slika 2](#)). Ukopčajte strujno napajanje u utičnicu.

Umetanje punjive baterije

Pažljivo pratite dole navedene korake kada ubacujete punjivu bateriju u instrument (pogledati [Slika 3](#)).

1. Isključite instrument (ako je uključen) i izvucite kabl za napajanje.
2. Okrenite instrument na stranu na ravnu površinu i otvorite poklopac baterije.
3. Priklučite konektor baterije na baterijsku jedinicu.
4. Pritisnite bateriju na svoje mesto i proverite da li je pravilno postavljena.
5. Zatvorite poklopac baterijske jedinice i vratite instrument nazad u uspravan položaj.

UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE

Uključivanje napajanja

Da biste uključili instrument, pritisnite dugme za napajanje na bočnoj ploči (pogledati [Sliku 1](#)) dok se ne upali pozadinsko osvetljenje ekrana. Lampica na dugmetu za napajanje pokazuje da je instrument uključen. Ako se ništa ne dešava, proverite da li je kabl za napajanje povezan. Ako instrument koristi bateriju i ne pokreće se pritiskom na dugme za napajanje, baterija je možda istrošena. Da biste pokrenuli instrument sa praznom baterijom, priključite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

Isključivanje napajanja

Da biste isključili instrument, pritisnite dugme za napajanje. Pojavice će iskačuti prozor za potvrdu isključivanja. Ako se potvrdi, instrument će se isključiti. Pritiskom na dugme za napajanje na više sekundi potvrđice se isključivanje čak i bez dodirivanja iskačućeg prozora na ekranu.

Ako je kiveta unutar instrumenta tokom isključivanja, kiveta se podiže i instrument će od vas tražiti da je uklonite.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ecran osetljiv na dodir koristi kapacitivnu tehnologiju dodira i podržava pokrete kao što su klizni pokreti, gde je to primenljivo u korisničkom interfejsu. Ecran se može koristiti golim prstima, sa rukavicama za jednokratnu upotrebu ili olovkom za ekrane na dodir. Ecran osetljiv na dodir ne zahteva mnogo priličkom interakcije sa njim. Postoji multisenzorna povratna informacija za dodirivanje dugmeta: Dugme će ukazati na dodir kako vizuelno, promenom izgleda, tako i zvučno. Komanda se registruje kada se prst otpusti sa virtuelnog dugmeta koje je dodirnuto. Ako se pritisak oslobođi izvan početne površine dugmeta, nijedna komanda se ne registruje.

Prvo podešavanje

Kada prvi put pokrenete QuikRead go Plus Instrument, instrument će zahtevati od korisnika da podesi administratorsku lozinku. Zatim će instrument tražiti vođeno podešavanje koje korisnik može preskočiti da bi koristio fabrička podešavanja (**Slika 4**). Nakon što završite prvo podešavanje ili ga preskočite, ekran će ući na početni ekran (**Slika 5**).

Da biste kasnije promenili podešavanja, idite na *Meni* → *Podešavanja*.

Napomena! Da biste pronašli više informacija o podešavanju, dodirnite ikonu *Info* ⓘ pored podešavanja na QuikRead go Plus Instrument.

Napomena! Podešavanja poslata iz posrednog softvera POCT01-A2 će zameniti podešavanja napravljena na instrumentu osim ako nije drugačije naznačeno.

Napomena! Za povezivanja koristite samo najjaču dostupnu bezbednosnu politiku

Prvo podešavanje:

1. Jezik
 - Izaberite jezik sistema.
2. Prikaz ekrana, zvuk
 - Podesite osvetljenost ekrana, jačinu zvuka upozorenja i jačinu zvuka tastature pomoću klizača.
3. Datum i vreme
 - Izaberite format datuma i podesite aktuelni datum.
 - Izaberite format sata i podesite trenutno vreme.



Slika 4

Podesiti administratorsku lozinku



Slika 5

Prvo podešavanje

Ušteda energije

- Pomoću klizača izaberite period neaktivnosti nakon kojeg instrument ulazi u režim mirovanja.
- Izaberite funkciju režima mirovanja.

Merenje

- Možete izabrati mogućnost serijskog merenja.
 - » Kada je omogućeno, instrument će automatski pokrenuti novo merenje uzorka pacijenta nakon prihvatanja ili odbacivanja prethodnog rezultata.
- Možete izabrati mogućnost merenja u hitnim slučajevima.
 - » Kada je omogućeno korisnik može da izvrši test koristeći merenje u hitnim slučajevima bez potrebe za prijavom. Ako je omogućeno, podesite broj dozvoljenih merenja u hitnim slučajevima.

Parametri testa

- Pregled prikazuje trenutno dostupne testove i trenutno odabранe izvore jedinice. Izaberite test za koji želite da podesite parametre ispitivanja.
 - » Za detaljan opis podešavanja parametara testa pogledati odeljak "Parametri testa".

Štampanje

- Možete izabrati mogućnost štampanja. Ako je omogućeno štampanje, možete izabrati mogućnost automatskog štampanja.

Podešavanja operatera

- Možete izabrati mogućnost ID operatera. Kada je omogućeno, instrument će zatražiti od korisnika da uđe u ID operatera prilikom vršenja merenja.
 - » Ako je omogućeno, možete izabrati mogućnost da instrument predloži prethodno uneseni ID operatera svaki put.
- Možete izabrati da postavite dnevnik za korisnika kao obavezno. Ako je omogućeno, korisnik se mora prijaviti korišćenjem svog korisničkog imena i lozinke.
 - » Ako je omogućeno, pomoću klizača možete odabrati period neaktivnosti nakon kojeg će korisnik automatski biti odjavljen. Takođe možete da izaberete automatsku odjavu korisnika nakon svakog merenja.
 - » Ako je omogućeno, možete izabrati omogućavanje liste operatera na daljinu.

- Ako je omogućeno, lokalno sačuvani nalozi za prijavu biće onemogućeni i nalozi posrednog softvera LIS će biti aktivni. Za pravilno funkcionisanje potrebna je aktivna POCT01-A2 veza. Pogledati Odeljak "Povezivanje za podešavanje LIS veze".
9. Podešavanja za opšte korisnike
- Izaberite da li opšti korisnici mogu da pregledaju listu rezultata.
 - Izaberite da li opšti korisnici mogu da pregledaju listu kontrole kvaliteta.
 - » **Napomena!** Kada se prijavljuje kao administrator lista rezultata i lista kontrole kvaliteta je uvek dostupna za pregled.
10. Podešavanja ID pacijenata i dodatna ID podešavanja
- Možete izabrati mogućnost ID pacijenata. Kada je omogućeno, instrument će zatražiti od korisnika da uđe u ID pacijenta prilikom vršenja merenja.
 - Možete izabrati mogućnost dodatnog ID. Kada je dodatni ID omogućen, instrument će zatražiti od korisnika da unese dodatni ID prilikom vršenja merenja.
 - » Pročitajte više o Upravljanju dodatnim ID u Odeljku "Upravljanje dodatnim ID".
11. Čuvanje rezultata
- Izaberite koliko dugo instrument čuva rezultate pacijenta u memoriji. Nakon odabranog vremena instrument će automatski izbrisati starije rezultate iz memorije. Ako se ostavi prazno instrument neće izbrisati rezultate na osnovu vremena.
 - » Odaberite godine, dane ili sate.
 - Izaberite maksimalni broj rezultata pacijenata koji se čuvaju. Kada se dostigne granica, instrument će automatski izbrisati najstariji rezultat iz memorije.

Korisnički interfejs

QuikRead go Plus Instrument se koristi pomoću grafičkog korisničkog interfejsa konstruisanog za vođenje njegove upotrebe. U ovom odeljku objašnjavaju se glavni principi korisničkog interfejsa.

Ekran prikazuje virtualne tastere i informacije o radu i statusu instrumenta. Ekran omogućava podešavanje klizača pritiskom na jedan i pomerajući ga klizanjem na ekranu. Slično kao i za određene prikaze sa više sadržaja nego što može da stane na ekran istovremeno, možete da pomerate prikaz gore i dole pritiskom

na ekran izvan područja aktivnog odabira i njegovim pomeranjem.

Svaki pregled prikazuje područje statusa i njegove simbole, traku menija, glavni prikaz i na donjim prečicama za izbor jezika i opšte postavke za osvetljenje ekrana i postavke jačine zvuka.

Svi korisnici mogu da promene postavke jezika, prikaza ekrana i zvuka. Kada ove promene napravi opšti korisnik one se vrati prilikom isključivanja instrumenta ili odjave korisnika.

Dodirnite ikone na ekranu da biste ostvarili interakciju sa instrumentom.



Slika 6 Početni ekran

1. Područje statusa
2. Traka sa menijem
3. Pregled
4. Izbor jezika
5. Opšta podešavanja

Simboli korisničkog interfejsa za QuikRead go Plus Instrument

	Uzorak za merenje		Prikaz liste radnji
	Kontrola kvaliteta		Početni ekran
	Meni		Obaveštenje
	Štampanje		Izbor jezika
	Komentar		Opšta podešavanja
	Odbaciti /Brisati		Više informacija

Ikone područja statusa

	Indikator nivoa napunjenoosti baterije		Kabl za napajanje povezan (punjenje baterije ako je povezan)
	Upozorenje o niskom nivou napunjenoosti baterije (simbol crveni)		WIFI status
	USB memorija povezana		Povezano sa LIS
	Tastatura povezana		LIS veza je prekinuta
	Povezan čitač bar kodova		LIS rezultati van mreže koji čekaju da budu poslati
	Štampač povezan		

Meni

Svim osobinama instrumenta može se pristupiti iz glavnog menija . Meni ima dugme za *Uzorak za merenje* u gornjoj traci. Pritisnite ovu ikonu za prečicu za merenje uzorka. Gornja traka takođe ima dugme da biste zatvorili meni i vratili se na prethodni prikaz i dugme za početni način da se vrati na početni ekran.




Slika 7 Meni

Obaveštenja

Obaveštenja o instrumentu mogu se videti u *Listi obaveštenja* u traci menija. Ikona se menja kada su dostupna obaveštenja. Odabir obaveštenja sa liste će dati više informacija i usmeravati rešavanje problema. Obaveštenja su kategorisana u tri klase

- Obaveštenja koja nisu kritična za vreme su plave boje, tj. merenje spremno.
- Važne greške su žute boje, tj. greška u vezi sa LIS.
- Greške u sistemu su crvene boje, tj. samotestiranje nije uspelo.


Za više informacija o greškama i rešavanju problema pogledati Odeljak 10 "Rešavanje problema".

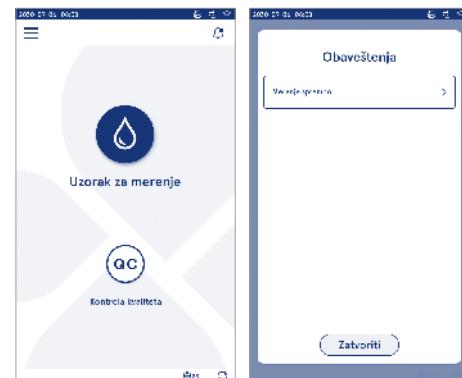

Izbor jezika

Jezik interfejsa se može privremeno promeniti od strane svih korisnika u *Izboru jezika* vidljivom u donjem desnom uglu ekrana. Izbor jezika utiče na meni i jezik uputstva, kao i raspored tastature. Ovaj izbor se vraća na sistemski jezik kada se korisnici odjave ili je instrument isključen.

Korisnik administrator može da promeni sistemski jezik iz *Menija* → *Podešavanja* → *Jezik, prikaz ekrana, zvuk*.

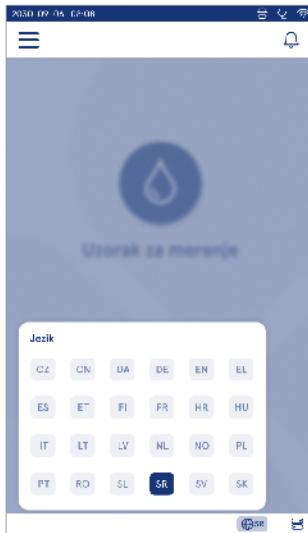


Opšta podešavanja

Opšta podešavanja se mogu privremeno promeniti od strane svih korisnika preko prečice *Opšta podešavanja* vidljive u donjem desnom uglu ekrana. Korisnik može promeniti osvetljenost ekrana, jačinu zvuka upozorenja i jačinu zvuka tastature. Ovi izbori se vraćaju na podrazumevana podešavanja sistema kada se korisnik odjavi ili kada se instrument isključi.

- Osvetljenost ekrana može se podesiti pomeranjem klizača.
- Jačina zvuka upozorenja može se podesiti pomeranjem klizača. Upozorenja se mogu utišati postavljanjem klizača do krajnje leve strane.
- Jačina zvuka tastature se može podesiti pomeranjem klizača. Zvukovi tastature se mogu utišati postavljanjem klizača do krajnje leve strane.

Korisnik administrator može da promeni ova opšta podešavanja iz *Menija* → *Podešavanja* → *Jezik, prikaz ekrana, zvuk*.

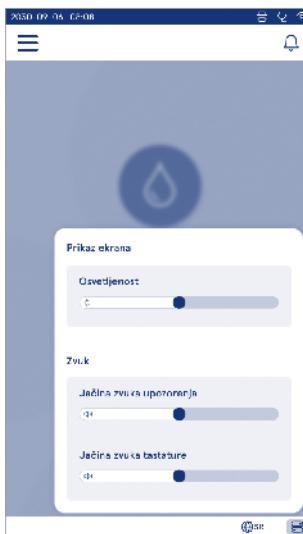

3. RAD INSTRUMENTA

Upotreba QuikRead go Plus Instrument može se podešiti u tri glavne operacije:

- Vršenje merenja
- Pregled rezultata
- Promena podešavanja instrumenta

Vršenje merenja

Instrument se može koristiti u dva režima merenja: merenje uzorka pacijenta i merenje uzorka kontrole kvaliteta. Oba režima se mogu modifikovati putem podešavanja.

Napomena! Samo QuikRead go kompleti reagensa mogu se koristiti za izvođenje testa. Pročitajte uputstva za upotrebu odgovarajućih QuikRead go kompleta reagensa, pre upotrebe. Uputstva daju detaljnije informacije o vršenju testova i rukovanju uzorcima.


Merenje uzorka pacijenata

Kada se treba analizirati uzorak pacijenata, izaberite *Uzorak za merenje* na ekranu. Instrument će voditi korisnika da izvrši QuikRead go test na uzorku pacijenta koji će instrument analizirati i prikazati rezultat na ekranu kada test bude završen.

Za vršenje merenja:

1. Izaberite *Uzorak za merenje* na ekranu i sledite uputstva na ekranu.
2. Umetnите kivet u otvor za merenje sa bar kodom kutive okreнутim prema prednjoj strani (videti [Sliku 8](#))
3. Poklopac se zatvara i instrument započinje merenje. Na ekranu se prikazuje tok analize.
4. Merenje se može prekinuti odabirom отказivanja. Ovo će podići kivet i vratiti pregled na početni ekran.
5. Tokom merenja korisnik može da vidi prethodne rezultate pacijenata i rezultate kontrole kvaliteta i kroz meni pristupi pregledu opisa. Ikona za tok analize biće prikazana na ekranu prilikom drugih pregleda i instrument će obavestiti korisnika kada je merenje spremno.
6. Nakon što se analiza završi, rezultat se prikazuje i kivet se podiže.

7. Uklonite kivetu, *Prihvati* ili *Odbacite* rezultat i ekran se vraća na početni ekran. Možete da vide prethodne rezultate na listi rezultata pacijenta iz *Menija* .

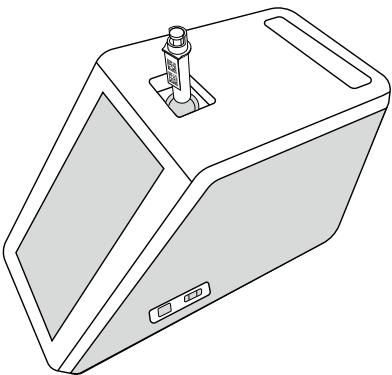

Slika 8

Umetnute kivetu u otvor za merenje sa bar kodom okrenutim ka prednjoj strani.

- Administrator može omogućiti više funkcionalnosti za merenje uzorka pacijenta (pogledajte Odeljak "Merenje").
- ID operatora, ID pacijenta i dodatni ID se mogu omogućiti i instrument će zahtevati da korisnik unese ove izabrane ID da bi se završilo merenje. Pročitajte više o Dodatnom ID u Odeljku "Dodatna podešavanja ID".
- ID se mogu uneti pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili uz pomoć čitača bar kodova ili eksterne tastature. Moguće je omogućiti instrumentu da predloži poslednji korišćeni ID operatera u napomeni kada je prijava onemogućena.

- Takođe se može omogućiti prijava da se od korisnika zahteva da se prijaví na instrument koristeći svoje korisničko ime i lozinku. Prijava automatski ulazi u ID operatera za svako merenje.
- Može se omogućiti merenje u hitnim slučajevima. Kada je omogućeno korisnik može da izvrši test koristeći merenje u hitnim slučajevima bez potrebe za prijavom. Ako je omogućeno, podesiti broj dozvoljenih merenja u hitnim slučajevima. Može se podesiti broj prihvativih merenja u hitnim slučajevima.
- Može se omogućiti režim seriskog merenja. Kada je omogućeno, instrument će automatski započeti novo merenje uzorka pacijenta nakon što korisnik prihvati ili odbije prethodni rezultat.
- Štampanje rezultata i slanje rezultata LIS sistemu mogu se omogućiti putem podešavanja.

Prikaz rezultata uzorka pacijenta

Pregled rezultata uzorka pacijenta je dostupan nakon završene analize. Prikazuju se rezultat analize i informacije o testu. Korisnik može prihvati rezultat i on će biti sačuvan na listi rezultata pacijenta pomoću ikone. Rezultat se može odštampati odabirom ako je štampanje omogućeno i priključen štampač. Komentar se može priložiti uz rezultat. Da biste napisali komentar izaberite . Korisnik može odlučiti da rezultat odbaci odabirom . Kada se odbacuje rezultat korisnik mora ostaviti komentar. Rezultat će se čuvati na listi rezultata pacijenta kao odbačen i detaljne informacije se i dalje mogu pregledati.



Detaljan prikaz rezultata uzorka

Detaljan prikaz rezultata uzorka dostupan je putem Menija → Rezultati pacijenta odabirom linije rezultata. Detaljan prikaz rezultata uzorka dodatno prikazuje serijski ID instrumenta, komentare i dodatne informacije o pacijentu. Za rezultate testa CRP biće prikazana vrsta uzorka. Moguće je dodavati komentare, odabirom i unesite dodatne informacije o pacijentu.



Merenje uzorka za kontrolu kvaliteta

Instrument ima poseban režim merenja za uzorce kontrole kvaliteta koji se mere kao uzorci pacijenata kroz Kontrolu kvaliteta na početnom ekrantu. Rezultati se čuvaju odvojeno od rezultata pacijenata i mogu se videći iz rezultata kontrole kvaliteta u Meniju .

Za izvođenje kontrole kvaliteta izaberite Kontrolu kvaliteta na početnom ekranu i sledite uputstva na ekranu. Administrator može omogućiti više funkcionalnosti za merenje uzorka za kontrolu kvaliteta (pogledajte Odeljak "Podešavanja kontrole kvaliteta").

Kontrolni ID broj se može omogućiti i instrument će zahtevati da ga korisnik unese da bi se izvršila kontrola kvaliteta.

Provera kontrole kvaliteta može se omogućiti da bi se naznačilo da li je rezultat kontrole kvaliteta u okviru podešenog raspona za uzorak kontrole kvaliteta.

Kada je omogućeno zaključavanje kontrole kvaliteta može se omogućiti ograničenje upotrebe instrumenta u slučaju da poslednje merenje kontrole kvaliteta nije uspešno ili je istekao zakazani raspored za kontrolu kvaliteta. Nakon isteka korisnik ne može da meri uzorce pacijenata pre obavljanja kontrole kvaliteta koja je uspešna.

Pregled rezultata kontrole kvaliteta

Pregled rezultata kontrole kvaliteta je dostupan nakon završenog merenja kontrole kvaliteta. Prikazuju se rezultati i informacije o testu. Korisnik može prihvati rezultat kontrole kvaliteta i on će biti sačuvan na listi rezultata kontrole kvaliteta pomoću ikone. Rezultat se može odštampati odabirom ako je štampanje omogućeno i priklučen štampač. Komentar se može prilожiti uz rezultat. Da biste napisali komentar izaberite .



Detaljan pregled rezultata kontrole kvaliteta

Detaljan prikaz rezultata kontrole kvaliteta dostupan je putem *Menija* → *Rezultati kontrole kvaliteta* odabirom linije rezultata. Detaljan prikaz rezultata kontrole kvaliteta dodatno prikazuje koncentraciju kontrole kvaliteta, dodatne informacije o kontroli kvaliteta i komentare. Moguće je dodavati komentare odabirom .




The screenshot shows a detailed view of a control result. At the top, it displays the date and time: 2020-09-06 05:08. Below this is the title 'Rezultat kontrole kvaliteta'. A large section titled 'CRP kontrola' shows the value '20 mg/l'. Underneath, there's a table with columns for 'ID kontrola', 'Vreme', 'Reagens', and 'ID operatera'. The table entries are: ID kontrola - C10190-XXXX, Vreme - 2020-09-06 23:59, Reagens - CRP+Hb, IBLAS | KF35, ID operatera - Komentari. At the bottom right, there are two small icons: a magnifying glass and a clipboard.

Rezultati

Rezultati se mogu pregledati putem *Menija* . Rezultati se čuvaju na zasebnim listama za *Rezultate pacijenata*, *Rezultate kontrole kvaliteta* i *LIS rezultate van mreže*. Pregled rezultata može se pomerati preljestavanjem. Odabir rezultata prikazuje svoje detaljne informacije. Liste rezultata mogu se sortirati dodirom zaglavila kolone.

Pregled liste pacijenata može se pretraživati putem *ID pacijenta* i sortirati po *vremenu*, *testu* i *ID operatera*. Pregled liste rezultata kontrole kvaliteta može se filtrirati po *testu*, *kontrolnom ID broju*, *datumu kontrole kvaliteta* i *ID operatera*. Da biste filtrirali listu pristupite *Prikazu liste radnji*  na traci menija.

Pojedinačni rezultati i liste rezultata mogu se štampati. Liste se mogu štampati sa ili bez filtera i preneti na

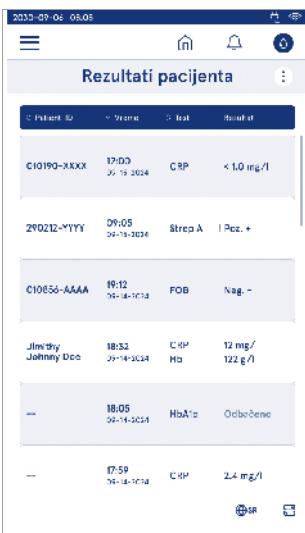

The screenshot shows a list of patient results. The header includes 'Rezultati pacijenta' and filter options for 'ID pacijenta', 'Vreme', 'Test', and 'Stanje'. The list contains six rows of data:

ID pacijenta	Vreme	Test	Stanje
C10190-XXXX	17:00 06-09-2024	CRP	<1.0 mg/l
200212-YYYY	09:05 06-09-2024	Strep A	+ Pez. +
C10650-AAAA	19:12 06-09-2024	FOB	Nag. -
Jimmy Johnny Doe	18:52 06-09-2024	CdP Hb	12 mg/ 122 g/l
--	18:05 06-09-2024	HbA _{1c}	Očekreno
--	17:59 06-09-2024	CRP	2.4 mg/l

At the bottom right, there are two small icons: a magnifying glass and a clipboard.

USB memoriju radi čuvanja. Lista rezultata treba da se filtrira pre nego što se omogući prenos na USB. Za štampanje pojedinačnog rezultata izaberite liniju rezultata i izaberite štampanje na pregledu rezultata. Da biste odštampali listu pristupite *Prikazu liste radnji*  na traci menija.

Brisanje rezultata

Administrator može da izbriše pojedinačne rezultate iz memorije instrumenta. Izaberite rezultat sa liste i izaberite izbriši rezultat sa dna prikaza. Instrument će zahtevati dodatnu potvrdu.

LIS lista van mreže


Menija  → *LIS lista van mreže*

Rezultati koje je napravio instrument sa LIS vezom omogućenom dok je van mreže sačuvani su u *LIS rezultatima van mreže*. Rezultati se čuvaju u slučaju da se veza prekine, npr., zbog trenutnog problema sa mrežom. Rezultati se mogu poslati na LIS nakon što se veza uspostavi ponovo. Nakon što se rezultati prenesu na LIS, oni se uklanjuju sa LIS liste van mreže.

Da biste poslali rezultate van mreže u LIS, izaberite rezultate dodirivanjem polja za potvrdu na liniji rezultata i odabirom *Pošalji*. Da biste izbrisali rezultate, izaberite rezultate koji se brišu i izaberite izbriši rezultat. Svi rezultati mogu se odabratи odjednom tako što ćete dodirnuti polje za potvrdu u redu sa naslovom tabele sa rezultatima.

Kada je omogućen automatski prenos van mreže u opštim podešavanjima LIS, a LIS veza je ponovo uspostavljena iskačući prozor se prikazuje za slanje rezultata van mreže u LIS. Instrument proverava LIS vezu tokom pokretanja i nakon svakog merenja.

4. PODEŠAVANJA

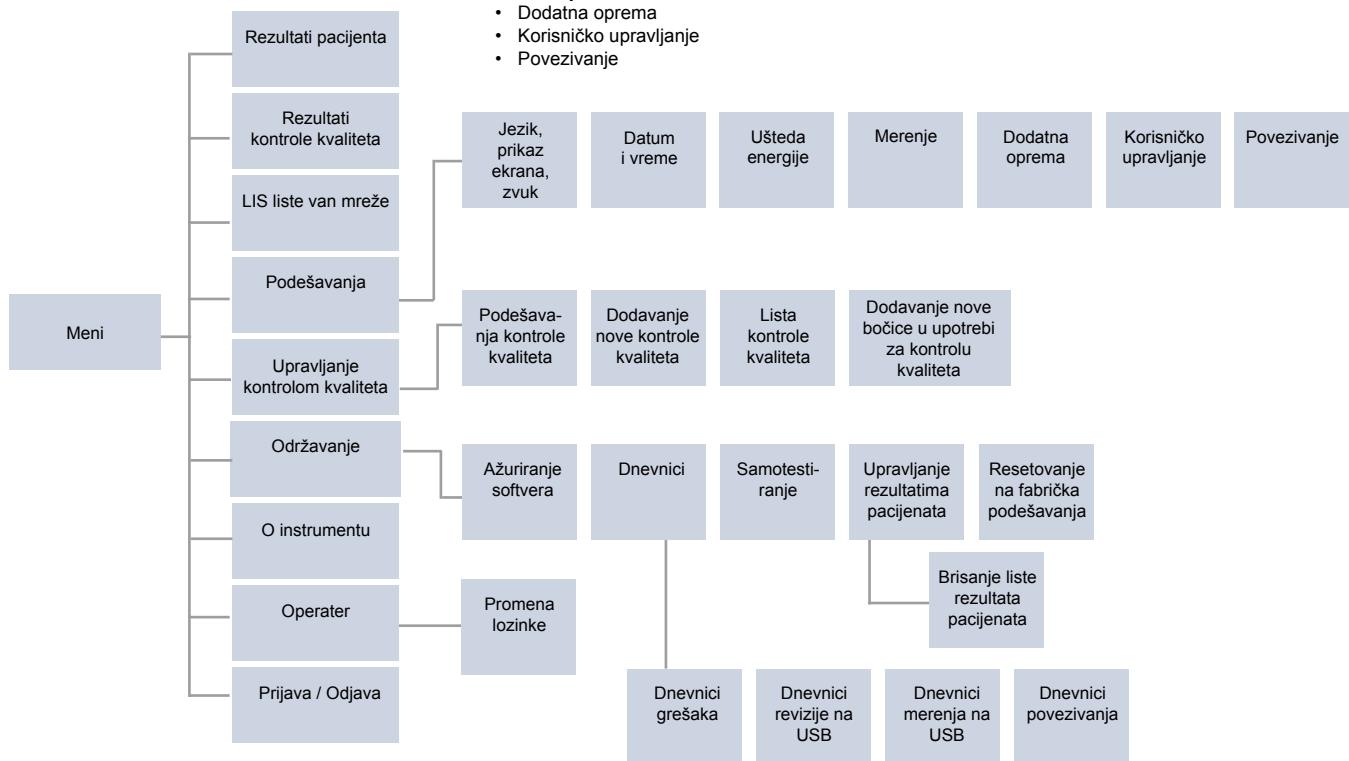

Podešavanjima se može pristupiti iz *Menija* odabirom *Podešavanja*. U podešavanjima, administrator korisnik može postaviti stalna podešavanja za sledeće. Opšti korisnici mogu da promene neka podešavanja i pregledaju ona koja zahtevaju ovlaštenje administratora.

- Jezik, prikaz ekran, zvuk
- Datum i vreme
- Ušteda energije
- Merenje
- Dodatna oprema
- Korisničko upravljanje
- Povezivanje

Napomena! Sistem koristi *Funkciju automatskog čuvanja Sačuvano ✓*. Sve promene biće automatski sačuvane. Kada je automatsko čuvanje aktivno, **Sačuvano ✓** će biti prikazano u traci menija.

Jezik, prikaz ekrana, zvuk

- Meni → Podešavanja → Jezik, prikaz ekrana, zvuk
- Jezik sistema se može menjati odabirom jezika iz date selekcije. Izbor jezika utiče na meni i jezik uputstva, kao i raspored tastature.
 - Osvetljenost ekrana može se podesiti pomeranjem klizača.
 - Jačina zvuka upozorenja može se podesiti pomeranjem klizača. Možete utišati zvukove upozorenja postavljanjem klizača do krajnje leve strane.
 - Jačina zvuka tastature se može podesiti pomeranjem klizača. Možete utišati zvukove tastature postavljanjem klizača do krajnje leve strane.

Datum i vreme

- Meni → Podešavanja → Datum i vreme

- Format datuma može se promeniti iz date selekcije. Datum se može menjati postavljanjem novog datuma.
- Format sata može se menjati između 24h i 12h formata. Trenutno vreme se može menjati postavljanjem novog vremena.

Napomena! Instrument proverava datum isteka Quik-Read go reagensa pre merenja. Postavljanje pogrešnog datuma može ograničiti upotrebu reagensa zbog neuspele provere datuma isteka.

Ušteda energije

- Meni → Podešavanja → Ušteda energije

- Odgađanje režima mirovanja se može menjati pomeranjem klizača. Nakon tog vremena instrument ulazi u režim mirovanja.
- Funkcionisanje režima mirovanja se može menjati iz date selekcije.
 - » Potpuno stanje pripravnosti: U stanju mirovanja instrument zatvara poklopac i zatamni ekran pre nego što ga isključi. Ekran se može pokrenuti dodirom ekranu ili brzim pritiskom na dugme za uključivanje.
 - » Samo zatvorite poklopac: U režimu mirovanja instrument zatvara poklopac i ekran se zatamnjuje.

Merenje

- Meni → Podešavanja → Merenje


- Promenite parametre testa odabirom testa. Svaki analit ima određena podešavanja za tu vrstu testa.
- Režim seriskog merenja može biti omogućen ili one mogućen. Kada je omogućen, instrument će automatski pokrenuti novo merenje uzorka pacijenta nakon prihvatanja ili odbacivanja prethodnog rezultata.
- Može se omogućiti ili onemogućiti režim merenja u hitnim slučajevima. Kada je omogućeno korisnik može da izvrši test koristeći merenje u hitnim slučajevima bez potrebe za prijavom. Ako je omogućeno, podesite broj dozvoljenih merenja u hitnim slučajevima.
- Ako je omogućeno, podesite broj dozvoljenih mera u hitnim slučajevima.

Parametri testa

- Meni → Podešavanja → Merenje → Parametri testa

- Promenite izbor jedinice u kojoj su jedinici (jedinicama) prikazani rezultati za test. Za neke testove moguće je prebacivanje između kvantitativnih i kvalitativnih rezultata.
- Ako je odabранo više jedinica za prikazivanje rezultata, može se odabrati i jedinica u kojoj se rezultat šalje u LIS.
- Mogu se podesiti ograničenja indikatora za svaki test. Ograničenja se mogu podesiti za niske, snižene, povišene i/ili visoke rezultate. Pregled rezultata testa prikazuje podešena ograničenja indikatora i rezultat. Ako je rezultat ispod granice za snižene rezultate, jedna strelica okrenuta prema dole biće prikazana pored rezultata. Slično tome, ako je rezultat


ispod granice za visoke rezultate, biće prikazane dve strelice okrenute prema gore, a ako je rezultat iznad ograničenja za povišene rezultate, biće prikazana jedna strelica okrenuta prema gore, a ako je rezultat iznad granice za visoke rezultate, biće prikazane dve strelice okrenute prema gore.

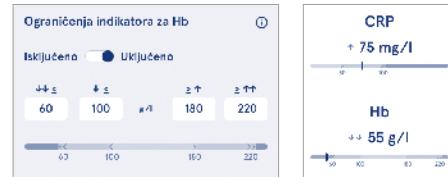

- Za kvalitativne rezultate indikator se može podesiti na "Poz +" ili "Neg -". Kada je rezultat uzorka u skladu sa izborom, pored rezultata će biti prikazan znak uzičnika. Kada je omogućen, prikaz rezultata će prikazati tekst „Indikator rezultata uključen“ za sve rezultate.



Označavanje vrste uzorka se može omogućiti za neke testove. Kada je omogućeno, instrument će prikazati grešku kada otkrije pogrešnu vrstu uzorka tokom merenja.

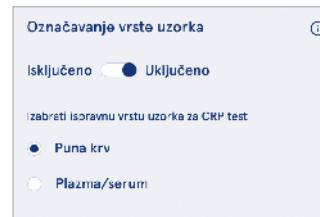

Dodatna oprema

Meni → Podešavanja → Dodatna oprema

Štampanje može biti omogućeno ili onemogućeno. Kada je štampanje omogućeno i povezan je kompatibilni štampač, može se omogućiti automatsko štampanje. Sa automatskim štampanjem, rezultati svakog uzorka će se automatski poslati na štampač.

CRP	21 mg/l	QuikRead go Plus
Hb	100 g/l	38/A22064512288
Patient ID	Joe Smith	
Operator ID	Nurse 1	JE45
Time	2021-01-29 10:18	JF08
Sample type	Whole blood	2025-01-29

Slika 9 QuikRead go Plus rezultat kada se odštampa

Korisničko upravljanje

Meni → Podešavanja → Korisničko upravljanje

Podešavanja operatera

- ID operatera može biti omogućeno ili onemogućeno. Kada je omogućeno, instrument će zatražiti od korisnika da uđe u ID operatera prilikom vršenja merenja.
- Kada je omogućeno, možete izabrati da omogućite da se svaki put predloži prethodno uneseni ID operatera.
- Prijava može biti omogućena ili onemogućena. Ako je omogućeno, korisnik se mora prijaviti korišćenjem svoje lozinke.
- Kada je omogućeno, možete odabratи nakon kog perioda neaktivnosti će se korisnik automatski odjaviti pomoću klizača. Takođe možete da izaberete automatsku odjavu korisnika nakon svakog merenja.

Napomena! Izričito se preporučuje da se omogući prijavljivanje lozinkom kako bi se osigurala bezbednost informacija, posebno u okruženjima sa niskim fizičkim bezbednosnim merama, kao što su zajednički ili otključani radni prostori ili prilikom posete pacijentima.

- Ako je omogućena prijava, možete izabrati omogućavanje liste operatera na daljinu. Ova opcija se može omogućiti kada instrument ima omogućenu POCT01-A2 vezu. Kada je omogućeno, listom operatera upravlja LIS posredni softver i ne može se uređivati putem instrumenta. Omogućavanje prijave će onemogućiti predlaganje prethodnog izbora.
- Pregledanje liste rezultata pacijenata može se omogućiti ili onemogućiti.
- Pregledanje liste rezultata kontrole kvaliteta može se omogućiti ili onemogućiti za opšte korisnike.

Napomena! Kada se prijavljuje kao administrator lista rezultata pacijenata i lista kontrole kvaliteta su uvek dostupne za pregled.

Upravljanje operaterima

Meni → Podešavanja → Korisničko upravljanje → Upravljanje operaterima

- Administrator može da dodaje nove operatore, da vidi kompletan listu operatera i uloge i da uređuje naloge.
- Kada dodajete novi ID operatera:
 - Izaberite *Ulogu operatera* (opšta/admin.)
 - Unesite ID operatera
 - Unesite lozinku
 - Unesite ime i prezime operatera
- Prilikom uređivanja naloga, korisnička lozinka se može promeniti.

Pogledajte tabelu prava korisničke uloge na stranici 53.

Podešavanja pacijenata

ID pacijenta može biti omogućen ili onemogućen. Kada je omogućeno, instrument će zatražiti od korisnika da uđe u ID pacijenta prilikom vršenja merenja.

Dodatna podešavanja ID


Dodatni ID se može koristiti kao dodatno tekstualno polje ili sa izbor sa unapred definisane listi stavki dodatnog ID za svako merenje uzorka pacijenta. Kada je dodatni ID omogućen, instrument će zahtevati od korisnika da unese dodatni ID prilikom obavljanja merenja. Da biste uneli stavke dodatnog ID sa liste ili prilagodili ime liste, izaberite *Upravljanje dodatnim ID*.

Upravljanje dodatnim ID

Meni → Podešavanja → Korisničko upravljanje → Upravljanje dodatnim ID

Unesite stavke dodatnog ID sa liste tako što ćete izabrati *Dodaj stavku liste*. Dodavanjem stavke liste aktiviraće se dugme liste pored tekstualnog polja kada se vrši merenje (**Slika 10**).

Prilagodite ime liste tako što ćete izabrati *Uredi* pored naziva liste. Ovo će zameniti naslov *Dodatni ID* prilikom vršenja merenja (**Slika 10**).

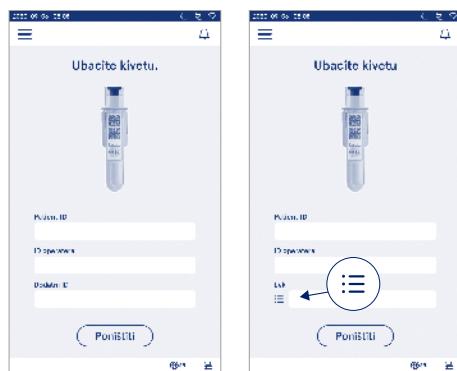

Slika 10 Dodatni ID

Kada su stavke dodatnog ID na listi unapred definisane, dugme liste se aktivira pored polja za tekst (desno). Nakon što imate liste dodatnog ID bude uređeno, ime će biti prikazano iznad tekstualnog polja (desno).

Povezivanje

Meni → Podešavanja → Povezivanje

Instrument se može povezati sa laboratorijskim ili bolničkim informacionim sistemom (LIS/HIS) preko LAN ili WLAN veze. Ove veze se mogu koristiti za automatski prenos podataka između instrumenta i sistema za da-ljinsko upravljanje i pregled rezultata.

Obratite se svom dobavljaču za više informacija o povezivanju.

Napomena! Obratite se svojoj administraciji sistema za podešavanja povezivanja.

LIS

Meni → Podešavanja → Povezivanje → LIS

- LIS povezivanje može biti omogućeno ili onemogućeno. Kada je omogućeno, može se odabratи automatski prenos rezultata. Ako je veza prekinuta, rezultati koji su generisani, ali nisu poslati u LIS, biće vidljivi u LIS pregledu rezultata van mreže (pogledajte Odeljak "LIS lista van mreže")
- Vrsta veze se može izabrati. Dostupne vrste veze su:
 - » POCT1-A2
 - » LIS01-A2 (TCP/IP)
 - » LIS01-A2 (RS232)
- Adresa LIS servera i TCP port se mogu promeniti.
- Konverzacijski interval se može promeniti pomoću kličača.
- TLS enkripcija može biti omogućena. TLS sertifikat se može učitati sa USB memorije.
- Može se omogućiti validacija identifikatora pacijenta. Kada je omogućeno, instrument će proveriti ID pacijenta iz POCT01-A2 posrednog servera. Ako je uneseni ID pacijenta nevažeći, instrument će dati poruku o grešci.
- Prikazani podaci o pacijentu se mogu omogućiti. Kada je omogućeno, instrument će preuzimati podatke o pacijentu iz POCT01-A2 posrednog servera na osnovu unesenog ID pacijenta.
- Prenos rezultata van mreže može se prebacivati između automatskog i ručnog režima. Kada se izabere automatski režim LIS rezultati van mreže će se automatski preneti kada se veza ponovo uspostavi. Kada

se izabere ručni režim, korisnik će morati da izabere rezultate koje će preneti u LIS.

TCP/IP

Meni → Podešavanja → Povezivanje → TCP/ IP

- Vrsta IP adrese se može prebacivati između statičke i dinamičke IP adrese.
- IP adresa se može promeniti.
- Podmrežna maska se može promeniti.
- Podrazumevani mrežni prolaz se može promeniti.
- DNS server se može promeniti.

WLAN

Meni → Podešavanja → Povezivanje → WLAN

WLAN povezivanje može biti omogućeno ili onemogućeno. Kada je omogućena veza se može podesiti skeniranjem dostupnih WLAN mreža odabirom Skeniranja ili ručnim podešavanjem. Skeniranje će prikazati listu dostupnih WLAN mreža. Izaberite željenu mrežu sa liste. Ako je mreža zaštićena lozinkom, pojaviće se iskačući prozor.

5. UPRAVLJANJE KONTROLOM KVALITETA

Upravljanju kontrolom kvaliteta se može pristupiti iz Menija → odabirom Upravljanje kontrolom kvaliteta. Podešavanja upravljanja kontrolom kvaliteta kontrolišu funkciju merenja kontrole kvaliteta namenjenu praćenju performansi instrumenta pomoću QuikRead go kompleta reagensa i kontrola.

Podešavanja kontrole kvaliteta

Meni → Upravljanje kontrolom kvaliteta → Podešavanja kontrole kvaliteta

Kontrolni ID broj se može omogućiti i instrument će zahtevati da ga korisnik unese da bi se izvršila kontrola kvaliteta.

Ako je omogućena, provera kontrole kvaliteta može se omogućiti da bi se naznačilo da li je rezultat kontrole kvaliteta u okviru podešenog raspona za uzorak kontrole kvaliteta. Kada je omogućena provera kontrole kvaliteta i rezultat kontrole kvaliteta je u okviru prihvaćenog raspona, uspešna kontrola kvaliteta će se prikazati sa rezultatom. Ako je rezultat kontrole kvaliteta izvan raspona prikazaće se neuspela kontrola kvaliteta. Rezultat van raspona će biti prikazan sa rezultatom.



Kada je omogućeno zaključavanje kontrole kvaliteta može se omogućiti ograničenje upotrebe instrumenta u slučaju da poslednje merenje kontrole kvaliteta nije uspelo ili je istekao zakazani raspored za kontrolu kvaliteta. Nakon isteka korisnik ne može da meri uzorke pacijenata pre obavljanja kontrole kvaliteta koja je uspešna. Podesite raspored i izaberite na dnevnoj os-

novi, nakon izabranih broja testova ili izabranih dana. Instrument će zahtevati ulaz za poslednja dva. Ako je raspored podešen na dnevnoj osnovi, zaključavanje kontrole kvaliteta će postati aktivno sledećeg dana ako merenje kontrole kvaliteta nije izvršeno. Ako je raspored podešen za izabrane dane, zaključavanje kontrole kvaliteta će postati aktivno sledećeg dana ako merenje kontrole kvaliteta nije izvršeno na vreme.

Dodavanje nove kontrole kvaliteta

Meni ≡ → Upravljanje kontrolom kvaliteta → Dodavanje nove kontrole kvaliteta

Dodavanje nove kontrole kvaliteta se koristi za unos informacija o novoj kontroli kvaliteta (QC) kada je podešavanje kontrolnog ID broja omogućeno u podešavanjima kontrole kvaliteta. Dodata kontrola kvaliteta će biti dostupna za izbor prilikom vršenja merenja kontrole kvaliteta. Instrument će koristiti kontrolne informacije kada utvrđuje da li je kontrola kvaliteta bila uspešna ili nije uspela.

Naziv kontrole kvaliteta se može uneti da bi se podesio naziv vidljiv na listi za izbor kontrole kvaliteta. Jedinica kontrole kvaliteta prikazana sa rezultatima može se promeniti. Raspon kontrole kvaliteta je obavezan i koristi se za određivanje da li je merenje kontrole kvaliteta pomoći kontrolnog ID broja bilo uspešno ili nije uspelo. Koncentracija kontrole kvaliteta je obavezna i predstavlja ciljnu vrednost kontrolnog merenja. Iste serijske kontrole kvaliteta je obavezan i koristi se za proveru da li se reagensi kojima je istekao rok upotrebe koriste za kontrolu kvaliteta.

Može se podesiti rok trajanja boćice za kontrolu kvaliteta u upotrebi. Kontrolne boćice QuikRead go kompletne reagensa imaju datum isteka i poseban datum isteka upotrebe nakon što se otvore. Da bi se pomoglo u upravljanju periodima isteka roka boćice za kontrolu kvaliteta u upotrebi, instrument nudi opciju da se unese datum poslednje upotrebe za otvorenou boćicu za kontrolu kvaliteta. Prilikom obavljanja kontrole kvaliteta i odabira kontrolnog ID broja ako je datum isteka otvorene boćice prošao, instrument prikazuje iskačući prozor. Iskačući prozor predlaže otvaranje nove boćice i unos nove otvorene boćice u upotrebi sa datumom isteka.

Dodata informacija o kontroli kvaliteta mogu se uneti za svaki kontrolni ID broj.

Napomena! Pogledajte etiketu i uputstva za upotrebu kontrole prilikom unosa informacije za novu kontrolu.

Dodavanje nove boćice u upotrebi za kontrolu kvaliteta

Meni ≡ → Upravljanje kontrolom kvaliteta → Dodavanje nove boćice za kontrolu kvaliteta u upotrebi

Datum isteka nove boćice za kontrolu kvaliteta u upotrebi može se uneti za postojeći kontrolni ID broj. Izaberite kontrolni ID broj kojem želite da dodate novu boćicu za kontrolu kvaliteta u upotrebi sa datumom isteka sa liste. Povjaviće se iskačući prozor sa uputstvom za podešavanje.

Datum se može dodati kao datum ili kao broj dana od datuma unosa. Prethodno uneseni datum isteka otvorene boćice se može izbrisati.

Napomena! Proverite rok isteka dok je u upotrebi u uputstvu za upotrebu kontrole.

Lista kontrole kvaliteta

Meni ≡ → Upravljanje kontrolom kvaliteta → Lista kontrole kvaliteta

Informacije o kontrolnom ID broju se mogu pregledati i promeniti sa liste kontrole kvaliteta. Prikaz liste prikazuje naziv, datum isteka, test i raspon za svaku kontrolu. Lista se može sortirati pomoći zaglavljima kolona.

6. MENI ZA ODRŽAVANJE

Meniju za održavanje se može pristupiti iz *Menija* → *Održavanje*.

Ažuriranje softvera

Meni → *Održavanje* → *Ažuriranje softvera*

Verzija softvera instrumenta može se ažurirati uz pomoć USB memorije. Obratite se svom lokalnom dobavljaču za više informacija o ažuriranjima softvera.

Dnevnići

Meni → *Održavanje* → *Dnevnići*

Instrument evidentira merenja, greške i dnevnike povozivanja i revizije u svojoj memoriji. Pročitajte sledeće odeljke za dodatne informacije.

Dnevnik grešaka

Meni → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Dnevnik grešaka*

Greške instrumenta se čuvaju u njegovoj memoriji. Prethodne greške se mogu videti u dnevniku grešaka. Pregled se može sortirati dodirom zaglavja kolona. Kodovi grešaka se mogu preneti na USB memoriju tako što ćete izabrati prenos na USB u traci menija.

Dnevnići revizije na USB

Meni → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Dnevnići revizije na USB*

Dnevnići revizije sadrže informacije o prijavi, evidenciju o aktivnostima merenja uzorka, odbacivanjima rezulta, brisanjima rezultata i brisanjima dnevnika. Dnevnići se mogu koristiti za praćenje upotrebe instrumenta. Dnevnići revizije instrumenta se mogu preneti na USB memoriju.

Dnevnići merenja na USB

Meni → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Dnevnići merenja na USB*

Dnevnići merenja se koriste za rešavanje problema od strane kompanije Aidian, na primer u slučaju žalbe korisnika. Dnevnići merenja su šifrovani i dostupni samo za osoblje kompanije Aidian. Oni sadrže evidenciju performansi instrumenta bez informacija o pacijentu ili korisniku.

Dnevnići povezivanja

Meni → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Dnevnići povezivanja*

Dnevnići povezivanja se mogu čuvati u memoriji. Promenite kolekciju dnevnika LIS.

Dnevnići povezivanja se mogu preneti na USB memoriju.

Samotestiranje

Meni → *Održavanje* → *Samotestiranje*

Instrument vrši proveru rada kako bi se osiguralo ispravno funkcionisanje. Da biste ručno izvršili samotestiranje, izaberite *Da*. Sistem će se vratiti na početni ekran nakon završetka.

Upravljanje rezultatima pacijenata

Meni → *Održavanje* → *Upravljanje rezultatima pacijenata*

Trajanje čuvanja rezultata pacijenta može se podestiti ili promeniti. Podesite vreme skladištenja u godinama, danima ili satima. Stariji rezultati pacijenata će se automatski izbrisati nakon izabranog vremena. Ako se ostavi prazno instrument neće izbrisati rezultate na osnovu vremena.

Maksimalan broj rezultata pacijenata u memoriji se može promeniti. Kada se dostigne granica, instrument će automatski izbrisati najstariji rezultat iz memorije.

Brisanje liste rezultata pacijenata

Meni → *Održavanje* → *Brisanje liste rezultata pacijenata*

Lista rezultata pacijenata može se u potpunosti izbrisati. Ova opcija se može koristiti u svrhu zaštite podataka.

Resetovanje na fabrička podešavanja

Meni → *Održavanje* → *Resetovanje na fabrička podešavanja*

Instrument se može resetovati na fabrička podešavanja.

7. PRIKAZ O INSTRUMENTU

Prikaz O instrumentu prikazuje serijski broj instrumenta, aktuelnu verziju softvera i informacije o vezi. Pored toga, instrument se može imenovati. Nakon imenovanja, naziv instrumenta se prikazuje u donjem levom uglu ekrana u svim prikazima.

Prikazu O instrumentu se može pristupiti iz *Menija* → *O instrumentu*.

8. ODRŽAVANJE INSTRUMENTA

QuikRead go Plus Instrument je osmišljen da bude lak za upotrebu bez potrebe za redovnim održavanjem. Za potrebe popravke i servisiranja obratite se lokalnom dobavljaču.

Kalibracija instrumenta

Instrument je fabrički kalibriran. Pravilno funkcionisanje instrumenta se proverava postupkom samoprovjere tokom pokretanja i pri svakom merenju. U slučaju kvara, prikazuje se poruka o grešci. Podaci o kalibraciji koji definiraju svaki test su kodirani na etiketama na kitvetama. Ovu informaciju instrument automatski čita pri svakom merenju.

Čišćenje instrumenta

Povremeno očistite spoljašnjost instrumenta krpom koja ne ostavlja dlačice navlaženom vodom. Obratite posebnu pažnju na čišćenje ekrana. Vodite računa da nikakva tečnost ne uđe u instrument kroz ivice ekrana, merni otvor ili kroz priključke. Ako je potrebno, može se koristiti blagi deterdžent. Nemojte koristiti organske rastvarače ili klorozivne supstance. Prosuti potencijalno infektivni materijal treba odmah obrisati upijajućom papirnom maramicom, a kontaminirana područja prebrisati standardnim dezinfekcionim sredstvom ili 70% etil alkoholom. Materijale koji se koriste za čišćenje prostog materijala, uključujući rukavice, treba odložiti kao biološki opasan otpad.

Prihvativljiva dezinfekcionala sredstva:

- 70% etil alkohol
- 70% izopropanol
- 0,5% natrijum hipohlorit
- 2% glutaraldehid

Ažuriranje softvera

Softver instrumenta se može ažurirati. Pristupite ažuriranju softvera preko *Meni* → *Održavanje* → *Ažuriranje softvera* i pratite uputstva na ekranu. Obratite se svom lokalnom dobavljaču za više informacija.

Zamena baterije sata

Instrument ima bateriju za unutrašnji sat da bi se pratio vreme kada je isključen. Ako je punjenje baterije sata pri kraju, prikazuje se upozorenje. Baterija sata se može zameniti baterijom tipa CR 2032 3V (**Slika 3**).

9. SPECIFIKACIJA INSTRUMENTA

Deklaracija o usaglašenosti

QuikRead go Plus Instrument je usklađen sa uredbom (EU) 2017/746 o *in vitro* dijagnostičkim medicinskim sredstvima, direktivom 2011/65/EU o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi zajedno sa delegiranim direktivom (EU) 2015/863 o izmenama i dopunama Aneksa II Direktive 2011/65/EU i Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE). QuikRead go Plus Instrument je usaglašen sa zahtevima za elektromagnetu emisiju i otpornost opisanim u standardu IEC 61326-2-6:2012. Instrument ispunjava zahteve FCC klase A. QuikRead go Plus Instrument je u skladu sa uredbom (EU) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija (REACH). Instrument je takođe usklađen sa direktivom o radio opremi 2014/53/EU.

Za dodatne informacije kontaktirajte svog lokalnog dobavljača.

Tehnička specifikacija

Instrument ima unapred programirani mikroprocesor koji kontroliše korake analize i obradu podataka. Podaci o identifikaciji testa, vremenu i kalibracionoj krivoj ili graničnoj vrednosti nalaze se na bar kodu na svakoj kivet. Nakon što bude aktiviran etiketom kivete, mikroprocesor kontroliše i vodi sve korake analize i pretvara vrednosti apsorbancije uzoraka u jedinicu koncentracije ili granične vrednosti.

Fotometar

Fotometar QuikRead go Plus Instrument se sastoji od mernog otvora, tri LED diode i detektora svetlosti. Fotometar je osmišljen i kalibriran kako za fotometrijsku tako i turbidimetrijsku merenja.

Ekran osetljiv na dodir

Korisnički interfejs je zasnovan na kapacitivnom ekranu osetljivom na dodir koji je jednostavan za korišćenje. On pruža korisniku poruke, upite i animacije za izvođenje svakog koraka analize i prikazuje rezultate testa i poruke o grešci.

Dimenzije i zahtevi za napajanje

- Težina: 2,0 kg bez napajanja
- Veličina: 26,9 x 16,6 x 13,9cm
- Zahtevi za napajanje
 - Napon: 100-240 V AC
 - Frekvencija: 50-60 Hz
 - Potrošnja energije:
 - Prazan rad 4 W
 - Mirovanje 1 W
 - Maks. 35 W (bez eksterne dodatne opreme)
 - Napajanje 18V = 3.3A

Identifikator instrumenta

Svaki QuikRead go Plus Instrument ima jedinstveni serijski broj koji se može naći na etiketi na dnu instrumenta i u prikazu O instrumentu koji je dostupan iz *Menija* → *Meni*.

Memorija

QuikRead go Plus Instrument ima internu memoriju za istoriju rezultata i evidencije. Instrument može da uskladišti 6.000 rezultata pacijenata i 6.000 rezultata kontrole kvaliteta.

Napajanje strujom

Instrument se napaja iz izvora napajanja koji se isporučuje sa instrumentom. Pored napajanja strujom, instrument može da koristi bateriju kao izvor napajanja. Unutrašnji prekidač unutar priključka za kabl će se automatski prebaciti sa upotrebe na baterije na napajanje iz mreže. Za uputstva o postavljanju baterije pogledajte Odeljak „Umetanje punjive baterije“.

Radio modul

Wi-Fi Dual Band 2,4 GHz/5 GHz i Bluetooth modul Panasonic model: PAN9028.

LIS veza

Veza se može napraviti pomoću:

- RJ-45 konektor i podržana 10BASET/ 100BASE-TX/1000BASE-TX Ethernet veza. Treba koristiti neoklopjeni kabl sa upredenim paricama.
- WLAN veza.
- Napajanje preko Ethernet (PoE) nije podržano.

Obratite se svom dobavljaču za više informacija.

USB veza

Instrument ima tri USB konektora tipa A i dva USB konektora tipa C. Ovi konektori se mogu koristiti za štampače, čitače bar kodova, tastature i USB memorije.

Servisiranje

QuikRead go Plus Instrument je konstruisan da ne zahteva redovno održavanje sa ugrađenim radnjama samoprovore. U slučaju kvara na instrumentu, obratite se svom lokalnom dobavljaču. Pre slanja instrumenta u servis, izbrisite sve rezultate pacijenata iz prikaza održavanja tako što ćete izabrati listu rezultata pacijenata za brisanje i očistiti spoljašnjost instrumenta. Pogledajte odjeljak „Čišćenje instrumenta“.

Garancija

Garancija proizvođača za QuikRead go Plus Instrument pokriva nedostatke u materijalu ili proizvodnji u periodu od dve godine od datuma kupovine. Da bi garancija bila važeća, garantni pečat (**Slika 3**) mora biti netaknut. Proizvođač je saglasan da popravi ili zameni instrument ako on prestane da radi zbog kvara bilo kog unutrašnjeg dela instrumenta. Garancija ne pokriva štetu nastalu nepravilnim korišćenjem. Proizvođač nije u obavezi da modifikuje ili ažurira instrument nakon što je proizveden osim ako se ne identifikuje nedostatak nastao prilikom proizvodnje. U slučaju kvara na instrumentu, obratite se svom lokalnom dobavljaču.

Odlaganje

QuikRead go Plus Instrument je niskonaponski elektronski uređaj. Korišćeni QuikRead go Plus Instrument mora se tretirati kao potencijalno biološki opasan otpad. Instrument treba odložiti kao otpad električne i elektronske opreme (WEEE 2012/19/EU) ako lokalni i nacionalni zakoni ne zahtevaju da se instrument prikupe i odaže kao potencijalno infektivni klinički otpad. Više informacija o odlaganju instrumenata možete pronaći na našoj internet stranici [aidian.eu](#).

Materijali za pakovanje su materijali koji se mogu reciklirati. Jedinicu baterije i unutrašnju bateriju sata treba odložiti u skladu sa nacionalnim i lokalnim pravilima za prikupljanje baterija na osnovu Direktive 2006/66/EC ili Uredbe o baterijama 2023/1542/EU.

Istorija revizija

Istoriju revizija možete pronaći na [aidian.eu](#).

Pojasni frekvencija i njihove maksimalne snage radio-frekvencije:

Podržane tehnologije	Radni režim	Pojas	Frekvencijski opseg	Maksimalna sprovedena srednja izlazna snaga	Pojačanje antene (integrisana čip antena)		Maksimalna izražena srednja izlazna snaga
					[MHz]	[dBm]	
Bluetooth	Osnovna brzina (eng. Basic Rate, BR)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4		2.1	<10
Bluetooth	Poboljšana brzina prenosa podataka (eng. Enhanced Data Rate, EDR)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4		2.1	<10
Bluetooth	Niska energija (eng. Low energy, LE)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4		2.1	<10
WLAN	IEEE 802.11b/g/n	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	16		2.1	<19
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 150... 5 250	16		1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 250... 5 350	16		1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 470... 5 725	16		1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 725... 5 825	16		1.5	<18

10. REŠAVANJE PROBLEMA

QuikRead go Plus Instrument prikazuje poruke o greškama i vodi korisnika u slučaju da otkrije greške. Pratite prikazana uputstva i pogledajte tabelu za rešavanje problema u ovom uputstvu za upotrebu i uputstva za upotrebu za QuikRead go komplet.

Napomena! Za više podrške za rešavanje problema posetite aidian.eu ili kontaktirajte svog lokalnog dobavljača.

Poruka o grešci / Rešavanje problema	Mogući uzrok	Korektivna radnja
Prikazuje se kod greške sa porukom „Ponovo pokrenite QuikRead go Plus“.	Privremeni kvar instrumenta.	Ponovo pokrenite instrument. Ako se ova poruka o grešci često prikazuje, обратите се слуžби за кориснику подршку.
Prikazuje se kod greške sa porukom „Obratite se službi za korisničku podršku“.	Trajni kvar instrumenta.	Obratite се слуžби за корисниčку подршку.
„Nivo napunjenoosti baterije je nizak. Povežite na mrežni kabl da biste nastavili sa radom“. Prikazuje se poruka o grešci.	Napunjenošt baterije je niska.	Povežite jedinicu за напајање у конектор за напајање QuikRead go Plus Instrument.
„Položaj kivete nije pravilan. Uklonite kivet.“, prikazuje se poruka o grešci.	Ostaci folije за заптивање кивете су остали на оковратнику кивете.	Uklonite kivetu kada је instrument podigne. Proverite да ли су сви остаци уклонjeni приликом вршења следећег мерења.
	Instrument ima mehanički kvar.	Proverite stavku iznad. Ako се не може применити, ponovo покрените instrument. Ako проблем и даље постоји, обратите се слуžби за кориснику подршку.

Poruka o grešci / Rešavanje problema	Mogući uzrok	Korektivna radnja
"Zabranjeno merenje."	Poklopac reagensa nedostaje ili se koristi kiveta.	Proverite da li kiveta ima poklopac za reagens i da unutrašnji obojeni deo poklopcu nije pritisnut ka dole.
	Čitanje podataka serije sa bar koda nije uspelo.	Pokušajte ponovo. Ako problem i dalje postoji, otkažite test.
	Rok kompleta serije je istekao.	Odbacite komplet sa isteklim rokom. Upotrebite novi.
	Temperatura kivete je preniska.	Pustite da se kiveta zagreje na sobnu temperaturu. Ponovo testirajte istu kivetu.
	Temperatura kivete je previsoka.	Pustite da se kiveta ohladi na sobnu temperaturu. Ponovo testirajte istu kivetu.
"Test je otkazan."	Slepi uzorak je previsok.	Ponovo testirajte istu kivetu. Proces slepe analize nije završen ili uzorak može sadržati ometajuće supstance. U poslednjem slučaju, test se ne može završiti.
	Nestabilan slepi uzorak.	
	Greška u dodavanju reagensa.	Uradite novi test. Došlo je do nekog problema tokom dodavanja reagensa. Proverite da li je poklopac pravilno zatvoren.
	Kvar instrumenta.	Uradite novi test. Ako se ova poruka često pojavljuje, obratite se službi za korisničku podršku.
QuikRead go Plus Instrument se ne pokreće.	Jedinica za napajanje nije povezana.	Povežite jedinicu za napajanje i pokušajte ponovo.
	Baterija se ispraznila.	Povežite kabl za napajanje i pokušajte ponovo.
	Instrument ima elektronski kvar.	Obratite se službi za korisničku podršku.

Poruka o grešci / Rešavanje problema	Mogući uzrok	Korektivna radnja
Ecran osetljiv na dodir ne funkcioniše ispravno.	Ploča na dodir uopšte ne reaguje.	Obratite se službi za korisničku podršku.
Ne čuje se zvuk alarma instrumenta.	Jačina zvuka je podešena na nizak nivo.	Podesite jačinu zvuka prema proceduri opisanoj u Odeljku „Jezik, prikaz ekrana, zvuk“.
	Sistem zvuka instrumenta ima kvar.	Ponovo pokrenite QuikRead go Plus Instrument. Ako problem i dalje postoji, obratite se službi za korisničku podršku.
Štampač ne štampa.	Štampač je isključen ili kabl štampača nije povezan ili se štampač pokvario ili podešavanja nisu ispravna.	Proverite da li je štampač povezan i da li je uključen. Proverite podešavanja. Ako se problem nastavi, pokrenite instrument i štampač i ponovo pokušajte da štampate iz menija Rezultati. Ako se problem i dalje nastavi, obratite se službi za korisničku podršku.
Čitač bar kodova ne radi.	Čitač bar kodova nije povezan ili čitač bar kodova ima kvar ili podešavanja nisu ispravna.	Proverite da li je čitač bar kodova povezan. Proverite podešavanja. Ako se problem nastavi, pokrenite instrument i ponovo pokušajte da pokrenete čitač bar kodova. Ako se problem i dalje nastavi, obratite se službi za korisničku podršku.
Baterija se mora često puniti.	Kapacitet baterije se smanjuje tokom njenog životnog veka.	Zamenite staru bateriju novom prema proceduri opisanoj u Odeljku „Umetanje punjive baterije“.
Prikazuje se upozorenje o bateriji sata.	Unutrašnja baterija sata je prazna.	Zamenite bateriju sata prema proceduri opisanoj u Odeljku „Zamena baterije sata“.

Prava korisničke uloge

Radnja	Opšti korisnik	Administrator
Merenje uzorka pacijenata	X	X
Pregled liste rezultata pacijenata	- / X*	X
Pregled LIS liste rezultata van mreže	- / X*	X
Merenje kontrole kvaliteta	X	X
Pregled rezultata kontrole kvaliteta	X	X
Dodavanje novog kontrolnog ID broja	X	X
Brisanje svih informacija o pacijentima	-	X
Prenos podataka na USB	- / X*	X
Promena lozinke	X**	X
Podesiti administratorsku lozinku	-	X
Podešavanja	X***	X
Ušteda energije	-	X
Privremena promena Ušteda energije	X	-
Jezik, osvetljenost ekrana, jačina zvuka	-	X
Privremena promena: jezik, osvetljenost ekrana, jačina zvuka	X	X
Održavanje	-	X
Održavanje: dnevnik grešaka	X***	X
O instrumentu	X***	X

*Ako je omogućio administrator

** Samo lokalni korisnik. Ograničeno kada je aktivna lista operatera na daljinu.

*** Samo pregled

SADRŽAJ

1 UVOD	55	Namjena	55	Mjerenje uzorka za kontrolu kvalitete	64	Dnevni mjerjenja na USB.....	71
QuikRead go Plus Instrument	55	Prikaz rezultata kontrole kvalitete	64	Dnevni povezivanja	71		
Sigurnosne informacije	55	Detaljan prikaz rezultata		Samostestiranje	71		
Mjere opreza i ograničenja	55	kontrole kvalitete	64	Upravljanje rezultatima pacijenata	71		
2 POČETAK.....	56	Rezultati	65	Brisanje popisa rezultata pacijenata	71		
Raspakiravanje.....	56	Brisanje rezultata	65	Vraćanje na tvorničke postavke	71		
Dodaci	56	Izvanmrežni popis za LIS	65				
Dijelovi proizvoda QuikRead go							
Plus Instrument	56						
Podizanje ili prijenos proizvoda							
QuikRead go Plus Instrument	58						
Lokacija i okolina	10						
Tijekom upotrebe	58						
Tijekom prijevoza i skladištenja	58						
Kabel za napajanje i baterija	58						
Priključci i kabeli	58						
Priključivanje kabela za napajanje	58						
Umetanje punjive baterije	58						
Uključivanje i isključivanje	58						
Uključivanje	58						
Isključivanje	58						
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir	58						
Prvo postavljanje	58						
Korisničko sučelje	60						
Ikone u području statusa	60						
Izbornik	61						
Obavijesti	61						
Odabir jezika	61						
Opće postavke	62						
3 RAD INSTRUMENTA	62						
Izvođenje mjerjenja	62						
Mjerenje uzorka pacijenta	62						
Prikaz rezultata uzorka pacijenta	63						
Detaljan prikaz rezultata uzorka	63						
4 POSTAVKE.....	66						
Jezik, prikaz, zvuk	67						
Datum i vrijeme	67						
Štednja energije	67						
Mjerenje	67						
Parametri testa	67						
Dodaci	68						
Upravljanje korisnicima	68						
Postavke rukovatelja	68						
Postavke pacijenta	68						
Postavke dodatnog ID-a	68						
Povezivanje	69						
LIS	69						
TCP/IP	69						
WLAN	69						
5 UPRAVLJANJE KONTROLOM KVALITETE	69						
Postavke kontrole kvalitete	69						
Dodaj novu kontrolu kvalitete	70						
Popis kontrole kvalitete	70						
Dodaj novu bočicu za kontrolu kvalitete u upotrebi	70						
6 IZBORNIK ODRŽAVANJE	71						
Ažuriranje softvera	71						
Dnevni	71						
Dnevnik pogrešaka	71						
Revizijski dnevnički na USB	71						
7 PRIKAZ INFORMACIJE.....	71						
8 ODRŽAVANJE INSTRUMENTA... ..	71						
Kalibracija instrumenta	71						
Čišćenje instrumenta	72						
Ažuriranje softvera	72						
Zamjena baterije sata	72						
9 SPECIFIKACIJA INSTRUMENTA.. ..	72						
Izjava o sukladnosti	72						
Tehnička specifikacija	72						
Fotometar	72						
Zaslon osjetljiv na dodir	72						
Dimenzije i potrebna energija	72						
Identifikacijska oznaka instrumenta	72						
Memorija	72						
Napajanje	72						
Radijski modul	72						
Veza sa sustavom LIS	72						
Veza s USB-om	72						
Servis	72						
Jamstvo	72						
Odlaganje	72						
Povijest revizije	72						
10 RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	74						
Prava uloga korisnika	77						

1. UVOD

Namjena

QuikRead go Plus Instrument je *in vitro* dijagnostički sustav za testiranje jednostavan za upotrebu. Osmišljen je za mjerjenje različitih analita iz uzorka pacijenta koji su potrebni kao pomoć u dijagnozi i praćenju liječenja. Sustav se sastoji od instrumenta QuikRead go Plus i kompleta reagensa QuikRead go.

QuikRead go Plus Instrument automatizirani je instrument osmišljen i kalibriran za fotometrijska i turbidimetrijska mjerjenja. Instrument je namijenjen za kvantitativno i kvalitativno određivanje različitih analita iz ljudskih uzorka kao što su cijela krv, serum, plazma, brisevi grla i uzorci fesesa s pomoću kompleta reagensa QuikRead go koji se upotrebljava kao pomoć u dijagnostici i praćenju liječenja. QuikRead go Plus Instrument namijenjen zdravstvenim stručnjacima u kliničkom laboratoriju i testiranju u blizini pacijenta.

QuikRead go Plus Instrument

Instrument će vas voditi kroz postupak analize s pomoću niza poruka i animacija prikazanih na zaslonu. Tijekom pokretanja, instrument provodi samotestiranje kako bi osigurao ispravnu funkcionalnost unutarnjih komponenti instrumenta, kao što su optički sustav i mehanički dijelovi.

QuikRead go Plus Instrument mjeri apsorbanciju ili mutnoću sadržaja kivete i pretvara vrijednost u vrijednost koncentracije analita ili u kvalitativni rezultat na temelju unaprijed postavljenih podataka o kalibraciji testa. Podaci o kalibraciji za svaki test kodirani su na najlepnci kivete. Te se informacije automatski prenose na QuikRead go Plus Instrument tijekom mjerjenja.

Analize se izvode u skladu s uputama za uporabu koje su priložene uz svaki komplet reagensa QuikRead go. Rezultati su dostupni za nekoliko minuta. Instrument može raditi na mrežno napajanje ili na bateriju, ima USB priključke za vanjski pisač, tipkovnicu i čitač crtičnog koda.

QuikRead go Plus Instrument može se povezati s udaljenim laboratorijskim i bolničkim informacijskim susta-

vom (LIS/HIS). Instrument upotrebljava standardizirani protokol za prijenos podataka. Obratite se lokalnom dobavljaču i zatražite dodatne informacije.

Sigurnosne informacije

Pridržavajte se svih upozorenja i mjera opreza radi svoje sigurnosti. Kako bismo vas upozorili na moguće opasnosti od električne energije ili operativne opasnosti, navedena su upozorenja i mjere opreza gdje je to primjenjivo. QuikRead go Plus Instrument sadržava posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) kao što je navedeno u Uredbi REACH (EU 1907/2006), dodatne informacije dostupne su na aidian.eu. Posebno zabrinjavajuće tvari vezane su za unutarnje komponente instrumenta QuikRead go Instrument. Nisu potrebne posebne mjere opreza pri rukovanju.

Prije nego što počnete upotrebljavati QuikRead go Plus Instrument, pažljivo pročitajte sljedeće mjere opreza i ograničenja. U slučaju ozbiljnog incidenta, prijavite ga proizvođaču ili predstavniku i/ili nacionalnom tijelu.

Mjere opreza i ograničenja

- Samo za *in vitro* dijagnostičku upotrebu.
- Nemojte proljetavati tekućine niti bacati predmete na ili u instrument.
- Proliveni potencijalno zarazni materijal treba odmah obrisati upijajućom papirnatom maramicom, a kontaminirana područja obrisati standardnim dezinfekcijskim sredstvom ili 70%-nim etilnim alkoholom (pogledajte odjeljak „Čišćenje instrumenta“).
- Materijal koji se upotrijebi za čišćenje prolijenih tekućina, uključujući rukavice, treba zbrinuti kao biološki opasni otpad.
- Slijedite upute za uporabu reagensa QuikRead go koje su isporučene sa svakim kompletom reagensa.
- Smiju se upotrijebiti samo reagensi QuikRead go.
- Potrebni materijali koji nisu isporučeni navedeni su u uputama za uporabu kompleta reagensa QuikRead go.
- Nemojte mijesati komponente s različitim brojevima serije ili različitim analizama.
- Nikada nemojte staviti kivetu bez dobro postavljenog čepa reagensa u instrument.
- Ne stavljajte prste ili bilo kakve vanjske uređaje u

instrument dok je poklopac otvoren.

- Provjerite da je folija za brtvljjenje kivete potpuno uklonjena.
- Snažnim pritiskom ili upotreboru oštih predmeta može se oštetići zaslon.
- Upotrebljavajte samo napajanje isporučeno s instrumentom i provjerite je li utikač postavljen tako da se može ukloniti.
- Upotrijebite samo službenu bateriju instrumenta QuikRead go Plus Instrument koju isporučuje Aidian.
- Nemojte ukloniti ili isključiti USB memoriju tijekom prijenosa podataka.
- Upotrijebite USB kable kraće od 3 m za povezivanje dodataka s instrumentom.
- Nemojte otvarati poklopce instrumenta odvrtanjem vijaka. Ako je jamstveni pečat oštećen, jamstvo za instrument ne vrijedi (pogledajte **sliku 3**).
- Koristite se sigurnom internom mrežom ili virtualnom privatnom mrežom (VPN) kada povezujete QuikRead go s laboratorijskim i bolničkim informacijskim sustavom koristeći se LAN-om.
- Nemojte upotrijebiti ni povezivati instrument s LAN-om ako je jamstveni pečat oštećen.
- Ne ostavljajte otključani instrument na javno dostupnim mjestima.
- Na instrumentu izbrišite korisničke račune koji se više ne upotrebljavaju (uključujući njihove povezane lokalne podatke).
- Prije rada instrumenta treba procijeniti elektromagnetsko okruženje.
- Ova je oprema dizajnirana i testirana prema normi CISPR 11, klasa A. U kućnom okruženju može uzrokovati radijske smetnje, u kojem ćete slučaju možda trebati poduzeti mjere za ublažavanje smetnji.
- Ako se oprema koristi na način koji nije određio proizvođač, zaštita koju pruža oprema može biti narušena.

2. POČETAK

Raspakiravanje

Otvorite ambalažu i provjerite da sadržava sve sljedeće stavke:

- instrument
- upute za uporabu
- napajanje
- kabel za napajanje
- potvrdu analize.

Pažljivo pregledajte instrument kako biste se uvjeroili da nije oštećen tijekom transporta. Ako je došlo do oštećenja ili nedostaju neki dijelovi, odmah obavijestite lokalnog dobavljača.

Ambalažu instrumenta može se spremiti kako bi se upotrijebila za transport, odnosno za slanje na servis.

Dodaci

Dodaci za sustav QuikRead go čine sustav učinkovitijim, sigurnijim i jednostavnijim za upotrebu. Više informacija možete pronaći na [aidian.eu](#).

Dostupni dodaci:

Pisač

- S instrumentom može se povezati vanjski pisač. Popis kompatibilnih pisača i parametri konfiguracije dostupni su na [aidian.eu](#).
- Spojite pisač na USB priključak. Kada je pisač povezan, ikona pisača prikazuje se na statusnoj traci.

Čitač crtičnog koda

- S instrumentom može se povezati vanjski čitač crtičnog koda. Popis kompatibilnih čitača crtičnog koda dostupan je na [aidian.eu](#).
- Spojite čitač crtičnog koda na USB priključak. Kada je čitač crtičnog koda povezan, ikona čitača crtičnog koda prikazuje se na statusnoj traci.


Tipkovnica

- S instrumentom može se povezati vanjska tipkovnica.
- Spojite tipkovnicu na USB priključak. Kada je tipkovnica povezana, ikona tipkovnice prikazuje se na statusnoj traci.

Napomena! Nemojte upotrijebiti USB kabele duljine 3 m ili duže za spajanje dodatne opreme s instrumentom.

Dijelovi proizvoda QuikRead go Plus Instrument

Dijelovi instrumenta prikazani su na **slici 1**, **slici 2** i **slici 3**.

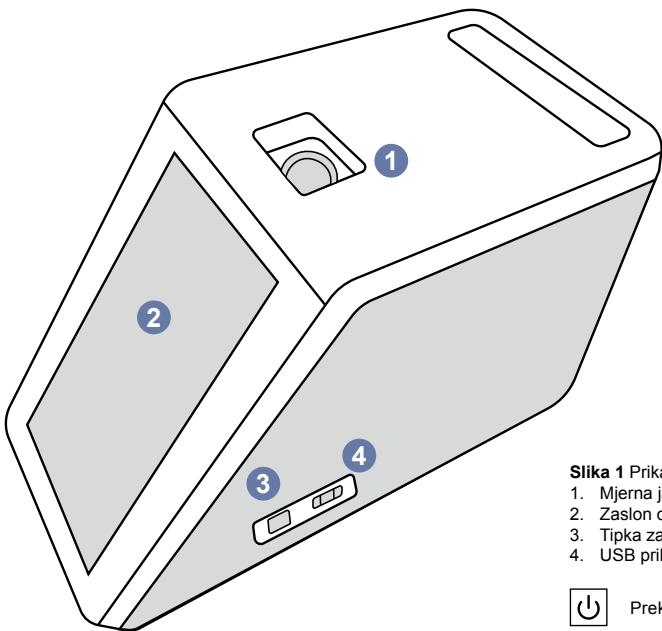


Slika 1 Prikaz prednje strane

1. Mjerna jažica
2. Zaslon osjetljiv na dodir
3. Tipka za napajanje
4. USB priključak (tip A)




Prekidač za uklj./isklj.

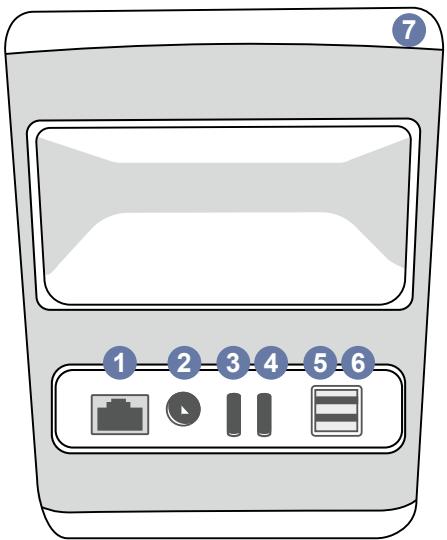

Slika 2 Prikaz stražnje strane

- 1. Priključak RJ-45
- 2. Priključak za napajanje
- 3. USB priključak (tip C)
- 4. USB priključak (tip C)
- 5. USB priključak (tip A)
- 6. USB priključak (tip A)
- 7. Ručka



Pogledajte
Upute za
uporab



RJ-45



Struja



USB

- Slika 3** Donja strana
- 1. Poklopac jedinice za bateriju
 - 2. Priključak baterije
 - 3. Jedinica za bateriju
 - 4. Baterija sata
 - 5. Jamstveni pečat

Podizanje ili prijenos proizvoda QuikRead go Plus Instrument

Kada podizete ili prenosite instrument, uvijek s njim postupajte pažljivo. Da biste podigli instrument, upotrijebite ručku na stražnjoj strani instrumenta ([slika 2](#)).

Lokacija i okolina

Tijekom upotrebe

QuikRead go Plus Instrument treba postaviti na ravnu, čistu, vodoravnu površinu te pripaziti na sljedeće:

- Upotreba u zatvorenom prostoru
- Nadmorska visina do 2000 m
- Okolišna temperatura mora biti između 15 °C i 35 °C.
- Maksimalna relativna vlažnost 80 % za temperaturu do 31 °C smanjuje se linearno do 67 % relativne vlažnosti na 35 °C (bez kondenzacije).
- Nemojte postaviti instrument na izravnu sunčevu svjetlost.
- Nemojte pomicati instrument niti ga tresti tijekom mjerjenja.
- Nemojte provoditi mjerjenje u vozilu u pokretu.
- Oscilacije mrežnog napona do ±10 % nazivnog napona.
- Postavite instrument tako da je lako isključiti napajanje i izvući kabel za napajanje.
- Nemojte puniti instrument s pomoću prijenosne baterije za punjenje (engl. power bank).
- Ne spajajte vanjske uređaje koje nije odobrila tvrtka Aidian. Elektromagnetska kompatibilnost može se premašiti
- Nemojte umetati USB za LTE mobilne podatke u instrument
- Svi vanjski strujni krugovi uređaja spojenih na opremu moraju imati najmanje dvostruku izolaciju prema glavnoj strujnoj mreži.
- Nemojte postaviti instrument u jako magnetsko ili električno polje.
- Nemojte upotrebljavati instrument u blizini izvora jakog elektromagnetskog zračenja (npr. nezaštićeni namjerni izvori radijske frekvencije), jer oni mogu ometati ispravni rad.
- Stupanj onečišćenja 2.
- Kategorija postavljanja II. (2500 V tranzijentno).

- Ograničenja: WiFi ili Bluetooth uređaja nije dopušteno upotrebljavati u krugu od 20 km od središta Ny-Ålesunda na Svalbaru, Norveška.



Tijekom prijevoza i skladištenja

- Okolišna temperatura mora biti između 2 °C i 35 °C.
- Zaštite od kiše i vlage.
- Pažljivo postupajte s instrumentom.

Kabel za napajanje i baterija

QuikRead go Plus Instrument može se upotrijebiti s kablom za napajanje ili baterijom. Baterija se automatski puni kad je priključen kabel za napajanje. Popis kompatibilnih baterija možete pronaći na [aidian.eu](#).

Priklučci i kabeli

Instrument ima priključak USB-A sa strane ([slika 1](#)) i pet priključaka: dva priključka USB-A, dva USB-C i jedan LAN priključak na stražnjoj strani instrumenta ([slika 2](#)), a jedan USB priključak nalazi se na desnoj strani instrumenta. Shema ožičenja opisana je na [aidian.eu](#).

Priklučivanje kabela za napajanje

Priklučite kabel za napajanje u stražnji dio instrumenta (pogledajte [sliku 2](#)). Utaknite kabel za napajanje u utičnicu.

Umetanje punjive baterije

Pažljivo slijedite korake u nastavku pri umetanju punjive baterije u instrument (pogledajte [sliku 3](#)).

1. Isključite instrument (ako je uključen) i izvucite kabel za napajanje.
2. Okrenite instrument na bočnu stranu na ravnoj površini i otvorite poklopac jedinice za bateriju.
3. Spojite priključak baterije na jedinicu za bateriju.
4. Pritisnite bateriju na mjesto i provjerite je li ispravno postavljena.
5. Zatvorite poklopac jedinice za bateriju i okrenite instrument natrag u uspravan položaj.

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje

Da biste uključili instrument, pritisnite tipku za napajanje na bočnoj ploči (pogledajte [sliku 1](#)) dok se ne upali pozadinsko osvjetljenje zaslona. Svjetlo na tipki za napajanje označava da je instrument uključen. Ako se ništa ne dogodi, provjerite je li priključen kabel za napajanje. Ako instrument upotrebljava bateriju i ne pokreće se pritiskom na tipku za napajanje, baterija se možda ispraznila. Da biste pokrenuli instrument s praznom baterijom, priključite kabel za napajanje i pritisnite tipku za napajanje.

Isključivanje

Da biste isključili instrument, pritisnite tipku za napajanje. Prikazat će se skočni prozor za potvrdu isključivanja. Ako potvrdite, instrument će se isključiti. Pritisnkom tipke za napajanje na više sekundi potvrdit ćete isključivanje čak i bez dodirivanja skočnog prozora na zaslonu.

Ako je kiveta unutar instrumenta pri isključivanju, kiveta se podiže i instrument će zatražiti da je uklonite.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

Zaslon osjetljiv na dodir upotrebljava kapacitivnu tehnologiju dodira i podržava pokrete kao što je klizanje, gdje je primjenjivo u korisničkom sučelju. Zaslonom se može koristiti golim prstima, jednokratnim rukavicama ili olovkom za zaslone osjetljive na dodir. Zaslon osjetljiv na dodir ne zahtijeva veliki pritisak pri interakciji. Dolazi do multisenzorne povratne informacije na dodir gumba: tipka će označiti dodir i vizualno promjenom izgleda i zvukom. Naredba se registrira kada maknete prst s dodirnute virtualne tipke. Ako se pritisak otpusti izvan početnog područja tipke, naredba se neće registrirati.

Prvo postavljanje

Pri prvom pokretanju instrumenta QuikRead go Plus Instrument, instrument će od korisnika zahtijevati postavljanje administratorske lozinke. Zatim će instrument zatražiti vođeno postavljanje koje korisnik može

preskočiti kako bi se koristio tvornički zadanim postavkama (**slika 4**). Nakon dovršetka prvog postavljanja ili ako ga preskočite, na zaslonu će se prikazati početni zaslon (**slika 5**).

Kako biste kasnije promijenili postavke, idite na *Izbornik* → *Postavke*.

Napomena! Kako biste saznali više informacija o postavkama, dodirnite ikonu *Informacije* ⓘ pokraj postavke na uređaju QuikRead go Plus Instrument.

Napomena! Postavke poslane s posredničkog softvera POCT01-A2 poništiti će postavke napravljene na instrumentu osim ako nije drukčije navedeno.

Napomena! Za veze upotrijebite samo najjača dostupna sigurnosna pravila.



Slika 4

Postavljanje lozinke administratora

Prvo postavljanje:

1. Jezik
 - Odaberite jezik sustava.
2. Prikaz, zvuk
 - Podesite svjetlinu zaslona, glasnoću upozorenja i glasnoću tipkovnice s pomoći klizača.
3. Datum i vrijeme
 - Odaberite format datuma i postavite trenutačni datum.
 - Odaberite format sata i postavite trenutačno vrijeme.
4. Štednja energije
 - S pomoći klizača odaberite razdoblje neaktivnosti nakon kojeg instrument ulazi u stanje mirovanja.
 - Odaberite funkcionalnost stanja mirovanja.



Slika 5

Prvo postavljanje

5. Mjerjenje

- Možete odabrat da omogućite serijsko mjerjenje.
 - » Kada je omogućeno, instrument će automatski započeti novo mjerjenje uzorka pacijenta nakon prihvaćanja ili odbijanja prethodnog rezultata.
- Možete odabrat da omogućite hitno mjerjenje.
 - » Kada je omogućeno, korisnik može izvesti test s pomoći mogućnosti hitnog mjerjenja bez potrebe za prijavom. Ako je omogućeno, postavite broj dopuštenih hitnih mjerjenja.
- 6. Parametri testa
 - Na prikazu su trenutačno dostupni testovi i trenutačno odabratne jedinice. Odaberite test za koji želite podesiti parametre.
 - » Detaljan opis postavki parametra testa pogledajte u odjeljku „Parametri testa“.
- 7. Ispisivanje
 - Možete omogućiti ispis. Ako je ispis omogućen, možete odabrat i omogućiti automatski ispis.
- 8. Postavke rukovatelja
 - Možete omogućiti ID rukovatelja. Kada je omogućeno, instrument će od korisnika tražiti da unese ID rukovatelja kad se izvode mjerjenja.
 - » Ako je omogućeno, možete odabrat da instrument svaki put predloži prethodno unesen ID rukovatelja.
 - Možete odabrat obaveznu prijavu korisnika. Ako je omogućeno, korisnik se mora prijaviti koristeći se svojim korisničkim imenom i lozinkom.
 - » Ako je omogućeno, s pomoći klizača možete odabrat razdoblje neaktivnosti nakon kojeg će se korisnik automatski odjaviti. Možete odabrat i da se korisnik automatski odjaviti nakon svakog mjerjenja.
 - » Ako je omogućeno, možete omogućiti popis udaljenih rukovatelia.
 - Ako je omogućeno, lokalno spremljeni računi za prijavu bit će onemogućeni, a računi posredničkog softvera sustava LIS bit će aktivni. Za ispravno funkcioniranje potrebna je aktivna veza POCT01-A2. Pogledajte odjeljak „Povezivanje za postavljanje veze sa sustavom LIS“.

- Postavke općeg korisnika
 - Odaberite mogu li opći korisnici vidjeti popis rezultata.
 - Odaberite mogu li opći korisnici vidjeti popis kontrole kvalitete.
 - Napomena!** Kada ste prijavljeni kao administrator, popis rezultata i popis QC uvijek su dostupni za pregled.
- Postavke ID-a pacijenta i dodatne postavke ID-a
 - Možete omogućiti ID pacijenta. Kada je omogućeno, instrument će od korisnika tražiti da unese ID pacijenta kad se izvode mjerena.
 - Možete omogućiti dodatni ID. Kada je omogućen dodatni ID, instrument će od korisnika tražiti da unese dodatni ID kad se izvode mjerena.
 - Pročitajte više o upravljanju dodatnim ID-ovima u odjeljku „Upravljanje dodatnim ID-ovima“.
- Pohrana rezultata
 - Odaberite koliko dugo instrument čuva rezultate pacijenata u memoriji. Nakon odabranog vremenskog razdoblja instrument će automatski izbrisati starije rezultate iz memorije. Ako se ostavi prazan, instrument neće brisati rezultate na temelju vremena.
 - Odaberite godine, dane ili sate.
 - Odaberite maksimalan broj rezultata pacijenata koji će se pohraniti. Kada se dosegne ograničenje, instrument će automatski izbrisati najstariji rezultat iz memorije.

Korisničko sučelje

QuikRead go Plus Instrument upotrebljava grafičko korisničko sučelje dizajnirano za usmjeravanje upotrebe. U ovom odjeljku objašnjena su glavna načela korisničkog sučelja.

Na zaslonu su prikazane virtualne tipke i informacije o radu i statusu instrumenta. Zaslon omogućuje podešavanje klizača pritiskom na jedan i njegovo pomicanje klizanjem po zaslonu. Slično i za određene prikaze s više sadržaja nego što odjednom može stati na zaslon, možete kliziti prikazom gore i dolje pritiskom na zaslon izvan područja aktivnog odabira i pomicati ga.

Na svakom je prikazu područje statusa i njegovi simboli, traka izbornika, glavni prikaz i na dnu prečaci za odabir jezika i opće postavke za postavljanje svjetline zaslona i glasnoće.

Svi korisnici mogu promijeniti postavke jezika, prikaza i zvuka. Ove promjene koje je napravio opći korisnik poništavaju se kada se instrument isključi ili ako se korisnik odjavи.

Dodirnite ikone na zaslonu za interakciju s instrumentom.



Slika 6 Početni zaslon

- Područje statusa
- Traka izbornika
- Prikaz
- Odabir jezika
- Opće postavke

Simboli korisničkog sučelja uređaja QuikRead go Plus Instrument

	Mjerni uzorak		Radnje za popis
	Kontrola kvalitete		Početni zaslon
	Izbornik		Obavijest
	Ispis		Odabir jezika
	Komentar		Opće postavke
	Odbaci/izbriši		Dodatne informacije

Ikone u području statusa

	Pokazatelj razine baterije		Kabel za napajanje priključen (punjenje baterije ako je priključen)
	Upozorenje na nisku razinu baterije (crveni simbol)		Status WiFi mreže
	Priklučena USB memorija		Povezano sa sustavom LIS
	Povezana tipkovnica		Prekinuta veza sa sustavom LIS
	Povezan čitač crtičnog koda		Izvanmrežni rezultati za LIS čekaju na slanje
	Povezan pisač		

Izbornik

Svim značajkama instrumenta može se pristupiti iz glavnog izbornika . U izborniku se nalazi tipka *Mjerni uzorak* u gornjoj traci. Pritisnite ovu ikonu za prečac do mjerjenja uzorka. Gornja traka također ima tipku za zatvaranje izbornika i povratak na prethodni prikaz te tipku za početak za povratak na početni zaslon.




Obavijesti

Obavijesti instrumenta mogu se vidjeti na *Popisu obavijesti* na traci izbornika. Ikona se mijenja kada su obavijesti dostupne. Odabir obavijesti s popisa pružit će vam više informacija i dati upute za otklanjanje poteškoća. Obavijesti su kategorizirane u tri kategorije.

- Obavijesti koje nisu vremenski kritične plave su boje, tj. instrument je spreman za mjerjenje.
- Važne pogreške žute su boje, tj. pogreška u vezi sa sustavom LIS.
- Pogreške su sustavu crvene su boje, tj. samotestiranje nije uspjelo.


Dodatane informacije o pogreškama i otklanjanju poteškoća pogledajte u odjeljku 10. „Otklanjanje poteškoća“.

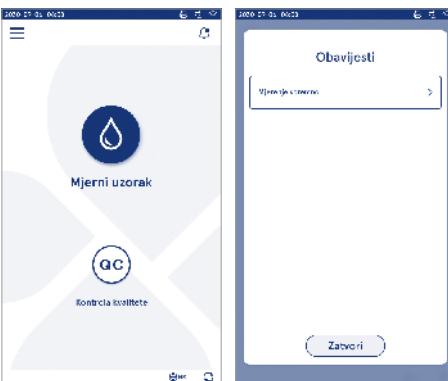

Odabir jezika

Jezik sučelja mogu privremeno promijeniti svi korisnici u stavci *Odabir jezika* što je vidljivo u donjem desnom kutu zaslona. Odabir jezika utječe na izbornik i jezik uputa te na izgled tipkovnice. Odabir se vraća na jezik sustava kada se korisnik odjavi ili se instrument isključi.

Administrator može promijeniti jezik sustava ako odabere *Izbornik* → *Postavke* → *Jezik, zaslon, zvuk*.

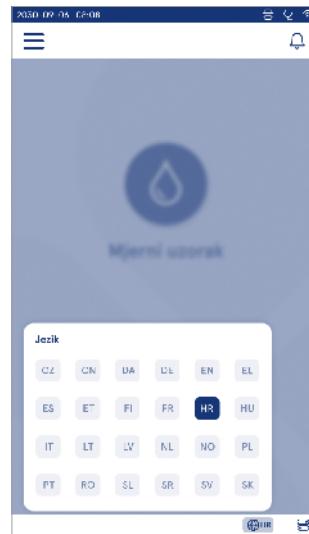

Slika 7 Izbornik

Opće postavke

Opće postavke mogu privremeno promijeniti svi korisnici u prečaku Opće postavke što je vidljivo u donjem desnom kutu zaslona. Korisnik može promijeniti svjetlinu zaslona, glasnoću upozorenja i glasnoću tipkovnice. Odabir se vraćaju na zadane postavke sustava kada se korisnik odjavi ili se instrument isključi.

- Svjetlina zaslona može se podesiti pomicanjem klizača.
- Glasnoća upozorenja može se podesiti pomicanjem klizača. Upozorenja se mogu utišati postavljanjem klizača u krajnji lijevi položaj.
- Glasnoća tipkovnice može se podesiti pomicanjem klizača. Tipkovnica se može utišati postavljanjem klizača u krajnji lijevi položaj.

Administrator može promijeniti opće postavke ako odabere **Izbornik → Postavke → Jezik, prikaz, zvuk.**



3. RAD INSTRUMENTA

Upotreba instrumenta QuikRead go Plus Instrument može se podijeliti na tri glavne radnje:

- izvođenje mjerjenja
- prikaz rezultata
- promjena postavki instrumenta.

Izvođenje mjerjenja

Instrument se može upotrijebiti u dva načina mjerjenja: mjerjenje uzorka pacijenta i mjerjenje uzorka za kontrolu kvalitete. Oba načina mogu se izmjeniti u postavkama.

Napomena! Samo kompleti reagensa QuikRead go mogu se upotrijebiti za izvođenje analize. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu odgovarajućeg kompleta reagensa QuikRead go. U uputama se nalaze detaljnije informacije o provođenju testova i rukovanju uzorcima.


Mjerjenje uzorka pacijenta

Kada se uzorak pacijenta treba analizirati odaberite **Mjerni uzorak** na zaslolu. Instrument će voditi korisnika i izvođenju testa QuikRead go na uzorku pacijenta koji će instrument analizirati i prikazati rezultat na zaslolu nakon završetka.

Za izvođenje mjerjenja:

1. Na zaslolu odaberite **Mjerni uzorak** i slijedite upute na zaslolu.
2. Umetnite kivetu u jažicu za mjerjenje tako da crtični kod kivete bude okrenut prema naprijed (pogledajte **sliku 8**).
3. Poklopac se zatvara, a instrument započinje mjerjenje. Napredak analize prikazuje se na zaslolu.
4. Mjerjenje se može prekinuti odabirom opcije **Otkazi**. Kiveta će se podignuti, i vratit će se prikaz početnog zaslona.
5. Tijekom mjerjenja korisnik može pregledati rezultate prethodnih pacijenata i rezultate kontrole kvalitete te pristupiti prikazu informacija putem izbornika. Ikona napretka bit će prikazana na zaslolu kada ste u drugim prikazima i instrument će obavijestiti korisnika kada je mjerjenje spremno.
6. Nakon završetka analize, prikazat će se rezultat, a kiveta se podiže.

7. Uklonite kivetu, za rezultat odaberite opciju **Prihvati** ili **Odbaci** , a zaslou će se vratiti na početni zaslou. Putem opcije **Izbornik** možete prikazati prethodne rezultate na popisu rezultata pacijenta.

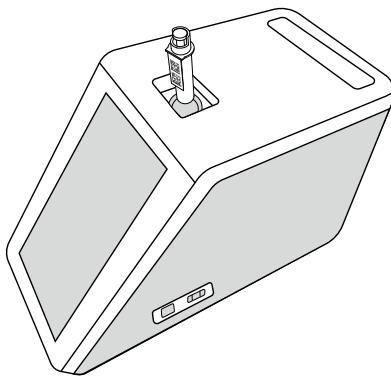

Slika 8

Umetnite kivet u jažicu za mjerjenje tako da crtični kod bude okrenut prema naprijed.

- Administrator može omogućiti više funkcija za mjerenje uzorka pacijenta (pogledajte odjeljak „Mjerjenje“).
- ID rukovatelja, ID pacijenta i dodatni ID mogu se omogućiti, a instrument će od korisnika zahtijevati da unese odabrane ID-ove kako bi dovršio mjerjenje. Pročitajte više o dodatnom ID-u u odjeljku „Postavke dodatnog ID-a“.
- ID-ovi se mogu unijeti s pomoću zaslona osjetljivog na dodir ili s pomoću čitača crtičnog koda ili vanjske tipkovnice. Moguće je omogućiti instrumentu da predloži posljednje upotrijebljeni ID rukovatelja u upitu kada je prijava onemogućena.
- Prijava se također može omogućiti tako da se korisnik mora prijaviti na instrumentu koristeći se svojim korisničkim imenom i lozinkom. Prijavom se automatski unosi ID rukovatelja za svako mjerjenje.

- Može se omogućiti hitno mjerjenje. Kada je omogućeno, korisnik može izvesti test s pomoću mogućnosti hitnog mjerjenja bez potrebe za prijavom. Ako je omogućeno, postavite broj dopuštenih hitnih mjerjenja. Može se postaviti broj prihvatljivih hitnih mjerjenja.
- Može omogućiti način serijskog mjerjenja. Kada je omogućeno, instrument će automatski započeti novo mjerjenje uzorka pacijenta nakon što korisnik prihvati ili odbaci prethodni rezultat.
- Ispis rezultata i slanje rezultata sustavu LIS može se omogućiti u postavkama.

Prikaz rezultata uzorka pacijenta

Prikaz rezultata uzorka pacijenta dostupan je nakon dovršene analize. Prikazuju se rezultat analize i informacije o testu. Korisnik može prihvati rezultat i on će se spremi na popis rezultata pacijenta s pomoću ikone . Rezultat se može ispisati odabirom ikone ako je omogućen ispis, a pisač povezan. Komentar se može priložiti rezultatu. Da biste napisali komentar, odaberite . Korisnik može odlučiti odbaciti rezultat odabirom ikone . U slučaju odbacivanja korisnici mora ostaviti komentar. Rezultat će biti pohranjen na popisu rezultata pacijenta kao odbijen, a detaljne informacije i dalje se mogu vidjeti.



Detaljan prikaz rezultata uzorka

Detaljan prikaz rezultata uzorka dostupan je odabirom opcije *Izbormik* → *Rezultati pacijenta* odabirom retka rezultata. Na detaljnijem prikazu rezultata uzorka dodatno su prikazani serijski ID instrumenta, komentari i dodatne informacije o pacijentu. Za rezultate CRP testa bit će prikazana vrsta uzorka. Moguće je dodati komentare odabirom simbola i unijeti dodatne podatke o pacijentu.



Mjerenje uzorka za kontrolu kvalitete

Instrument ima zasebni način mjerjenja za uzorke za kontrolu kvalitete koji se mijere poput uzoraka pacijentata opcijom *Kontrola kvalitete* na početnom zaslonu. Rezultati se pohranjuju odvojeno od rezultata pacijentata i mogu se vidjeti iz rezultata kontrole kvalitete u stavci *Izbornik* .

Da biste proveli kontrolu kvalitete, na početnom zaslonu odaberite *Kontrola kvalitete* i slijedite upute na zaslonu.

Administrator može omogućiti više funkcija za mjerjenje uzorka za kontrolu kvalitete (pogledajte odjeljak „*Povstavke kontrole kvalitete*“).

ID kontrole može se omogućiti i instrument će od korisnika zahtijevati da ga unese kako bi izvršio kontrolu kvalitete.

Povjera kontrole kvalitete može se omogućiti kako bi se pokazalo je li rezultat kontrole kvalitete unutar postavljenog raspona za uzorak za kontrolu kvalitete.

Kada je omogućena, zaključavanje kontrole kvalitete može se omogućiti da se ograniči uporaba instrumenta u slučaju da posljednje mjerjenje za kontrolu kvalitete nije uspjelo ili je raspored za kontrolu kvalitete istekao. Nakon isteka korisnik ne može mjeriti uzorke pacijentata prije provedbe kontrole kvalitete koja ima prolazan rezultat.

Prikaz rezultata kontrole kvalitete

Prikaz rezultata kontrole kvalitete dostupan je nakon dovršenog mjerjenja kontrole kvalitete. Prikazuju se rezultati i informacije o testu. Korisnik može priхватiti rezultat kontrole kvalitete i on će se spremiti na popis rezultata kontrole kvalitete s pomoću ikone . Rezultat se može ispisati odabirom ikone ako je omogućen ispis, a pisač povezan. Komentar se može priložiti rezultatu. Da biste napisali komentar, odaberite .



Detaljan prikaz rezultata kontrole kvalitete

Detaljan prikaz rezultata kontrole kvalitete dostupan je odabirom opcije *Izbornik* → *Rezultati kontrole kvalitete* odabirom retka rezultata. Na prikazu detaljnog rezultata kontrole kvalitete dodatno se prikazuje koncentracija kontrole kvalitete, dodatne informacije o kontroli kvalitete i komentari. Moguće je dodati komentare odabirom simbola .



Rezultati

Rezultati se mogu vidjeti odabirom opcije *Izbornik* . Rezultati se pohranjuju na zasebne popise za *Rezultate pacijenata*, *Rezultate kontrole kvalitete* i *Izvanmrežne rezultate za LIS*. Prikaz rezultata možete pomicati prelaženjem prstom. Odabirom rezultata prikazat će se detaljne informacije. Popisi rezultata mogu se poredati dodirivanjem zaglavja stupca.

Prikaz popisa pacijenata može se pretraživati prema opciji *ID pacijenta* i razvrstati prema informacijama *Datum*, *Test* i *ID rukovatelja*. Prikaz rezultata kontrole kvalitete može se filtrirati prema opcijama *Test*, *ID kontrole*, *Datum kontrole kvalitete* i *ID rukovatelja*. Da biste filtrirali popis, pristupite stavci *Radnje za popis*  iz trake izbornika.



The screenshot shows a list of patient results. Each result row contains the patient ID, measurement time, test name, and result value. The results are listed in chronological order from top to bottom.

Patient ID	Measurement Time	Test	Result
CIO190-XXXX	17:09 09-12-2014	CRP	<1.0 mg/l
290212-YYYY	09:05 09-12-2014	Strep A	1 Pos. +
CIO1650-AAAA	19:12 09-12-2014	FOB	Neg. -
Jimmy Doo	18:52 09-12-2014	CKP	12 mg/l 122 g/l
--	18:05 09-12-2014	HbA _{1c}	Odbaceno
--	17:59 09-12-2014	CRP	2.4 mg/l

Pojedinačni rezultati i popisi rezultata mogu se ispisati. Popisi se mogu ispisati s filtrima ili bez njih te prenijeti u USB memoriju. Popis rezultata mora se filtrirati prije omogućavanja prijenosa na USB. Da biste ispisali pojedinačan rezultat, odaberite redak rezultata i odaberite *Ispis* na prikazu rezultata. Da biste ispisali popis, pristupite stavci *Radnje za popis*  iz trake izbornika.

Brisanje rezultata

Administrator može izbrisati pojedinačne rezultate iz memorije instrumenta. Odaberite rezultat s popisa i odaberite opciju *Izbriši rezultat* na dnu prikaza. Instrument će zatražiti dodatnu potvrdu.

Izvanmrežni popis za LIS


Izbornik  → *Izvanmrežni popis za LIS*

Rezultati koje je generirao instrument s omogućenom vezom sa sustavom LIS dok je izvan mreže spremaju se u *Izvanmrežne rezultate za LIS*. Rezultati se spremaju u slučaju prekida veze, npr. zbog trenutačnog problema s mrežom. Rezultati se mogu poslati u LIS nakon ponovnog uspostavljanja veze. Nakon što se rezultati prenesu u LIS, uklanjuju se s izvanmrežnog popisa za LIS.

Za slanje izvanmrežnih rezultata u LIS, odaberite rezultate tako da dodirnete potvrdni okvir na retku rezultata i odaberite *Pošalji*. Za brisanje rezultata odaberite rezultate za brisanje i odaberite *Izbriši rezultat*. Svi rezultati mogu se odabrati odjednom dodirivanjem potvrdnog okvira u naslovnom retku tablice s rezultatima.

Kada je automatski izvanmrežni prijenos rezultata omogućen u općim postavkama sustava LIS i veza sa sustavom LIS ponovno je uspostavljena, prikazuje se skočni prozor za slanje izvanmrežnih rezultata u LIS. Instrument provjerava vezu sa sustavom tijekom pokretanja i nakon svakog mjerjenja.

4. POSTAVKE

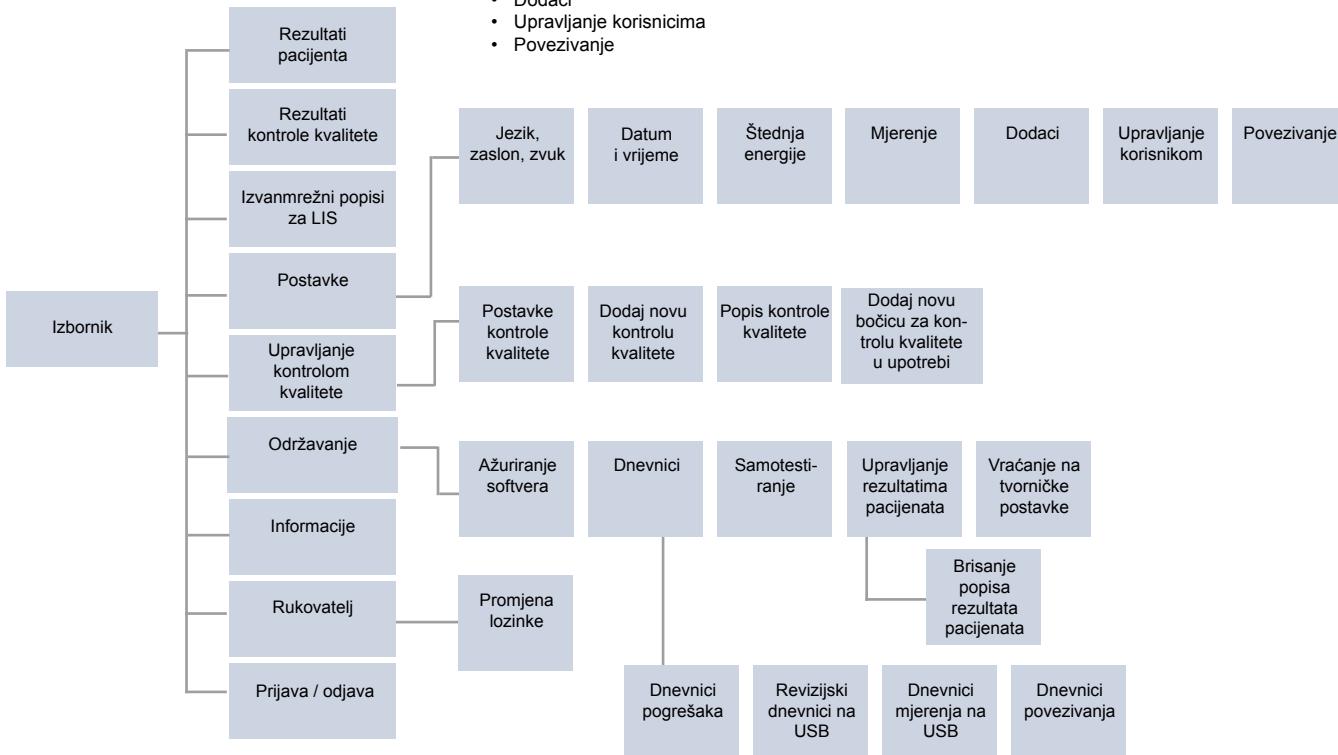

Postavkama se može pristupiti iz *Izbornika* oda-
birom stavke *Postavke*. U postavkama administrator
može postaviti trajne postavke za sljedeće. Opći kori-
snici mogu promjeniti neke postavke i vidjeti one koje
zahtijevaju autorizaciju administratora.

- Jezik, prikaz, zvuk
- Datum i vrijeme
- Štednja energije
- Mjerjenje
- Dodaci
- Upravljanje korisnicima
- Povezivanje

Napomena! Sustav upotrebljava *Značajku automatskog spremanja Spremljeno ✓*. Sve promjene bit će automatski spremljene. Kad je aktivno automatsko spremanje, **Spremljeno ✓** prikazat će se na traci izbornika.

Jezik, prikaz, zvuk

Izbornik → Postavke → Jezik, prikaz, zvuk

- Jezik sustava može se promijeniti odabirom jezika iz izbora. Odabir jezika utječe na izbornik i jezik uputa te na izgled tipkovnice.
- Svjetlina zaslona može se podesiti pomicanjem kličača.
- Glasnoća upozorenja može se podesiti pomicanjem kličača. Možete utišati upozorenja postavljanjem kličača u krajnji lijevi položaj.
- Glasnoća tipkovnice može se podesiti pomicanjem kličača. Tipkovnicu možete utišati postavljanjem kličača u krajnji lijevi položaj.

Datum i vrijeme

Izbornik → Postavke → Datum i vrijeme

- Format datuma može se promijeniti odabirom. Datum se može promijeniti postavljanjem novog datuma.
- Format sata može se birati između 24-satnog i 12-satnog formata. Trenutačno vrijeme može se promijeniti postavljanjem novog vremena.

Napomena! Instrument provjera rok trajanja reagensa QuikRead go prije mjerena. Postavljanjem pogrešnog datuma može se ograničiti upotreba reagensa zbog neuspjele provjere roka trajanja.

Štednja energije


Izbornik → Postavke → Štednja energije

- Odgoda načina mirovanja može se promijeniti pomicanjem kličača. Nakon tog vremena instrument ulazi u stanje mirovanja.
- Funkcija načina mirovanja može se promijeniti odabirom.
 - » Stanje potpune pripravnosti: u stanju mirovanja instrument zatvara poklopac i zaslon se zatamnjuje prije isključivanja. Zaslon se može aktivirati dodirivanjem zaslona ili brzim pritiskom tipke za napajanje.
 - » Samo zatvoren poklopac: u stanju mirovanja instrument zatvara poklopac i zaslon se zatamnjuje.

Mjerenje

Izbornik → Postavke → Mjerenje


- Promijenite parametre testa odabirom testa. Svaki analit ima specifične postavke za određenu vrstu testa.
- Način serijskog mjerenja može omogućiti ili onemogućiti. Kada je omogućeno, instrument će automatski započeti novo mjerenje uzorka pacijenta nakon prihvatanja ili odbijanja prethodnog rezultata.
- Način hitnog mjerenja može se omogućiti ili onemogućiti. Kada je omogućeno, korisnik može izvesti test s pomoću mogućnosti hitnog mjerenja bez potrebe za prijavom. Ako je omogućeno, postavite broj dopuštenih hitnih mjerenja.
- Ako je omogućeno, postavite broj dopuštenih hitnih mjerenja.



- Za kvalitativne rezultate pokazatelj se može postaviti na „Poz. +“ ili „Neg. –“. Kada je rezultat uzorka u skladu s odabirom, uz rezultat će se prikazati uskičnik. Kada je omogućeno, na pregled rezultata prikazat će se tekst „Indikator rezultata uključen“ za sve rezultate.



Označavanje vrste uzorka može se omogućiti za neke testove. Kada je omogućeno, instrument će signalizirati pogrešku kada otkrije pogrešnu vrstu uzorka tijekom mjerena.

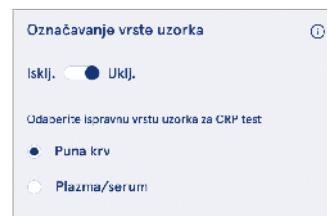

Dodaci

Izbornik → Postavke → Dodaci

Ispis se može omogućiti ili onemogućiti. Kada je ispis omogućen i kompatibilni pisač je spojen, može se omogućiti automatski ispis. S automatskim ispisom rezultati svakog uzorka automatski će se poslati na pisač.

CRP	21 mg/l	QuikRead go Plus
Hb	100 g/l	38/A22064512288
Patient ID	Joe Smith	
Operator ID	Nurse 1	 JE45  JF08
Time	2021-01-29 10:18	<input checked="" type="checkbox"/> 2025-01-29
Sample type	Whole blood	

Slika 9 Rezultat instrumenta QuikRead go Plus kada je isписан

Upravljanje korisnicima

Izbornik → Postavke → Upravljanje korisnicima

Postavke rukovatelja

- ID rukovatelja može se omogućiti ili onemogućiti. Kada je omogućeno, instrument će od korisnika tražiti da unese ID rukovatelja kad se izvode mjerjenja.
- Kada je omogućeno, možete omogućiti da se svaki put predloži prethodno uneseni ID rukovatelja.
- Prijava se može omogućiti ili onemogućiti. Ako je omogućeno, korisnik se mora prijaviti koristeći se svojom lozinkom.

- Kada je omogućeno, s pomoću klizača možete odabrat nakon kojeg će razdoblja neaktivnosti korisnik biti automatski odjavljen. Možete odabrat i da se korisnik automatski odjavlji nakon svakog mjerjenja.
- Napomena! Strogo se preporuča omogućiti prijavu lozinkom kako bi se osigurala sigurnost informacija, osobito u okruženjima s niskim mjerama fizičke sigurnosti, kao što su zajednički ili otključani radni prostori ili pri posjetu pacijentima.
- Kad je omogućena prijava, možete omogućiti popis udaljenih rukovatelja. Ova se opcija može omogućiti kada instrument ima omogućenu vezu POCT01-A2. Kada je omogućeno, popisom rukovatelja upravlja posrednički softver sustava LIS i ne može se ure-

divati putem instrumenta. Ako se omogući prijava, onemogućit će se prijedlog prethodnog odabira.

- Pregled popisa rezultata pacijenata može se omogućiti ili onemogućiti za opće korisnike.
- Pregled popisa rezultata kontrole kvalitete može se omogućiti ili onemogućiti za opće korisnike.

Napomena! Kada ste prijavljeni kao administrator, popis rezultata pacijenata i popis kontrole kvalitete uvijek su dostupni za pregled.

Upravljanje rukovateljima

Izbornik → Postavke → Upravljanje korisnicima → Upravljanje rukovateljima

- Administrator može dodati nove rukovatelje, pogledati potpun popis rukovatelja i uloge te uređivati račune.
- Kada dodajete ID novog rukovatelja:
 - odaberite *Uloga rukovatelja* (opća/administrator)
 - unesite ID rukovatelja
 - unesite lozinku
 - unesite ime rukovatelja.
- Kada uređujete račune, lozinka korisnika može se promjeniti.

Pogledajte tablicu s pravima uloga korisnika na stranici 77.

Postavke pacijenta

ID pacijenta može se omogućiti ili onemogućiti. Kada je omogućeno, instrument će od korisnika tražiti da unese ID pacijenta kad se izvode mjerjenja.

Postavke dodatnog ID-a


Dodatni ID može se upotrijebiti kao dodatno polje za tekst ili za odabir s unaprijed određenog popisa dodatnih ID stavki za svako mjerjenje uzorka pacijenta. Kada je omogućen dodatni ID, instrument će od korisnika zatražiti da unese dodatni ID kad se izvode mjerjenja. Za unos dodatnih stavki popisa ID-a ili prilagođavanje naziva popisa odaberite *Upravljanje dodatnim ID-ovima*.

Upravljanje dodatnim ID-ovima

Izbornik → Postavke → Upravljanje korisnicima → Upravljanje dodatnim ID-ovima

Unesite stavke popisa dodatnih ID-ova odabirom opcije *Dodaj stavku popisa*. Dodavanjem stavke popisa aktivirat će se gumb popisa pored polja za tekst prilikom izvođenja mjerjenja (**slika 10**).

Prilagodite naziv popisa odabirom opcije *Uredi* pored naziva popisa. Time će se zamijeniti naslov *Dodatni ID* pri izvođenju mjerjenja (**slika 10**).

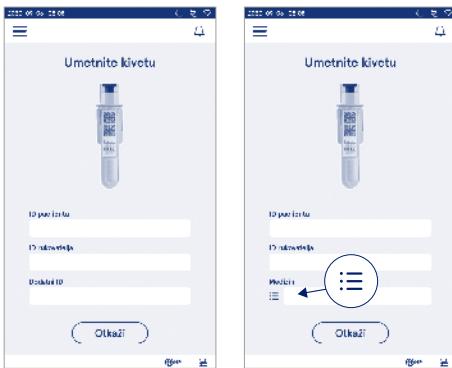

Slika 10 Dodatni ID

Kada su unaprijed određene stavke popisa dodatnih ID-ova, aktivirana je tipka popisa pored polja za tekst (desno). Kada je ureden naziv popisa ID-ova, naziv će se prikazati iznad polja za tekst (desno)

Povezivanje

Izbornik → Postavke → Povezivanje

Instrument se može spojiti s laboratorijskim ili bolničkim informacijskim sustavom (LIS/HIS) putem LAN ili WLAN veze. Ove se veze mogu upotrijebiti za automatski prijenos podataka između instrumenta i sustava za daljinsko upravljanje i pregled rezultata.

Obratite se dobavljaču radi dodatnih informacija o povezivanju.

Napomena! Obratite se administratoru sustava za informacije o postavkama povezivanja.

LIS

Izbornik → Postavke → Povezivanje → LIS

- Veza sa sustavom LIS može se omogućiti ili onemogućiti. Kada je omogućena, može se odabrati automatski prijenos rezultata. Ako je veza prekinuta, rezultati koji su generirani, ali nisu poslani sustavu LIS, bit će vidljivi u izvanmrežnom prikazu rezultata za LIS (pogledajte odjeljak „Izvanmrežni popis za LIS“).
- Može se odabrati vrsta veze. Dostupne su sljedeće vrste veze:
 - » POCT1-A2
 - » LIS01-A2 (TCP/IP)
 - » LIS01-A2 (RS232).
- Adresa poslužitelja sustava LIS i priključak TCP mogu se promijeniti.
- Konverzacijski interval može se promijeniti s pomoću klizača.
- TLS šifriranje može se omogućiti. Certifikat TLS može se učitati s USB memorije.
- Može se omogućiti provjera valjanosti identifikacijske oznake pacijenta. Kada je omogućeno, instrument će provjeriti ID pacijenta iz posredničkog softvera POCT01-A2. Ako uneseni ID pacijenta nije valjan, instrument će izdati poruku o pogrešci.
- Može se omogućiti prikaz podataka o pacijentima. Kada je omogućeno, instrument će dohvatiti podatke o pacijentu iz posredničkog softvera POCT01-A2 na temelju unesenog ID-a pacijenta.
- Izvanmrežni prijenos rezultata može se prebaciti na automatski i ručni način rada. Kada je odabran automatski način rada, izvanmrežni rezultati za LIS

automatski će se prenijeti kada se veza ponovo uspostavi. Kada je odabran ručni način rada, korisnik će morati odabrati koji će se rezultati prenijeti u sustav LIS.

TCP/IP

Izbornik → Postavke → Povezivanje → TCP/IP

- Vrsta IP adrese može se mijenjati između statičke IP i dinamičke IP adrese.
- IP adresa može se promijeniti.
- Maska podmreže može se promijeniti.
- Zadani pristupnik može se promijeniti.
- DNS poslužitelj može se promijeniti.

WLAN

Izbornik → Postavke → Povezivanje → WLAN

Veza sa sustavom WLAN može se omogućiti ili one-mogućiti. Kada je omogućeno, veza se može postaviti skeniranjem dostupnih WLAN mreža odabirom opcije Skeniraj ili ručnim postavljanjem. Skeniranjem će se prikazati popis dostupnih WLAN mreža. Odaberite željenu mrežu s popisa. Ako je mreža zaštićena lozinkom, prikazat će se skočni prozor za lozinku.

5. UPRAVLJANJE KONTROLOM KVALITETE

Upravljanju kontrolom kvalitete može se pristupiti iz Izbornika odabirom stavke Upravljanje kontrolom kvalitete. Postavke upravljanja kontrolom kvalitete upravljaju funkcijom mjerjenja kontrole kvalitete namijenjenu praćenju izvedbe instrumenta koji upotrebljava komplete reagensa i kontrola QuikRead go.

Postavke kontrole kvalitete

Izbornik → Upravljanje kontrolom kvalitete → Postavke kontrole kvalitete

ID kontrole može se omogućiti i instrument će od korisnika zahtijevati da ga unese kako bi izvršio kontrolu kvalitete.

Ako je omogućeno, provjera kontrole kvalitete može se omogućiti kako bi se pokazalo je li rezultat kontrole kvalitete unutar postavljenog raspona za uzorak za kontrolu kvalitete. Kada je provjera kvalitete omogućena i rezultat kontrole kvalitete je unutar prihvaćenog raspona, uz rezultat će se prikazati Kontrola kvalitete uspjela. Ako je rezultat kontrole kvalitete izvan raspona, prikazat će se Kontrola kvalitete nije uspjela. Rezultat izvan raspona prikazat će se uz rezultat.



Kada je omogućena, zaključavanje kontrole kvalitete može se omogućiti da se ograniči uporaba instrumenta u slučaju da posljednje mjerjenje za kontrolu kvalitete nije uspjelo ili je raspored za kontrolu kvalitete istekao. Nakon isteka korisnik ne može mjeriti uzorak pacijenta prije provedbe kontrole kvalitete koja ima prolazan rezultat. Postavite raspored i odaberite opcije svaki dan, nakon odabranog broja testova ili odabrani dani.

Instrument će zahtijevati unos za posljednje dvije opcije. Ako je raspored postavljen za svaki dan, zaključavanje kontrole kvalitete postat će aktivno sljedećeg dana ako mjerjenje kontrole kvalitete nije obavljeno. Ako je raspored postavljen za odabранe dane, zaključavanje kontrole kvalitete postat će aktivno sljedećeg dana ako mjerjenje kontrole kvalitete nije pravodobno obavljeno.

Dodaj novu kontrolu kvalitete

Izbornik → Upravljanje kontrolom kvalitete → Dodaj novu kontrolu kvalitete

Opcija Dodaj novu kontrolu kvalitete upotrebljava se za unos informacija o novoj kontroli kvalitete (QC) kada je postavka ID-a kontrole omogućena u postavkama kontrole kvalitete. Dodana kontrola kvalitete bit će dostupna za odabir kada se izvode mjerjenja kontrole kvalitete. Instrument će upotrijebiti informacije o kontroli kada se određuje je li kontrola kvalitete uspjela ili nije uspjela. Naziv kontrole kvalitete može se unijeti kako bi se postavio naziv vidljiv u odabiru popisa kontrole kvalitete. Jedinica kontrole kvalitete, koja se prikazuje s rezultatima, može se promijeniti. Raspon kontrole kvalitete obavezan je i upotrebljava se za određivanje je li mjerjenje kontrole kvalitete s ID-om kontrole uspješno ili neuspješno. Koncentracija kontrole kvalitete obavezna je i ciljna je vrijednost mjerjenja kontrole. Isteck serije kontrole kvalitete je obavezan i upotrebljava se za provjeru upotrebljavaju li se reagensi kojima je istekao rok trajanja za kontrolu kvalitete.

Može se postaviti rok trajanja boćice za kontrolu kvalitete koja se upotrebljava. Boćice za kontrolu iz kompleta reagensa QuikRead go imaju rok trajanja i zaseban rok valjanosti nakon otvaranja. Kako bi se pomoglo u upravljanju rokom valjanosti boćice za kontrolu kvalitete, instrument nudi opciju unosa datuma zadnje upotrebe za otvorenu QC boćicu. Prilikom izvođenja kontrole kvalitete i odabira ID-a kontrole ako je rok trajanja otvorene boćice prošao, na instrumentu se prikazuje skočni prozor. Skočnim prozorom predlaže se otvaranje nove boćice i unos datuma isteka nove otvorene boćice.

Dodatne informacije o kontroli kvalitete mogu se unijeti za svaki ID kontrole.

Napomena! Pogledajte najljepnicu i upute za uporabu kontrole kada unosite podatke za novu kontrolu.

Popis kontrole kvalitete

Izbornik → Upravljanje kontrolom kvalitete → Popis kontrole kvalitete

Informacije o ID-ovima kontrole mogu se prikazati i mijenjati na popisu kontrole kvalitete. Na prikazu popisa nalazi se naziv, rok trajanja, test i raspon za svaku kontrolu.

Popis se može poredati s pomoću zaglavila stupca.

Dodaj novu boćicu za kontrolu kvalitete u upotrebi

Izbornik → Upravljanje kontrolom kvalitete → Dodaj novu boćicu za kontrolu kvalitete u upotrebi

Novi rok trajanja boćice za kontrolu kvalitete u upotrebi može se unijeti za postojeći ID kontrole. Odaberite ID kontrole kojem želite dodati novi datum isteka boćice za kontrolu kvalitete u upotrebi. Prikazat će se skočni prozor koji će vas voditi u postavljanju.

Datum se može dodati kao datum ili kao broj dana od datuma unosa. Prethodno unesen rok trajanja otvorene boćice će se izbrisati.

Napomena! Provjerite razdoblje trajanja otvorene boćice u uputama za upotrebu kontrole.

Mjesec	Dan	Broj
2023	Lipanj	30
2024	Šišpanj	31
2025	Kolovoz	1
2026	Rujan	2
2027	Listopad	3
2028	Studenec	4

Dodaj novu boćicu za kontrolu kvalitete u upotrebi
D kontrole: 2024-05-31

Rok trajanja otvorene boćice: Rok trajanja otvorene boćice: broj dana

Kontrola kvalitete ima otvorenu boćicu s rokom trajanja: 2024-05-31

Želite li zamijeniti ovu boćicu s novom?

Ne Da

6. IZBORNIK ODRŽAVANJE

Izborniku Održavanje može se pristupiti iz *Izbornika* → odabirom stavke *Održavanje*.

Ažuriranje softvera

Izbornik → *Održavanje* → *Ažuriranje softvera*

Verzija softvera instrumenta može se ažurirati s pomoću USB memorije. Obratite se lokalnom dobavljaču i zatražite dodatne informacije o ažuriranju softvera.

Dnevnići

Izbornik → *Održavanje* → *Dnevnići*

Instrument u svoju memoriju bilježi dnevničke mjerjenja, pogrešaka i povezivanja te revizije. Dodatne informacije pročitajte u sljedećim odjeljcima.

Dnevnik pogrešaka

Izbornik → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Dnevnik pogrešaka*

Pogreške instrumenta pohranjene su u njegovoj memoriji. Prethodne pogreške mogu se prikazati u dnevniku pogrešaka. Prikaz se može poredati dodirivanjem zaglavljiva stupca. Kodovi pogrešaka mogu se prenijeti na USB memoriju odabirom prijenosa na USB na traci izbornika.

Revizijski dnevnići na USB

Izbornik → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Revizijski dnevnići na USB*

Revizijski dnevnići sadržavaju informacije za prijavu, zapise o radnjama mjerjenja uzorka, odbacivanja rezultata, brisanje rezultata i brisanja dnevnika. Dnevnići se mogu upotrijebiti za praćenje upotrebe instrumenta. Revizijski dnevnići instrumenta mogu se prenijeti na USB memoriju.

Dnevnići mjerjenja na USB

Izbornik → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Dnevnići mjerjenja na USB*

Dnevnići mjerjenja upotrebljavaju se za otklanjanje poteškoća koje obavlja tvrtka Aidian, npr. u slučaju pri-tužbe kupca. Dnevnići mjerjenja šifrirani su i dostupni samo osoblju tvrtke Aidian. Sadržavaju zapise o izvedbi instrumenta bez informacija o pacijentu ili korisniku.

Dnevnići povezivanja

Izbornik → *Održavanje* → *Dnevnići* → *Dnevnići povezivanja*

Dnevnići povezivanja mogu se pohraniti u memoriju. Promjena prikupljanja dnevnika sustava LIS. Dnevnići povezivanja mogu se prenijeti na USB memoriju.

Samotestiranje

Izbornik → *Održavanje* → *Samotestiranje*

Instrument provodi provjeru rada kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje. Da biste ručno izveli samotestiranje, odaberite *Da*. Sustav će se vratiti na početni zaslon nakon završetka.

Upravljanje rezultatima pacijenata

Izbornik → *Održavanje* → *Upravljanje rezultatima pacijenata*

Trajanje pohrane rezultata pacijenata može se postaviti ili promijeniti. Postavite vrijeme trajanja u godinama, danima ili satima. Stariji rezultati pacijenata automatski se brišu nakon odabranog vremena. Ako se ostavi prazan, instrument neće brišati rezultate na temelju vremena.

Maksimalan broj rezultata pacijenata u pohrani može se promijeniti. Kada se dosegne ograničenje, instrument će automatski izbrisati najstariji rezultat iz memorije.

Brisanje popisa rezultata pacijenata

Izbornik → *Održavanje* → *Brisanje popisa rezultata pacijenata*

Popis rezultata pacijenata može se u potpunosti izbrisati. Ova se opcija može upotrijebiti u svrhu zaštite podataka.

Vraćanje na tvorničke postavke

Izbornik → *Održavanje* → *Vraćanje na tvorničke postavke*

Instrument se može vratiti na tvorničke postavke.

7. PRIKAZ INFORMACIJE

Na prikazu *Informacije* naveden je serijski broj instrumenta, trenutačna verzija softvera i informacije o povezivanju. Osim toga, instrumentu se može dodjeliti naziv. Nakon određivanja naziva, naziv instrumenta prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona u svim prikazima.

Prikazu Informacije može se pristupiti iz *Izbornika* → odabirom stavke *Informacije*.

8. ODRŽAVANJE INSTRUMENTA

QuikRead go Plus Instrument osmišljen je da bude prilagođen korisnicima bez potrebe za redovitim održavanjem. U slučaju potrebe za popravkom i servisom, obratite se lokalnom dobavljaču.

Kalibracija instrumenta

Instrument je tvornički kalibriran. Ispravan rad instrumenta provjerava se postupkom samoprovjere tijekom pokretanja i pri svakom mjerjenju. U slučaju kvara, prikazat će se poruka o pogreški. Podaci o kalibraciji koji određuju svaki test kodirani su na naljepnici kivete. Instrument očitava te informacije automatski pri svakom mjerjenju.

Čišćenje instrumenta

Povremeno očistite vanjski dio instrumenta vodom navlaženom kromp koja ne ostavlja dlačice. Posebnu pažnju обратите na čišćenje zaslona. Pazite da tekućina ne uđe u instrument kroz rubove zaslona, otvor jazice za mjerjenje ili priključke. Po potrebi možete upotrijebiti blagi deterdžent. Nemojte upotrebljavati organska otapala ni korozivne tvari. Proliveni potencijalno zarazni materijal treba odmah obrisati upijajućom papirnatom maramicom, a kontaminirana područja obrisati standardnim dezinfekcijskim sredstvom ili 70%-tним etilnim alkoholom. Materijale koje se upotrijebi za čišćenje prolivenih tekućina, uključujući rukavice, treba zbrinuti kao biološki opasni otpad.

Prihvativljiva dezinfekcijska sredstva:

- 70%-tni etilni alkohol
- 70%-tni izopropanol
- 0,5%-tni natrijev hipoklorit
- 2%-tni glutaraldehid

Ažuriranje softvera

Softver instrumenta može se ažurirati. Pristupite ažuriranju softvera putem stavke *Izbornik* → *Održavanje* → *Ažuriranje softvera* i slijedite upute na zaslонu. Zatražite dodatne informacije od lokalnog dobavljača.

Zamjena baterije sata

Instrument ima bateriju za interni sat kako bi se pratilo vrijeme kad je isključen. Ako je razina napunjenosti sata niska, prikazat će se upozorenje. Baterija sata može se zamijeniti baterijom tipa CR 2032 3 V (**slika 3**).

9. SPECIFIKACIJA INSTRUMENTA

Izjava o sukladnosti

QuikRead go Plus Instrument u skladu je s Uredbom (EU) 2017/746 o *in vitro* dijagnostičkim medicinskim proizvodima, Direktivom 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi zajedno s delegiranoj Direktivom (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II. Direktivi 2011/65/EU i Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO). QuikRead go Plus Instrument u skladu je sa zahtjevima za elektromagnetsko zračenje i otpornost opisanim u standaru IEC 61326-2-6:2012. Instrument ispunjava zahtjeve klase A pravila FCC-a. QuikRead go Plus Instrument u skladu je s Uredbom (EU) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH). Instrument je u skladu i s Direktivom 2014/53/EU o radijskoj opremi. Za više informacija обратite se lokalnom dobavljaču.

Tehnička specifikacija

Instrument ima unaprijed programirani mikroprocesor koji kontrolira korake analize i obradu podataka. Podaci o identifikaciji testa, vremenu i kalibracijskoj krivulji ili graničnoj vrijednosti nalaze se na crtičnom kodu na svakoj kivet. Nakon što se aktivira naljepnicom kiveće, mikroprocesor kontrolira i vodi sve korake analize i pretvara vrijednosti apsorbancije uzorka u jedinicu koncentracije ili granične vrijednosti.

Fotometar

Fotometar instrumenta QuikRead go Plus Instrument sastoji se od mjerne jazice, tri LED diode i detektora svjetla. Fotometar dizajniran je i kalibriran za fotometrijska i turbidimetrijska mjerjenja.

Zaslon osjetljiv na dodir

Korisničko sučelje temelji se na kapacitivnom zaslonu osjetljivom na dodir i jednostavnom za upotrebu. Korisniku daje poruke, upite i animacije za izvođenje svakog koraka analize te prikazuje rezultate testa i poruke o pogreškama.

Dimenzije i potrebna energija

- Težina: 2,0 kg bez napajanja
- Veličina: 26,9 x 16,6 x 13,9 cm
- Potrebna energija
 - Napon: 100 – 240 V AC
 - Frekvencija: 50 – 60 Hz
 - Potrošnja energije:
 - prazan hod 4 W
 - stanje pripravnosti 1 W
 - maks. 35 W (bez vanjskih dodataka)
 - Napajanje 18V = 3,3A

Identifikacijska oznaka instrumenta

Svaki QuikRead go Plus Instrument ima jedinstveni serijski broj koji se može pronaći na naljepnici na donjoj strani instrumenta i u prikazu Informacije kojem se može pristupiti iz *Izbornika*.

Memorija

QuikRead go Plus Instrument ima internu memoriju za povijest rezultata i dnevničke. Instrument može pohraniti 6000 rezultata pacijenata i 6000 rezultata kontrole kvalitete.

Napajanje

Instrument se napaja iz izvora napajanja koji se isporučuje uz instrument. Osim napajanja, instrument može upotrijebiti bateriju kao izvor napajanja. Unutarnji prekidač unutar priključka kabela automatski će se prebaciti s napajanja na bateriju na napajanje iz električne mreže. Upute o postavljanju baterije potražite u odjeljku „Umetanje punjive baterije“.

Radijski modul

Wi-Fi Dual Band 2,4 GHz / 5 GHz i model Bluetooth Module Panasonic: PAN9028.

Veza sa sustavom LIS

Veza se može uspostaviti s pomoću:

- priključka RJ-45 i podržane Ethernet veze 10BA-SET/100BASE-TX/1000BASE-TX. Treba upotrijebiti upleteni dvožilni kabel bez omotača.
 - WLAN veza.
 - Napajanje putem Etherneta (PoE) nije podržano.
- Obratite se dobavljaču i zatražite dodatne informacije.

Veza s USB-om

Instrument ima tri USB priključka tipa A i dva USB priključka tipa C. Ovi se priključci mogu upotrijebiti za pišače, čitače crtičnog koda, tipkovnice i USB memorije.

Servis

QuikRead go Plus Instrument osmišljen je tako da ne zahtjeva redovito održavanje s ugrađenim postupcima samoprovjere. U slučaju kvara instrumenta, obratite se lokalnom dobavljaču. Prije slanja instrumenta na servis, izbrisite sve rezultate pacijenata iz prikaza Održavanje odabirom opcije Brisanje popisa rezultata pacijenata i očistite vanjski dio instrumenta. Pogledajte odjeljak „Čišćenje instrumenta“.

Jamstvo

Jamstvo proizvođača za QuikRead go Plus Instrument pokriva nedostatke u materijalu ili proizvodnji u razdoblju od dvije godine od datuma kupnje. Da bi jamstvo bilo valjano, jamstveni pečat (**slika 3**) mora biti netaknut. Proizvođač je suglasan popraviti ili zamijeniti instrument ako postane neispravan zbog kvara bilo kojeg unutarnjeg dijela instrumenta. Jamstvo ne pokriva štetu prouzročenu neprikladnom uporabom. Proizvođač nema obvezu izmijeniti ili ažurirati instrument nakon što je proizveden osim ako se ne utvrdi greška u proizvodnji. U slučaju kvara instrumenta, obratite se lokalnom dobavljaču.

Odlaganje

QuikRead go Plus Instrument je niskonaponski elektronički uređaj. Iskorišteni QuikRead go Plus Instrument mora se tretirati kao potencijalno biološki opasni otpad. Instrument treba odložiti kao otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEO 2012/19/EU) ako lokalni i nacionalni zakoni ne zahtijevaju prikupljanje i odlaganje instrumenta kao potencijalno razaznog kliničkog otpada. Dodatne informacije o odlaganju instrumenta možete pronaći na našem mrežnom mjestu [aidian.eu](#).

Materijali ambalaže su materijali koji se mogu reciklirati. Jedinica za bateriju i baterija internog sata trebaju se odlagati u skladu s nacionalnim i lokalnim pravilima o prikupljanju baterija koja se temelje na Direktivi 2006/66/EZ ili Uredbi o baterijama 2023/1542/EU.

Povijest revizije

Povijest revizije možete pronaći na [aidian.eu](#).

Frekvencijski pojasevi i njihove maksimalne radiofrekvencijske snage:

Podržane tehnologije	Način rada	Pojas	Frekvencijski raspon	Maksimalna prosječna provedena izlazna snaga	Dobitak antene (integrirana antena s čipom)		Maksimalna izračena prosječna izlazna snaga
					[MHz]	[dBm]	
Bluetooth	Osnovna brzina	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4		2.1	<10
Bluetooth	Poboljšana brzina prijenosa (EDR)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4		2.1	<10
Bluetooth	Niska razina energije (LE)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4		2.1	<10
WLAN	IEEE 802.11b/g/n	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	16		2.1	<19
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 150... 5 250	16		1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 250... 5 350	16		1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 470... 5 725	16		1.5	<18
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 725... 5 825	16		1.5	<18

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Na instrumentu QuikRead go Plus Instrument prikazuju se poruke o pogreškama i vodi se korisnika u slučaju da otkrije pogreške. Slijedite prikazane upute i pogledajte tablicu za rješavanje problema u ovim uputama za uporabu i upute za uporabu kompleta QuikRead go. **Napomena!** Za dodatnu pomoć pri rješavanju problema posjetite aidian.eu ili se obratite lokalnom dobavljaču.

Poruka o pogreški / rješavanje problema	Mogući uzrok	Korektivna mjera
Prikazuje se kod pogreške s porukom „Ponovno pokrenite QuikRead go Plus“.	Privremeni kvar instrumenta.	Ponovno pokrenite instrument. Ako se ova poruka o pogreški često prikazuje, obratite se službi za korisnike.
Prikazuje se kod pogreške s porukom „Obratite se službi za korisnike“.	Trajni kvar instrumenta.	Obratite se službi za korisnike.
Prikazuje se poruka o pogreški „Razina napunjenosti baterije je niska. Povežite s kabelom za napajanje kako biste nastavili rad“.	Razina napunjenosti baterije je niska.	Spojite jedinicu za napajanje s priključkom za napajanje instrumenta QuikRead go Plus Instrument.
Prikazuje se poruka o pogreški „Položaj kivete nije ispravan. Uklonite kivetu.“.	Na prstenu kivete ostali su ostaci folije za brtvljenje kivete.	Uklonite kivetu kad je instrument podigne. Pri sljedećem mjerjenju provjerite jesu li svi ostaci uklonjeni.
	Na instrumentu je došlo do mehaničkog kvara.	Provjerite prethodnu stavku. Ako nije primjenjivo, ponovno pokrenite instrument. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.

Poruka o pogreški / rješavanje problema	Mogući uzrok	Korektivna mjera
„Mjerenje je zabranjeno.“	Nedostaje čep reagensa ili se upotrebljava kiveta.	Provjerite ima li kiveta čep za reagens i da nije unutarnji obojeni dio čepa pritisnut prema dolje.
	Očitavanje podataka dnevnika s crtičnog koda nije uspjelo.	Pokušajte ponovno. Ako se problem nastavi, otkažite test.
	Istekao je rok trajanja serije kompleta.	Bacite seriju kompleta kojoj je istekao rok. Upotrijebite novu.
	Temperatura kivete je preniska.	Pustite da se kiveta zagrije na sobnu temperaturu. Ponovno testirajte istu kivetu.
	Temperatura kivete je previšoka.	Pustite da se kiveta ohladi na sobnu temperaturu. Ponovno testirajte istu kivetu.
„Test je otkazan.“	Slijepa kontrola je previšoka.	Ponovno testirajte istu kivetu. Postupak slijepje kontrole nije dovršen ili uzorak možda sadržava interferirajuće tvari. U potonjem slučaju, test se ne može dovršiti.
	Slijepa kontrola nije stabilna.	
	Pogreška u dodavanju reagensa.	Napravite novi test. Došlo je do problema tijekom dodavanja reagensa. Provjerite je li čep dobro zatvoren.
	Kvar instrumenta.	Napravite novi test. Ako se ova poruka često prikazuje, obratite se službi za korisnike.
QuikRead go Plus Instrument se ne pokreće.	Jedinica za napajanje nije spojena.	Spojite jedinicu za napajanje i pokušajte ponovno.
	Baterija se ispraznila.	Spojite kabel za napajanje i pokušajte ponovno.
	Na instrumentu je došlo do električnog kvara.	Obratite se službi za korisnike.

Poruka o pogreški / rješavanje problema	Mogući uzrok	Korektivna mjera
Zaslon osjetljiv na dodir ne funkcioniра ispravno.	Ploča osjetljiva na dodir uopće ne reagira.	Obratite se službi za korisnike.
Ne čuju se zvukovi alarma instrumenta.	Razina glasnoće je niska.	Postavite glasnoću u skladu s postupkom koji je opisan u odjeljku „Jezik, prikaz, zvuk”.
	Došlo je do kvara u zvučnom sustavu instrumenta.	Ponovno pokrenite QuikRead go Plus Instrument. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.
Pisač ne ispisuje.	Pisač je isključen ili kabel pisača nije povezan ili je došlo do kvara pisača ili postavke nisu točne.	Provjerite je li pisač spojen i je li uključeno napajanje. Provjerite postavke. Ako se problem nastavi, pokrenite instrument i pisač te ponovno pokušajte ispisati iz izbornika Rezultati. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.
Čitač crtičnog koda ne radi.	Čitač crtičnog koda nije spojen ili čitač crtičnog koda je u kvaru ili postavke nisu ispravne.	Provjerite je li spojen čitač crtičnog koda. Provjerite postavke. Ako se problem nastavi, pokrenite instrument i ponovno pokušajte očitati crtični kod. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.
Baterija se mora često puniti.	Kapacitet baterije smanjuje se tijekom njezinog životnog vijeka.	Zamijenite staru bateriju novom prema postupku opisanom u odjeljku „Umetanje punjive baterije”.
Prikazuje se upozorenje o bateriji sata.	Baterija internog sata je prazna.	Zamijenite bateriju sata prema postupku opisanom u odjeljku „Zamjena baterije sata”.

Prava uloga korisnika

Radnja	Opći korisnik	Administrator
Mjerenje pacijenta	X	X
Prikaz popisa rezultata pacijenata	- / X*	X
Prikaz izvanmrežnog popisa za LIS	- / X*	X
Mjerenje kontrole kvalitete	X	X
Prikaz rezultata kontrole kvalitete	X	X
Dodaj novi ID kontrole	X	X
Brisanje svih informacija o pacijentima	-	X
Prijenos rezultata na USB	- / X*	X
Promjena lozinke	X**	X
Postavljanje lozinke administratora	-	X
Postavke	X***	X
Štednja energije	-	X
Privremena promjena: štednja energije	X	-
Jezik, svjetlina zaslona, glasnoća	-	X
Privremena promjena: jezik, svjetlina zaslona, glasnoća	X	X
Održavanje	-	X
Održavanje: dnevnik pogrešaka	X***	X
Informacije	X***	X

* Ako je omogućio administrator

** Samo lokalni korisnik. Ograničeno kada je aktivan popis udaljenih rukovatelja.

*** Samo prikaz

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	79	
Προβλεπόμενος σκοπός	79	
QuikRead go Plus Instrument	79	
Πληροφορίες για την ασφάλεια	79	
Προφυλάξεις και περιορισμοί.....	79	
2 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ	80	
Αποσυσκευασία.....	80	
Παρελκόμενα	80	
Μέρη του QuikRead go Plus Instrument	80	
Ανύψωση ή μεταφορά του QuikRead go		
Plus Instrument	82	
Τοποθεσία και περιβάλλον	82	
Κατά τη χρήση	82	
Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.....	82	
Καλώδιο τροφοδοσίας και μπαταρία	82	
Σύνδεσμοι και καλώδια	82	
Σύνδεση του καλώδιου τροφοδοσίας.....	82	
Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	82	
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	82	
Ενεργοποίηση ισχύος.....	82	
Απενεργοποίηση ισχύος	82	
Χρήση της οθόνης αφής	82	
Πρώτη ρύθμιση	83	
Περιβάλλον εργασίας χρήστη	84	
Εικονίδια περιοχής κατάστασης.....	85	
Μενού	85	
Ειδοποίησεις	85	
Επιλογή γλώσσας	86	
Γενικές ρυθμίσεις	86	
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ	86	
Διενέργεια μέτρησης.....	86	
Μέτρηση δείγματος ασθενούς	86	
Προβολή αποτελεσμάτων δείγματος ασθενούς	87	
Αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων δείγματος	88	
4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....	90	
Γλώσσα, οθόνη, ήχος	91	
Ημερομηνία και ώρα	91	
Εξοικονόμηση ενέργειας	91	
Μέτρηση	91	
Παράμετροι δοκιμασίας	91	
Παρελκόμενα	92	
Διαχείριση χρήστη	92	
Ρυθμίσεις χειριστή	92	
Ρυθμίσεις ασθενούς	92	
Ρυθμίσεις πρόσθετου αναγνωριστικού	92	
Συνδεσμότητα	93	
LIS	93	
TCP/IP	93	
WLAN	93	
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	94	
Ρυθμίσεις ποιοτικού ελέγχου	94	
Προσθήκη νέου ποιοτικού ελέγχου	94	
Λίστα ποιοτικού ελέγχου	95	
Προσθήκη νέου φιλιδίου ποιοτικού ελέγχου κατά τη χρήση	95	
6 ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	95	
Ενημέρωση λογισμικού	95	
Αρχεία καταγραφής	95	
Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων	95	
Αρχείο καταγραφής ελέγχου σε USB	95	
Αρχεία καταγραφής μετρήσεων σε USB	95	
7 ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΒΟΥΤ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)	96	
Αρχεία καταγραφής συνδεσμότητας	95	
Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος	95	
Διαχείριση αποτελεσμάτων ασθενούς	95	
Διαγραφή λίστας αποτελεσμάτων ασθενούς	96	
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	96	
8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	96	
Βαθμονόμηση του οργάνου	96	
Καθαρισμός του οργάνου	96	
Ενημέρωση λογισμικού	96	
Αλλαγή της μπαταρίας ρολογιού	96	
9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ	97	
Δήλωση συμμόρφωσης	97	
Τεχνικές προδιαγραφές	97	
Φωτόμετρο	97	
Οθόνη αφής	97	
Διαστάσεις και απαιτήσεις ισχύος	97	
Αναγνωριστικό οργάνου	97	
Μνήμη	97	
Τροφοδοτικό	97	
Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας	97	
Σύνδεση LIS	97	
Σύνδεση USB	97	
Τεχνική υποστήριξη	98	
Εγγύηση	98	
Απόρριψη	98	
Ιστορικό αναθεώρησης	98	
10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	99	
Δικαιώματα ρόλων χρήστη	102	

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προβλεπόμενος σκοπός

Το QuikRead go Plus Instrument είναι ένα εύχρηστο σύστημα δοκιμασιών για *in vitro* διαγνωστική χρήση. Έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση διαφόρων αναλυμένων ουσιών από δείγματα ασθενών που απαιτούνται ως ενίσχυση στη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας. Το σύστημα αποτελείται από το όργανο QuikRead go Plus και τα κιτ αντιδραστηρίων QuikRead go.

Το QuikRead go Plus Instrument είναι ένα αυτοματοποιημένο όργανο που έχει σχεδιαστεί και βαθμονομηθεί τόσο για φωτομετρικές όσο και για θολοσιμετρικές μετρήσεις. Το όργανο προορίζεται για τον ποσοτικό και τον ποιοτικό προσδιορισμό διαφόρων αναλυμένων ουσιών των κιτ αντιδραστηρίων QuikRead go από ανθρώπινα δείγματα όπως ολικό αἷμα, ορός, πλάσμα, φαρυγγικά επιχρισμάτα και δείγματα κοπράνων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενίσχυση στη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας. Το QuikRead go Plus Instrument προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας στο κλινικό εργαστήριο και σε παρακλίνιο περιβάλλον εξετάσεων.

QuikRead go Plus Instrument

Το όργανο θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία του προσδιορισμού χρησιμοποιώντας μια σειρά από μηνύματα και σκίτσα που εμφανίζονται στην οθόνη. Κατά την εκκίνηση, το όργανο πραγματοποιεί αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των εσωτερικών εξαρτημάτων του οργάνου, όπως το οπτικό σύστημα και τα μηχανικά μέρη.

Το QuikRead go Plus Instrument μετρά την απορρόφηση ή τη θολερότητα του περιεχομένου μιας κυβέτας και μετατρέπει την τιμή σε τιμή συγκέντρωσης αναλυμένων ουσιών ή σε ποιοτικό αποτέλεσμα βάσει προκαθορισμένων δεδομένων βαθμονόμησης δοκιμασιών. Τα δεδομένα βαθμονόμησης για κάθε δοκιμασία είναι κωδικοποιημένα στην επικέτα της κυβέτας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται αυτόματα στο QuikRead go Plus Instrument κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Οι προσδιορισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν κάθε κιτ αντιδραστηρίων QuikRead go. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε λίγα λεπτά. Η λειτουργία του οργάνου είναι δυνατή με ρεύμα ή με μπαταρία. Διατίθενται συνδέσεις USB για εξωτερικό εκτυπωτή, πληκτρολόγιο και συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα.

To QuikRead go Plus Instrument μπορεί να συνδεθεί σε απομακρυμένο πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου και νοσοκομείου (LIS/HIS). Το όργανο χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή, για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Για την ασφάλειά σας, συμμορφωθείτε με όλες τις δηλώσεις προειδοποιήσεων και προσοχής. Παρέχονται δηλώσεις προειδοποιήσεων και προσοχής, όπου χρειάζεται, ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς ηλεκτρικούς ή λειτουργικούς κινδύνους. Το QuikRead go Plus Instrument περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) όπως ορίζεται στον κανονισμό REACH (ΕΕ 1907/2006). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [aidian.eu](#). Οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) περιέχονται στα εσωτερικά εξαρτήματα του οργάνου QuikRead go. Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις κατά τον χειρισμό.

Πριν από τη χρήση του QuikRead go Plus Instrument, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τους περιορισμούς που ακολουθούν. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, αναφέρετε το στον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπο ή/και στην εθνική αρμόδια αρχή.

Προφυλάξεις και περιορισμοί

- Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Μη ρίχνετε υγρά ή αντικείμενα πάνω ή μέσα στο όργανο.
- Θα πρέπει να σκουπίζετε αμέσως την έκχυση δυνητικά μολυσματικού υλικού με απορροφητικό χαρτί και να ταμπονάρετε τις μολυσμένες περιοχές με ένα σύνθετης απολυμαντικό ή αιθυλική αλκοόλη 70% (βλ. Ενότητα «Καθαρισμός του οργάνου»).
- Το υλικό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό

εκχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των γαντιών, θα πρέπει να απορρίπτεται ως βιολογικώς επικίνδυνα απόβλητα.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης των αντιδραστηρίων QuikRead go, που παρέχονται με κάθε κιτ αντιδραστηρίου.
- Επιπρέπεται η χρήση μόνο αντιδραστηρίων QuikRead go.
- Τα απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται παρατίθενται στις οδηγίες χρήσης του κιτ αντιδραστηρίου QuikRead go.
- Μην αναμιγνύετε συστατικά με διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας ή διαφορετικούς προσδιορισμούς.
- Μην τοποθετείτε ποτέ κυβέτα εαν δεν έχει εφαρμόσει καλά το πώμα αντιδραστηρίου μέσα στο όργανο.
- Μην εισάγετε στο όργανο τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή όταν είναι ανοιχτό το καπάκι.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί πλήρως το φύλλο σφράγισης κυβέτας.
- Εάν εφαρμοστεί δυνατή πίεση ή χρησιμοποιηθούν αιχμήρα αντικείμενα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οδόντα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με το όργανο και επιβεβαιώνετε ότι το βύσμα είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την επίσημη μπαταρία του QuikRead go Plus Instrument που παρέχεται από την Aidian.
- Μην αφαιρείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά τη μεταφορά δεδομένων.
- Για τη σύνδεση παρελκομένων στο όργανο, χρησιμοποιείτε καλώδια USB με μήκος μικρότερο των 3 m.
- Μην ανοίγετε τα καλύμματα του οργάνου ανοίγοντας βίδες. Εάν έχει παραβιαστεί η σφραγίδα της εγγύησης, δεν ισχύει η εγγύηση του οργάνου (βλ. Εικόνα 3).
- Χρησιμοποιήστε ένα ασφαλές εσωτερικό δίκτυο ή ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) όταν συνδέετε το QuikRead go σε LIS/HIS με χρήση LAN.
- Μη χρησιμοποιείτε ή συνδέετε το όργανο σε LAN εάν έχει παραβιαστεί η σφραγίδα της εγγύησης.
- Μην αφήνετε απασφαλισμένο το όργανο σε δημόσια

- προσβάσιμους χώρους.
- Διαγράψτε από το όργανο τους λογαριασμούς χρηστών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τοπικών δεδομένων).
- Το λεκτρομαγνητικό περιβάλλον θα πρέπει να αξιολογηθεί πριν από τη λειτουργία του οργάνου.
- Αυτός ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί κατά CISPR 11 κατηγορία Α. Σε οικιακό περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων, περίπτωση στην οποία θα πρέπει να λάβετε μέτρα, ώστε να μετριάσετε αυτές τις παρεμβολές.
- Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεν έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή, η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό μπορεί να επηρεαστεί.

2. ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανοίξτε τη συσκευασία και επιβεβαιώστε ότι περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όργανο
- Οδηγίες χρήσης
- Τραφοδοτικό
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Πιστοποιητικό ανάλυσης

Εξετάστε προεκτικά το όργανο για να διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά την αποστολή. Εάν έχει προκληθεί ζημιά ή λείπουν τμήματα, ειδοποιήστε αμέσως τον τοπικό προμηθευτή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία του οργάνου και να τη χρησιμοποιήσετε για μεταφορά, π.χ., κατά την αποστολή στην τεχνική υποστήριξη.

Παρελκόμενα

Τα παρελκόμενα του συστήματος QuikRead go καθιστούν το σύστημα αποτελεσματικότερο, ασφαλέστερο και περισσότερο εύχρηστο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση aidian.eu.

Διαθέσιμα παρελκόμενα:

Εκτυπωτής

- Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού εκτυ-

- πωτή στο όργανο. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με συμβατούς εκτυπωτές και παραμέτρους ρύθμισης στη διεύθυνση aidian.eu.
- Συνδέστε τον εκτυπωτή σε μια θύρα USB. Όταν είναι συνδεδεμένος ένας εκτυπωτής, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο του εκτυπωτή.

Συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα

- Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα στο όργανο. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με συμβατές συσκευές ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα στη διεύθυνση aidian.eu.
- Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα σε μια θύρα USB. Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο της συσκευής ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα.


Πληκτρολόγιο

- Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού πληκτρολογίου στο όργανο.
- Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε μια θύρα USB. Όταν είναι συνδεδεμένο ένα πληκτρολόγιο, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο του πληκτρολογίου.

Σημείωση! Για τη σύνδεση παρελκομένων στο όργανο, μη χρησιμοποιείτε καλώδια USB με μήκος 3 m ή περισσότερο.

Μέρη του QuikRead go Plus Instrument

Τα μέρη του οργάνου εμφανίζονται στην **Εικόνα 1**, την **Εικόνα 2** και την **Εικόνα 3**.

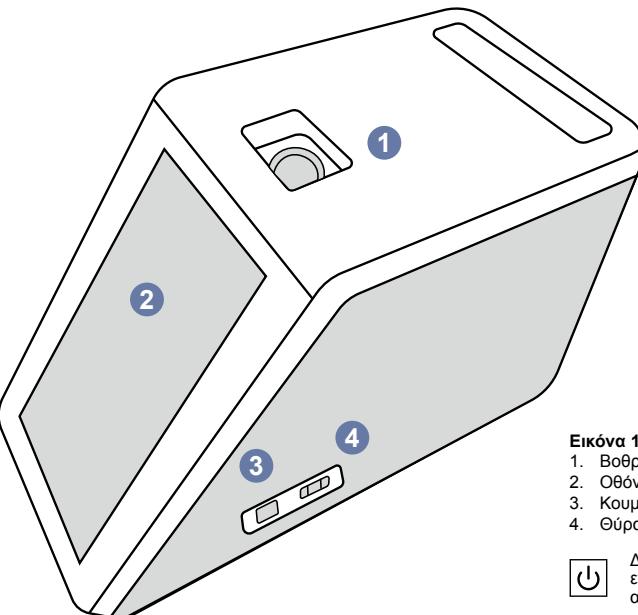


Εικόνα 1 Εμπρόσθια όψη

1. Βοθρό μέτρησης
2. Οθόνη αφής
3. Κουμπί τροφοδοσίας
4. Θύρα USB (τύπος A)



Διακόπτης
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

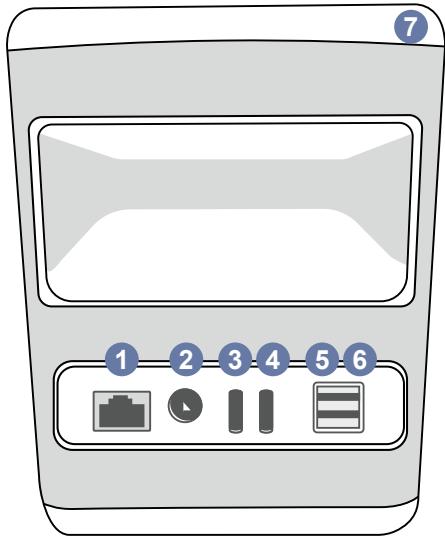

Εικόνα 2 Οπίσθια όψη

1. Θύρα RJ-45
2. Σύνδεσμος για τροφοδοτικό
3. Θύρα USB (τύπος C)
4. Θύρα USB (τύπος C)
5. Θύρα USB (τύπος A)
6. Θύρα USB (τύπος A)
7. Λαβή



Συμβουλευτείτε
τις οδηγίες
χρήσης





RJ-45



Iσχύς



USB

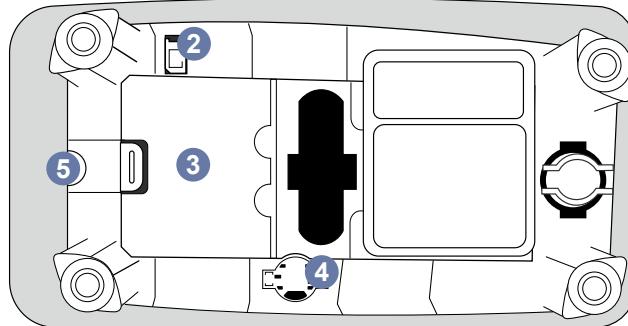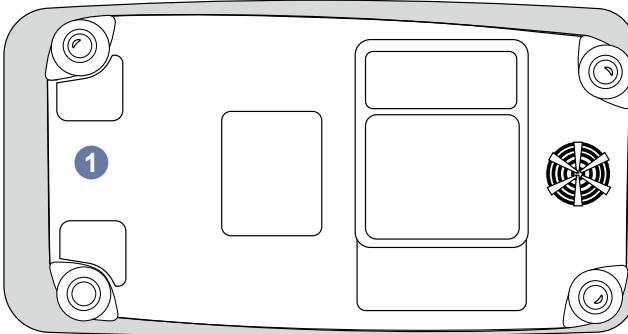

Εικόνα 3 Κάτω πλευρά

1. Κάλυμμα μονάδας μπαταρίας
2. Σύνδεσμος μπαταρίας
3. Μονάδα μπαταρίας
4. Μπαταρία ρολογιού
5. Σφραγίδα εγγύησης

Ανύψωση ή μεταφορά του QuikRead go Plus Instrument

Κατά την ανύψωση ή μεταφορά του οργάνου, να πραγματοποιείτε πάντα προσεκτικός χειρισμόυς. Για την ανύψωση του οργάνου χρησιμοποιήστε τη λαβή στο πίσω μέρος του οργάνου (Εικόνα 2).

Τοποθεσία και περιβάλλον

Κατά τη χρήση

To QuikRead go Plus Instrument θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, καθαρή, οριζόντια επιφάνεια και θα πρέπει να τηρούνται τα εξής:

- Χρήση σε εσωτερικό χώρο
- Υψόμετρο έως 2000 m
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 15 °C και 35 °C.
- Μέγιστη σχετική υγρασία 80% για θερμοκρασίες έως 31 °C, γραμμικά φθινούσα σε 67% σχετική υγρασία στους 35 °C (χωρίς συμπύκνωση).
- Μην τοποθετείτε το όργανο σε άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, μη μετακινείτε το όργανο και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε κραδασμούς.
- Μην πραγματοποιείτε μέτρηση σε όχημα εν κινήσει.
- Διακυμάνσεις τάσης τροφοδοσίας έως ±10% της ονομαστικής τάσης.
- Τοποθετήστε το όργανο με τρόπο ώστε να είναι εύκολο να κλείσετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη φορτίζετε το όργανο με εξωτερική μπαταρία (power bank).
- Μη συνδέστε εξωτερικές συσκευές που δεν έχουν εγκριθεί από την Aidian. Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HMS) ενδέχεται να υπερβαίνει το όριο
- Μην τοποθετείτε στο όργανο USB LTE δεδομένων κινητής
- Όλα τα εξωτερικά κυκλώματα των συσκευών που συνδέονται με τον εξπλισμό πρέπει να φέρουν τουλάχιστον διπλή μόνωση στο δίκτυο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το όργανο σε ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το όργανο κοντά σε πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ.

εσκεμμένες πηγές RF χωρίς θωράκιση), καθώς αυτές οι πηγές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στη φυσιολογική λειτουργία.

- Βαθμός ρύπανσης 2.
- Κατηγορία εγκατάστασης II (μεταβατικό φαινόμενο 2000 V).
- Περιορισμοί: Δεν επιπρέπει τη χρήση αυτής της συσκευής WiFi ή Bluetooth σε ακτίνα 20 km από το κέντρο του Ny-Alesund στο Svalbard της Νορβηγίας.



Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 2 °C και 35 °C.
- Προστατέψτε από τη βροχή και την υγρασία.
- Να χειρίζεστε το όργανο με προσοχή.

Καλώδιο τροφοδοσίας και μπαταρία

To QuikRead go Plus Instrument μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με το καλώδιο τροφοδοσίας είτε με την μπαταρία. Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα. Λίστα με τις συμβατές μπαταρίες μπορείτε να βρείτε στο [aidian.eu](#).

Σύνδεσμοι και καλώδια

Το όργανο διαθέτει μια θύρα USB-A στο πλάι (Εικόνα 1) και πέντε συνδέσμους: δύο θύρες USB-A, δύο θύρες USB-C και έναν συνδέσμο LAN στο πίσω μέρος του οργάνου (Εικόνα 2). Επίσης, μια θύρα USB-A είναι τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά του οργάνου. Η περιγραφή του διαγράμματος καλωδίωσης διατίθεται στη διεύθυνση [aidian.eu](#).

Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του οργάνου (βλ. Εικόνα 2). Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Κατά την τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρί-

ας στο όργανο, ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα (βλ. Εικόνα 3).

1. Απενεργοποιήστε το όργανο (εάν είναι ενεργοποιημένο) και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Στρέψτε το όργανο στο πλάι, σε ομαλή επιφάνεια, και ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας μπαταρίας.
3. Συνδέστε το σύνδεσμο της μπαταρίας στη μονάδα μπαταρίας.
4. Πλέστε την μπαταρία στη θέση της και επιβεβαιώστε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
5. Κλείστε το κάλυμμα της μονάδας μπαταρίας και τοποθετήστε ξανά το όργανο σε όρθια θέση.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση ισχύος

Για την ενεργοποίηση του οργάνου, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στο πλευρικό πλάισιο (βλ. Εικόνα 1) έως ότου ενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης. Εάν φωτίστε το κουμπί τροφοδοσίας, υποδεικνύεται ότι το όργανο έχει ενεργοποιηθεί. Εάν δεν συμβεί τίποτα, επιβεβαιώστε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση χρήσης μπαταρίας και δεν εκκινείται όταν πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας, μπορεί να έχει εξαντληθεί η μπαταρία. Για την εκκίνηση του οργάνου με άδεια μπαταρία, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.

Απενεργοποίηση ισχύος

Για την απενεργοποίηση του οργάνου, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για την επιβεβαίωση του τερματισμού. Εάν γίνει επιβεβαίωση, το όργανο θα απενεργοποιηθεί. Εάν πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για αρκετά δευτερόλεπτα, θα επιβεβαιωθεί ο τερματισμός ακόμα και χωρίς να αγγίζετε το αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη. Εάν κατά τον τερματισμό υπάρχει κυβέτα μέσα στο όργανο, η κυβέτα θα ανυψωθεί και το όργανο θα σας ζητήσει να την αφαιρέσετε.

Χρήση της οθόνης αφής

Στην οθόνη αφής χρησιμοποιείται τεχνολογία αφής χωρητικού τύπου και υποστηρίζονται ενέργειες όπως η

ολίσθηση, κατά περίπτωση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γυμνά δάχτυλα, με γάντια μίας χρήσης ή γραφίδα αφής. Δεν απαιτείται μεγάλη πίεση κατά την αλληλεπίδραση με την οθόνη αφής. Οταν πατηθεί ένα κουμπί, η ανατροφοδότηση είναι πολυαισθητική! Τα κουμπιά υποδεικνύει ένα αντίγγιγμα τόσο οπτικά, με αλλαγή της εμφάνισης, όσο και ηχητικά. Η καταχώριση μιας εντολής πραγματοποιείται όταν αφήσετε το δάχτυλό σας από το εικονικό κουμπί που αγγίζετε. Εάν απελευθερωθεί η πίεση έξω από την αρχική περιοχή κουμπιού, δεν καταγράφεται καμία εντολή.

Πρώτη ρύθμιση

Κατά την εκκίνηση του QuikRead go Plus Instrument για πρώτη φορά, το όργανο θα ζητησει από τον χρήστη να ορίσει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί καθοδηγούμενη ρύθμιση την οποία

μπορεί να παραλείψει ο χρήστης για να χρησιμοποιήσει τις προετοιμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις (**Εικόνα 4**). Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ρυθμίσης ή την παράλειψη, θα γίνει μετάβαση στην αρχική οθόνη (**Εικόνα 5**).

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αργότερα, μεταβείτε στο Μενού → **Ρυθμίσεις**.

Σημείωση! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια ρύθμιση, πατήστε το εικονίδιο **Πληροφορίες** δίπλα στη ρύθμιση, στο QuikRead go Plus Instrument.

Σημείωση! Οι ρυθμίσεις που αποστέλλονται από το ενδιάμεσο λογισμικό **POCT01-A2** θα παρακάμψουν τις ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο όργανο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Σημείωση! Για τις συνδέσεις, χρησιμοποιήστε μόνο την ισχυρότερη πολιτική ασφαλείας που είναι διαθέσιμη.



Εικόνα 4
Ορισμός κωδικού πρόσβασης διαχειριστή



Εικόνα 5
Πρώτη ρύθμιση

Πρώτη ρύθμιση:

1. Γλώσσα
 - Επιλέξτε τη γλώσσα του συστήματος.
2. Οθόνη, ίχος
 - Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης, την ένταση των ειδοποιήσεων και την ένταση του πληκτρολογίου με χρήση των ρυθμιστικών.
3. Ημερομηνία και ώρα
 - Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας και ορίστε την τρέχουσα ημερομηνία.
 - Επιλέξτε τη μορφή ρολογιού και ορίστε την τρέχουσα ώρα.
4. Εξικονώμαστη ενέργειας
 - Με χρήση του ρυθμιστικού, επιλέξτε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο το όργανο είσερχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
 - Επιλέξτε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
5. Μέτρηση
 - Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση της σειριακής μέτρησης.
 - » Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο εκείνη αυτόματα μια νέα μέτρηση δείγματος ασθενούς μετά την αποδοχή ή απόρριψη ενός προηγούμενου αποτελέσματος.
 - Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση της μέτρησης έκτακτης ανάγκης.
 - » Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποίησε μια δοκιμασία με χρήση της μέτρησης έκτακτης ανάγκης χωρίς να απαιτείται σύνδεση. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, ορίστε τον αριθμό των επιτρεπόμενων μετρήσεων έκτακτης ανάγκης.
6. Παραμέτροι δοκιμασίας
 - Η προβολή εμφανίζει τις δοκιμασίες που διατίθενται τη δεδομένη στιγμή και τις επιλογές μονάδων που έχουν οριστεί. Επιλέξτε τη δοκιμασία στην οποία θέλετε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους δοκιμασίας.
 - » Για αναλυτική περιγραφή των ρυθμίσεων παραμέτρων δοκιμασίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Παραμέτροι δοκιμασίας».
7. Εκτύπωση
 - Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση της εκτύπωσης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η εκτύπω-

ση, μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση της αυτόματης εκτύπωσης.

8. Ρυθμίσεις χειριστή

- Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση του αναγνωριστικού χειριστή. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο θα ζητά από τον χρήστη να εισαγάγει το αναγνωριστικό χειριστή κατά τη διενέργεια μετρήσεων.
» Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε να προτείνεται κάθε φορά από το όργανο το αναγνωριστικό χειριστή που καταχωρίθηκε προηγουμένων.

- Μπορείτε να ορίσετε υποχρεωτική τη σύνδεση χρήστη. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

» Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε με χρήση του ρυθμιστικού το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο ο χρήστης θα αποσυνδέεται αυτόματα. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη μετά από κάθε μέτρηση.

» Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέπεται η λίστα απομακρυσμένων χειριστών.

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, θα απενεργοποιούνται οι λογαριασμοί σύνδεσης που είναι αποθηκευμένοι τοπικά και θα είναι ενεργοί οι λογαριασμοί ενδιάμεσου λογισμικού LIS. Για την ορθή λειτουργία, απαιτείται ενεργή σύνδεση POC010-Α2. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα για τη ρύθμιση μιας σύνδεσης LIS».

9. Ρυθμίσεις γενικών χρηστών

- Επιλέξτε εάν οι γενικοί χρήστες μπορούν να προβάλουν τη λίστα αποτελεσμάτων.
- Επιλέξτε εάν οι γενικοί χρήστες μπορούν να προβάλουν τη λίστα ποιοτικού ελέγχου.

» **Σημείωση!** Όταν συνδέεστε ως διαχειριστής, η λίστα αποτελεσμάτων και η λίστα ποιοτικού ελέγχου είναι πάντα διαθέσιμες για προβολή.

10. Ρυθμίσεις αναγνωριστικού ασθενούς και ρυθμίσεις πρόσθετου αναγνωριστικού

• Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση του αναγνωριστικού ασθενούς. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο θα ζητά από τον χρήστη να εισαγάγει το αναγνωριστικό χειριστή κατά τη διενέργεια μετρήσεων.

• Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση πρόσθετου αναγνωριστικού. Όταν ενεργοποιηθεί το πρόσθετο αναγνωριστικό, το όργανο θα ζητά από τον χρήστη να εισαγάγει το πρόσθετο αναγνωριστικό κατά τη διενέργεια μετρήσεων.

» Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση πρόσθετων αναγνωριστικών στην ενότητα «Διαχείριση πρόσθετων αναγνωριστικών».

11. Αποθήκευση αποτελεσμάτων

• Επιλέξτε μέχρι πότε θα διατηρεί το όργανο αποθηκευμένα τα αποτελέσματα ασθενούς. Μετά τον επιλεγμένο χρόνο, το όργανο θα διαγράφει αυτόματα τα πλαισίτερα αποτελέσματα από τον χώρο αποθήκευσης. Εάν δεν γίνει επιλογή, το όργανο δεν θα διαγράφει τα αποτελέσματα με βάση τον χρόνο.

» Επιλέξτε έτη, μέρες ή ώρες.

• Επιλέξτε τον μέγιστο αριθμό αποτελεσμάτων ασθενούς που θα αποθηκεύονται. Όταν επιτυγχάνεται το όριο, το όργανο θα διαγράφει αυτόματα το πλαισίτερο αποτελέσμα από τον χώρο αποθήκευσης.

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Ο χειρισμός του QuikRead go Plus Instrument πραγματοποιείται από ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη που έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί τη χρήση. Σε αυτήν την ενότητα επεξηγούνται οι βασικές αρχές του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Στην οθόνη εμφανίζονται εικονικά κουμπιά και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την κατάσταση του οργάνου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα ρυθμιστικά στην οθόνη, εάν πατήστε πάνω σε ένα και το μετακινήστε σύροντάς το. Ομοίως, για ορισμένες προβολές με περισσότερη περιεχόμενο από αυτό που μπορεί να προσαρμοστεί ταυτόχρονα στην οθόνη, μπορείτε να σύρετε την προβολή προς τα πάνω και προς τα κάτω εάν πατήσετε στην οθόνη έχω από μια ενεργή περιοχή

επιλογής και τη μετακίνηστε.

Σε κάθε προβολή, εμφανίζονται η περιοχή κατάστασης και τα σύμβολά της, η γραμμή μενού, η βασική προβολή και, στο κάτω μέρος, οι συντομεύσεις για την επιλογή γλώσσας και τις γενικές ρυθμίσεις για τη ρύθμιση της φωτεινότητάς της οθόνης και της έντασης.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων γλώσσας, οθόνης και ήχου μπορεί να πραγματοποιηθεί από όλους τους χρήστες. Όταν απενεργοποιηθεί το όργανο ή αποσυνδέεται ο χρήστης, γίνεται επαναφορά αυτών των αλλαγών εάν τις έχει πραγματοποιήσει ένας γενικός χρήστης. Αγγίζτε τα εικονίδια στην οθόνη για να αλληλεπιδράσετε με το όργανο.



Εικόνα 6 Αρχική οθόνη

1. Περιοχή κατάστασης
2. Γραμμή μενού
3. Προβολή
4. Επιλογή γλώσσας
5. Γενικές ρυθμίσεις

Σύμβολα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του QuikRead go Plus Instrument

	Μέτρηση δείγματος		Ενέργειες λίστας
	Ποιοτικός έλεγχος		Αρχική οθόνη
	Μενού		Ειδοποίηση
	Εκτύπωση		Επιλογή γλώσσας
	Σχόλιο		Γενικές ρυθμίσεις
	Απόρριψη/Διαγραφή		Περισσότερες πληροφορίες

Μενού

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του οργάνου από το κύριο μενού . Στο μενού διατίθεται το κουμπί **Μέτρηση δείγματος** στην πάνω γραμμή. Μπορείτε να πατήσετε αυτό το εικονίδιο ως συντόμευση της μέτρησης δείγματος. Στην πάνω γραμμή διατίθεται επίσης ένα κουμπί για το κλείσιμο του μενού και την επιστροφή στην προηγούμενη προβολή, καθώς και το κουμπί αρχικής οθόνης για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Εικονίδια περιοχής κατάστασης

	Δείκτης στάθμης μπαταρίας		Σύνδεση καλωδίου τραφοδόσιας (επαναφόρτιση της μπαταρίας εάν είναι συνδεδεμένη)
	Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας (κόκκινο σύμβολο)		Κατάσταση WiFi
	Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB		LIS Σύνδεση με LIS
	Σύνδεση πληκτρολογίου		Διακοπή σύνδεσης LIS
	Σύνδεση συσκευής ανάγνωσης γραμμωτού κύδικα		Αναμονή αποστολής αποτελεσμάτων LIS εκτός σύνδεσης
	Σύνδεση εκτυπωτή		




Εικόνα 7 Μενού

Ειδοποίησης

Μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποίησεις του οργάνου στην επιλογή **Λίστα ειδοποίησεων** στη γραμμή μενού. Το εικονίδιο αλλάζει όταν υπάρχουν διαθέσιμες ειδοποίησης. Οταν επιλεγεί μια ειδοποίηση από τη λίστα, δίνονται περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι ειδοποίησης ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες


- Οι ειδοποίησης που δεν είναι καθοριστικής σημασίας από άποψη χρόνου έχουν μπλε χρώμα, π.χ. η μέτρηση είναι έτοιμη.
- Τα σημαντικά σφάλματα έχουν κίτρινο χρώμα, π.χ. σφάλμα σύνδεσης LIS.
- Τα σφάλματα συστήματος έχουν κόκκινο χρώμα, π.χ., αποτυχία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα και την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην Ενότητα 10 «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

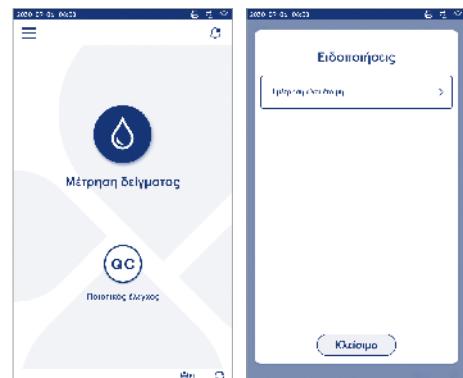

Επιλογή γλώσσας

Η αλλαγή γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί προσωρινά από όλους τους χρήστες στην Επιλογή γλώσσας που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Η επιλογή γλώσσας επηρεάζει το μενού και τη γλώσσα οδηγών, καθώς και τη διάταξη του πληκτρολογίου. Όταν αποσυνδέθουν οι χρήστες ή απενεργοποιηθεί το όργανο, γίνεται επαναφορά αυτής της επιλογής στη γλώσσα συστήματος. Ο χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί να αλλάξει τη γλώσσα συστήματος στη διαδρομή **Μενού → Ρυθμίσεις → Γλώσσα, οθόνη, ήχος.**

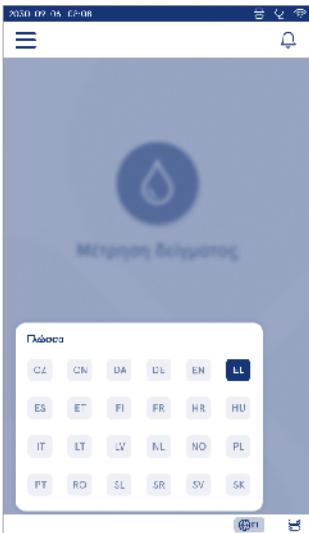


Γενικές ρυθμίσεις

Η αλλαγή των γενικών ρυθμίσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί προσωρινά από όλους τους χρήστες στη συντόμευση **Γενικές ρυθμίσεις** που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη φωτεινότητα της οθόνης, την ένταση των ει-

δοποιησεων και την ένταση του πληκτρολογίου. Όταν αποσυνδέθει ο χρήστης ή απενεργοποιηθεί το όργανο, γίνεται επαναφορά αυτών των επιλογών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του συστήματος.

- Η ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού.
- Η ρύθμιση της έντασης των ειδοποιήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού. Η σίγαση των ειδοποιήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά.
- Η ρύθμιση της έντασης του πληκτρολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού. Η σίγαση του πληκτρολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά.

Ο χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί να αλλάξει αυτές τις γενικές ρυθμίσεις στη διαδρομή **Μενού → Ρυθμίσεις → Γλώσσα, οθόνη, ήχος.**

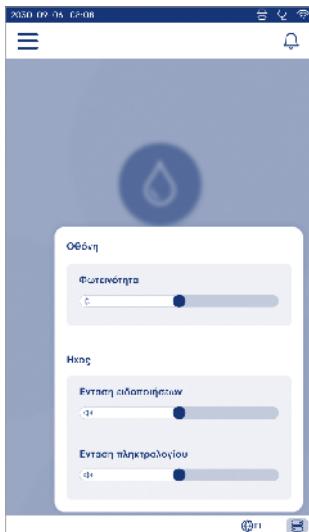

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η χρήση του QuikRead go Plus Instrument μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις βασικές λειτουργίες:

- Διενέργεια μέτρησης
- Προβολή αποτελεσμάτων
- Άλλαγή ρυθμίσεων οργάνου

Διενέργεια μέτρησης

Η χρήση του οργάνου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο λειτουργίες μέτρησης: μέτρηση δείγματος ασθενούς και μέτρηση δείγματος ποιοτικού ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης και των δύο λειτουργιών, μέσω των ρυθμίσεων.

Σημείωση! Για τη διενέργεια των δοκιμασιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα κιτ αντιδραστηρών QuikRead go. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του αντιστοιχού κιτ αντιδραστηρών QuikRead go, πριν από τη χρήση. Στις οδηγίες παρέχονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια δοκιμασιών και τον χειρισμό δειγμάτων.


Μέτρηση δείγματος ασθενούς

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανάλυση δείγματος ασθενούς, επιλέξτε **Μέτρηση δείγματος** στην οθόνη. Το όργανο θα καθοδηγήσει τον χρήστη στη διενέργεια της δοκιμασίας QuikRead go για το δείγμα ασθενούς. Το όργανο θα πραγματοποιήσει την ανάλυση και, μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανίσει το αποτέλεσμα στην οθόνη.

Για τη διενέργεια μέτρησης:

1. Επιλέξτε **Μέτρηση δείγματος** στην οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
2. Εισαγάγετε μια κυβέτα στο βιοθρίο μέτρησης, με τον γραμμωτό κώδικα της κυβέτας στραμμένο προς τα εμπρός (βλ. **Εικόνα 8**)
3. Το καπάκι κλείνει και το όργανο ξεκινά τη μέτρηση. Η πρόσδοση της ανάλυσης εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Μπορείτε να ματαιώσετε τη μέτρηση εάν επιλέξετε ακύρωση. Ως αποτέλεσμα, θα ανυψωθεί η κυβέτα και θα γίνει επιστροφή της προβολής στην αρχική οθόνη.

- Catá τη διάρκεια μιας μέτρησης, ο χρήστης μπορεί να προβάλλει προηγούμενα αποτελέσματα ασθενούς και αποτέλεσμα ποιοτικού ελέγχου και να αποκτά πρόσβαση στην προβολή «Πληροφορίες» μέσω του μενού. Κατά την εμφάνιση άλλων προβολών, θα εμφανίζεται στην οθόνη ένα εικονίδιο προβολού και το όργανο θα ειδοποιεί τον χρήστη όταν είναι έτοιμη η μέτρηση.
- Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση, εμφανίζεται το αποτέλεσμα και ανυψώνεται η κυβέτα.
- Aφαιρέστε την κυβέτα και επιλέξτε Απόδοχη ή Απόρριψη του αποτελέσματος. Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να προβάλετε προηγούμενα αποτελέσματα στη λίστα αποτελεσμάτων ασθενούς, στο Μενού .

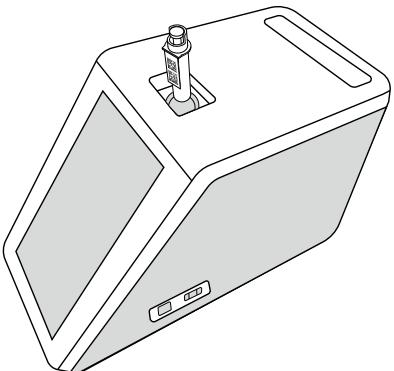

Εικόνα 8

Εισαγάγετε μια κυβέτα στο βοθρό μέτρησης, με τον γραμμωτό κώδικα στραμμένο προς τα εμπρός

- Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει πολλαπλές λειτουργίες στη μέτρηση του δείγματος ασθενούς (ανατρέξτε στην ενότητα «Μέτρηση»).
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του αναγνωριστικού χειριστή, του αναγνωριστικού ασθενούς και του πρόσθετου αναγνωριστικού. Το όργανο θα ζητήσει από τον χρήστη να εισαγάγει αυτά τα επιλεγμένα αναγνωριστικά, ώστε να ολοκληρωθεί η μέτρηση. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το πρόσθετο αναγνωριστικό στην ενότητα «Ρυθμίσεις πρόσθετου αναγνωριστικού».
- Η καταχώριση των αναγνωριστικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση της οθόνης αφής ή με τη βοήθεια μιας συσκευής ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα ή με ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το όργανο έτσι ώστε να εμφανίζει μήνυμα όπου θα προτείνει το αναγνωριστικό χειριστή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, όταν είναι απενεργοποιημένη η σύνδεση.
- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση έτσι ώστε να ζητείται από τον χρήστη να συνδεθεί στο όργανο με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν υπάρχει σύνδεση, εισαγάγεται αυτόματα το αναγνωριστικό χειριστή για κάθε μέτρηση.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της μέτρησης έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια δοκιμασία με χρήση της μέτρησης έκτακτης ανάγκης χωρίς να απαιτείται σύνδεση. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, ορίστε τον αριθμό των επιτρεπόμενων μετρήσεων έκτακτης ανάγκης. Είναι δυνατός ο ορισμός του αριθμού των αποδεκτών μετρήσεων έκτακτης ανάγκης.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας σειριακής μέτρησης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο ζεκινά αυτόματα μια νέα μέτρηση δείγματος ασθενούς μετά την αποδοχή ή απόρριψη του προηγούμενου αποτελέσματος από τον χρήστη.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της εκτύπωσης αποτελεσμάτων και της αποστολής αποτελεσμάτων σε σύστημα LIS, μέσω των ρυθμίσεων.

Προβολή αποτελεσμάτων δείγματος ασθενούς

Μετά από μια ολοκληρωμένη ανάλυση, είναι διαθέσιμη η προβολή αποτελεσμάτων δείγματος ασθενούς. Εμφανίζονται το αποτέλεσμα της ανάλυσης και οι πληροφορίες της δοκιμασίας. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχεται το αποτέλεσμα, ο οποίο θα αποθηκευτεί στη λίστα αποτελεσμάτων ασθενούς με τη χρήση του εικονίδιου . Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος μέσω της επιλογής εάν είναι ενεργοποιημένη η εκτύπωση και υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής. Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης σχολίου στο αποτέλεσμα. Για να γράψετε ένα σχόδιο επιλέξτε . Ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει να απορίησε το αποτέλεσμα μέσω της επιλογής . Κατά την απόρριψη, ο χρήστης πρέπει να αφήσει ένα σχόλιο. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί στη λίστα αποτελεσμάτων ασθενούς ως απορριθμένο και οι αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να συνεχίσουν να προβαλλούνται.



Αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων δείγματος

Η αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων δείγματος είναι διαθέσιμη μέσω της διαδρομής **Μενού** → **Αποτελέσματα ασθενούς** επιλέγοντας μια γραμμή αποτελεσμάτου. Στην αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων δείγματος, εμφανίζονται επιπροσθέτως το σειριακό αναγνωριστικό του οργάνου, σχόλια και πρόσθετες πληροφορίες για τον ασθενή. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της δοκιμασίας CRP, θα εμφανίζεται ο τύπος δείγματος. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκη σχολίων, μέσω της επιλογής , και εισαγωγής των πρόσθετων πληροφοριών για τον ασθενή.



Μέτρηση δείγματος ποιοτικού ελέγχου

Το όργανο διαθέτει ζεχωριστή λειτουργία μέτρησης για δείγματα ποιοτικού ελέγχου που μετρώνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δείγματα ασθενών, μέσω της επιλογής **Ποιοτικός ελέγχος** στην αρχική οθόνη. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε ζεχωριστό χώρο από τα αποτελέσματα ασθενών, και η προβολή τους είναι δυνατή από τα αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου, στην επιλογή **Μενού** .

Για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου, επιλέξτε **Ποιοτικός ελέγχος** στην αρχική οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει πολλαπλές λειτουργίες στη μέτρηση του δείγματος ποιοτικού ελέγχου [ανταρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ποιοτικού ελέγχου»].

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του αναγνωριστικού ελέγχου. Το όργανο θα ζητήσει από τον χρήστη την εισαγωγή του, για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του ελέγχου ποιοτικού ελέγχου, ώστε να υποδεικνύεται εάν ένα αποτέλεσμα ποιοτικού ελέγχου εμπίπτει εντός του εύρους που έχει οριστεί για το δείγμα ποιοτικού ελέγχου.

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, είναι δυνατή η ενεργοποίηση του κλειδώματος ποιοτικού ελέγχου, ώστε να περιοριστεί ο χρήση του οργάνου σε περίπτωση που αποτύχει η τελευταία μέτρηση ποιοτικού ελέγχου ή έχει λήξει το χρονοδιάγραμμα ποιοτικού ελέγχου. Μετά τη λήξη, ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μέτρηση των δειγμάτων ασθενούς πριν από τη διενέργεια επιτυχούς ποιοτικού ελέγχου.

Προβολή αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου

Μετά από μια ολοκληρωμένη μέτρηση ποιοτικού ελέγχου, είναι διαθέσιμη η προβολή αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα και οι πληροφορίες της δοκιμασίας. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί τα αποτέλεσμα ποιοτικού ελέγχου, το οποίο θα αποθηκευτεί στη λίστα αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου με τη χρήση του εικονίδιου . Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος μέσω της επιλογής εάν είναι ενεργοποιημένη η εκτύπωση και υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής. Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης σχολίου στο αποτέλεσμα. Για να γράψετε ένα σχόλιο επιλέξτε .



Αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου

Η αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου είναι διαθέσιμη μέσω της διαδρομής **Μενού** → **Αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου επιλέγοντας μια γραμμή αποτελεσμάτων.** Στην αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου, εμφανίζονται επιπρόσθιας η συγκέντρωση ποιοτικού ελέγχου, πρόσθετες πληροφορίες ποιοτικού ελέγχου και σχόλια. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων, μέσω της επιλογής



Αποτελέσματα

Η προβολή των αποτελεσμάτων είναι δυνατή μέσω της επιλογής **Μενού**. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε ξεχωριστές λίστες όσον αφορά τις επιλογές **Αποτελέσματα ασθενούς**, **Αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου** και **Αποτελέσματα LIS εκτός σύνδεσης**. Υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης της προβολής των αποτελεσμάτων, μέσω σάρωσης. Εάν επιλεγεί ένα αποτέλεσμα,

εμφανίζονται οι αναλυτικές πληροφορίες του. Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης των λιστών αποτελεσμάτων, αγγίζοντας μια κεφαλίδα στήλης.

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης της προβολής λίστας ασθενών με το **Αναγνωριστικό ασθενούς** και ταξινόμησης κατά **Ημερομηνία**, **Δοκιμασία** και **Αναγνωριστικό χειριστή**. Είναι δυνατό το φιλτράρισμα της προβολής λίστας αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου κατά **Δοκιμασία**, **Αναγνωριστικό ελέγχου**, **Ημερομηνία ποιοτικού ελέγχου** και **Αναγνωριστικό χειριστή**. Για το φιλτράρισμα μιας λίστας, μεταβείτε στην επιλογή **Ενέργειες λίστας** στη γραμμή μενού.

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης μεμονωμένων αποτελεσμάτων και λιστών αποτελεσμάτων. Είναι δυνατή η εκτύπωση των λιστών με ή χωρίς φίλτρα και η μεταφορά τους σε συσκευή αποθήκευσης USB. Πριν την ενεργοποίηση της μεταφοράς σε USB, απαιτείται φιλτράρισμα της λίστας αποτελεσμάτων. Για την εκτύπωση ενός μεμονωμένου αποτελέσματος, επιλέξτε τη γραμμή αποτελεσμάτος και, στη συνέχεια, επιλέξτε εκτύπωση

στην προβολή αποτελεσμάτων. Για την εκτύπωση μιας λίστας, μεταβείτε στην επιλογή **Ενέργειες λίστας** στη γραμμή μενού.

Διαγραφή αποτελεσμάτων

Ένας διαχειριστής μπορεί να διαγράψει μεμονωμένα αποτελέσματα από τη μνήμη του οργάνου. Επιλέξτε το αποτέλεσμα από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαγραφή αποτελεσμάτος από το κάτω μέρος της προβολής. Το όργανο θα ζητήσει πρόσθιτη επιβεβαίωση.


Λίστα LIS εκτός σύνδεσης

Μενού → **Λίστα LIS εκτός σύνδεσης**


Τα αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί από ένα όργανο με ενεργοποιημένη σύνδεση LIS ενώ είναι εκτός σύνδεσης αποθηκεύονται στην επιλογή **Αποτελέσματα LIS εκτός σύνδεσης**. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης, π.χ. λόγω στηγματισμού προβλήματος στο δίκτυο, τα αποτελέσματα αποθηκεύονται. Μετά την επαναφορά της σύνδεσης, τα αποτελέσματα μπορούν να αποσταλούν στο LIS. Μόλις μεταφερθούν τα αποτελέσματα στο LIS, αφαιρούνται από τη λίστα LIS εκτός σύνδεσης.

Για την αποστολή αποτελεσμάτων εκτός σύνδεσης στο LIS, επιλέξτε τα αποτελέσματα πατώντας το πλαίσιο ελέγχου στη γραμμή αποτελεσμάτος και επιλέγοντας **Αποστολή**. Για τη διαγραφή αποτελεσμάτων, επιλέξτε τα αποτελέσματα που πρόκειται να διαγραφούν και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαγραφή αποτελεσμάτος. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης επιλογής όλων των αποτελεσμάτων, πατώντας το πλαίσιο ελέγχου στη σειρά τίτλου του πίνακα αποτελεσμάτων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη μεταφορά αποτελεσμάτων εκτός σύνδεσης στις γενικές ρυθμίσεις LIS και γίνει επαναφορά της σύνδεσης LIS, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο σχετικά με την αποστολή των αποτελεσμάτων εκτός σύνδεσης στο LIS. Το όργανο ελέγχει τη σύνδεση LIS κατά την εκκίνηση και μετά από κάθε μέτρηση.

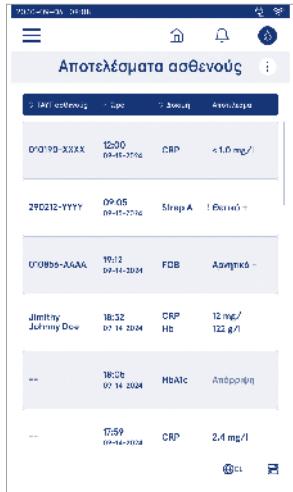

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

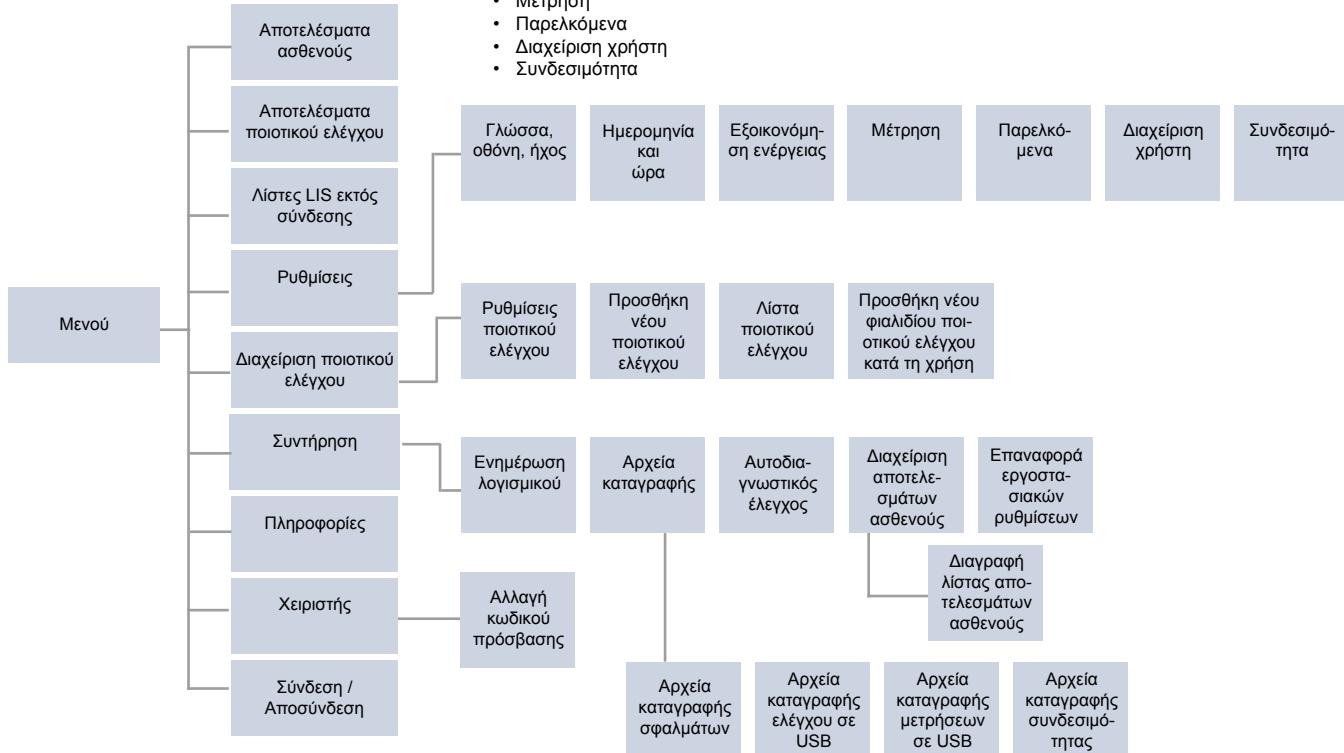

Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις είναι δυνατή από το Μενού **≡** επιλέγοντας **Ρυθμίσεις**. Στις ρυθμίσεις, ο χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί να ορίσει μόνιμες ρυθμίσεις για τα ακόλουθα. Οι γενικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα αλλαγής ορισμένων ρυθμίσεων και προβολής των ρυθμίσεων που απαιτούν εξουσιοδότηση διαχειριστή.

- Γλώσσα, οθόνη, ήχος
- Ημερομηνία και ώρα
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Μέτρηση
- Παρελκόμενα
- Διαχείριση χρήστη
- Συνδεσιμότητα

Σημείωση! Το σύστημα χρησιμοποιεί μια **Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης Αποθήκευση ✓**. Τυχόν μεταβολές θα αποθηκεύονται αυτόματα. Όταν είναι ενεργή η αυτόματη αποθήκευση, θα εμφανίζεται το **Αποθήκευση ✓** στη γραμμή μενού.

Γλώσσα, οθόνη, ήχος

- Μενού → Ρυθμίσεις → Γλώσσα, οθόνη, ήχος
- Η αλλαγή της γλώσσας συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας μια γλώσσα από τη λίστα επιλογών. Η επιλογή γλώσσας επηρεάζει το μενού και τη γλώσσα οδηγών, καθώς και τη διάταξη του πληκτρολογίου.
 - Η ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού.
 - Η ρύθμιση της έντασης των ειδοποιήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση των ειδοποιήσεων, με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά.
 - Η ρύθμιση της έντασης του πληκτρολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του πληκτρολογίου, με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά.

Ημερομηνία και ώρα

- Μενού → Ρυθμίσεις → Ημερομηνία και ώρα

- Μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή μορφής της ημερομηνίας από την επιλογή. Μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή ημερομηνίας με τον ορισμό νέας ημερομηνίας.
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή μορφής του ρολογιού μεταξύ 24 ωρών και 12 ωρών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή της τρέχουσας ώρας με τον ορισμό νέας ώρας.

Σημείωση! Πριν από τη μέτρηση, το όργανο ελέγχει την ημερομηνία λήξης των αντιδραστηρίων QuikRead go. Εάν οριστεί λανθασμένη ημερομηνία, ενδέχεται να περιοριστεί η χρήση των αντιδραστηρίων λόγω αποτυχίας ελέγχου της ημερομηνίας λήξης.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μενού → Ρυθμίσεις → Εξοικονόμηση ενέργειας

- Η καθυστέρηση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας μπορεί να αλλάξει με τη μετακίνηση του ρυθμιστικού. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα το όργανο εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή της κατάστασης αναστολής λειτουργίας από την επιλογή.

» Πλήρης αναμονή: Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, το όργανο κλείνει το καπάκι και σκοτεινιάζει την οθόνη πριν την απενεργοποιήσει. Η ενεργοποίηση της οθόνης μπορεί να πραγματοποιηθεί αιγγίζοντας την οθόνη ή πατώντας γρήγορα το κουμπί τροφοδοσίας.

» Μόνο κλείσιμο καπακιού: Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας το όργανο κλείνει το καπάκι, και η οθόνη σκοτεινιάζει.

Μέτρηση

- Μενού → Ρυθμίσεις → Μέτρηση

- Μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους δοκιμασίας επιλέγοντας μια δοκιμασία. Κάθε αναλυτής διαθέτει ειδικές ρυθμίσεις για αυτόν τον τύπο δοκιμασίας.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της λειτουργίας σειριακής μέτρησης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια δοκιμασία με χρήση της μέτρησης έκτακτης ανάγκης χωρίς να απαιτείται σύνδεση. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, ορίστε τον αριθμό των επιπρεπόμενων μετρήσεων έκτακτης ανάγκης.
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, ορίστε τον αριθμό των επιπρεπόμενων μετρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Παράμετροι δοκιμασίας

- Μενού → Ρυθμίσεις → Μέτρηση → Παράμετροι δοκιμασίας

- Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή μονάδων στις οποίες εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τη δοκιμασία. Σε ορισμένες δοκιμασίες, είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων.
- Εάν έχουν επιλεγεί πολλαπλές μονάδες για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, μπορεί να επιλεγεί η μονάδα στην οποία το αποτέλεσμα αποστέλλεται στο LIS.

• Είναι δυνατό να οριστούν όρια ενδείξεων για κάθε δοκιμασία. Είναι δυνατό να οριστούν όρια για χαμηλές, μειωμένες, αυξημένες ή και υψηλές τιμές αποτελεσμάτων. Στην προβολή αποτελεσμάτων δοκιμασίας θα εμφανίζονται τα καθορισμένα όρια ενδείξεων και το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο από το όριο των μειωμένων τιμών, δίπλα στο αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ένα μονό βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Ομοίως, εάν το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο από το όριο των χαμηλών τιμών, θα εμφανίζονται δύο βέλη που δείχνουν προς τα κάτω και εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει το όριο των αυξημένων τιμών, θα εμφανίζεται ένα μονό βέλος που δείχνει προς τα πάνω. Επίσης, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει το όριο των υψηλών τιμών, θα εμφανίζονται δύο βέλη που δείχνουν προς τα πάνω.



• Όσον αφορά τα ποιοτικά αποτελέσματα, η ένδειξη μπορεί να οριστεί σε «Pos +» (Θετικό +) ή «Neg -» (Αρνητικό -). Όταν το αποτέλεσμα δείγματος συμφωνεί με την επιλογή, δίπλα στο αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ένα θαυμαστικό. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, στην προβολή αποτελεσμάτων θα εμφανίζεται το κείμενο «Ένεργοποιημένη ένδειξη αποτελεσμάτων» για όλα τα αποτελέσματα.



Για ορισμένες δοκιμασίες, μπορεί να ενεργοποιηθεί η επισήμανση τύπου δείγματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, το όργανο θα εμφανίσει σφάλμα εάν ανιχνεύεται λανθασμένο τύπο δείγματος κατά τη μέτρηση.



Παρελκόμενα

Μενού → **Ρυθμίσεις** → **Παρελκόμενα**

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της εκτύπωσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η εκτύπωση και υπάρχει συνδεδεμένος ένας συμβατός εκτυπωτής, είναι δυνατή η ενεργοποίηση της αυτόματης εκτύπωσης. Με την αυτόματη εκτύπωση, τα αποτελέσματα κάθε δείγματος θα αποστέλλονται αυτόματα στον εκτυπωτή.

CRP	21 mg/l	QuikRead go Plus
Hb	100 g/l	38/A22064512288
Patient ID	Joe Smith	REAG JE45
Operator ID	Nurse 1	BUF JF08
Time	2021-01-29 10:18	2025-01-29
Sample type	Whole blood	

Εικόνα 9 Αποτέλεσμα του QuikRead go Plus κατά την εκτύπωση

Διαχείριση χρήστη

Μενού → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση χρήστη**

Ρυθμίσεις χειριστή

- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του αναγνωριστικού χειριστή. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο θα ζητά από τον χρήστη να εισαγάγει ένα αναγνωριστικό χειριστή κατά τη διενέργεια μετρήσεων.
- Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε να προτείνεται κάθε φορά το αναγνωριστικό χειριστή που καταχωρίζεται προηγουμένως.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της σύνδεσης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με τον κωδικό πρόσβασης.
- Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα σδράνειας μετά το οποίο ο χρήστης θα αποσυνδέεται αυτόματα με χρήση του ρυθμιστικού. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη μετά από κάθε μέτρηση.

Σημείωση! Συνιστάται ίδιαίτερα η ενεργοποίηση της σύνδεσης με κωδικό πρόσβασης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών, ίδιαίτερα σε περιβάλλοντα που δεν διαθέτουν ισχυρά μέτρα φυσικής ασφάλειας, όπως κοινόχρηστοι ή έκλειδωτοι χώροι εργασίας, καθώς και όταν επισκέπτεστε ασθενείς.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση, μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέπεται η λίστα απομακρυσμένων χειριστών. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση POCT01-A2 στο όργανο. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, η διαχείριση της λίστας χειριστών πραγματοποιείται από το ενδιάμεσο λογισμικό LIS, και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία μέσω του οργάνου. Εάν ενεργοποιηθεί η σύνδεση, θα απενεργοποιηθεί η πρόταση της προηγούμενης επιλογής.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της προβολής λίστας αποτελεσμάτων ασθενούς για τους γενικούς χρήστες.

- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της προβολής λίστας αποτελεσμάτων πιοιτικού ελέγχου για τους γενικούς χρήστες.

Σημείωση! Οταν συνδέεστε ως διαχειριστής, η λίστα αποτελεσμάτων ασθενούς και η λίστα πιοιτικού ελέγχου είναι πάντα διαθέσιμες για προβολή.

Διαχείριση χειριστών

Μενού → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση χρήστη** → **Διαχείριση χειριστών**

- Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα της προσθήκης νέων χειριστών, της προβολής πλήρους λίστας χειριστών και ρόλων και της επεξεργασίας λογαριασμών.
- Κατά την προσθήκη νέου αναγνωριστικού χειριστή:
- Επιλέγετε Ρόλος χειριστή (Γενικός/Διαχειριστής)
 - » Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χειριστή
 - » Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
 - » Εισαγάγετε το όνομα χειριστή
- Κατά την επεξεργασία λογαριασμών, είναι δυνατή η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης χρήστη.

Ανατρέξτε στον πίνακα δικαιωμάτων ρόλων χρήστη, στη σελίδα 102.

Ρυθμίσεις ασθενούς

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του αναγνωριστικού ασθενούς. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο θα ζητά από τον χρήστη να εισαγάγει το αναγνωριστικό ασθενούς κατά τη διενέργεια μετρήσεων.

Ρυθμίσεις πρόσθετου αναγνωριστικού

Το πρόσθετο αναγνωριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο πεδίο κειμένου ή ως επιλογή από μια προκαθορισμένη λίστα πρόσθετων αναγνωριστικών για κάθε μέτρηση δείγματος ασθενούς. Όταν ενεργοποιηθεί το πρόσθετο αναγνωριστικό, το όργανο θα ζητά από τον χρήστη να εισαγάγει ένα πρόσθετο αναγνωριστικό κατά τη διενέργεια μετρήσεων.


Για την καταχώριση των πρόσθετων αναγνωριστικών στη λίστα ή την προσαρμογή του ονόματος της λίστας, επιλέξτε Διαχείριση πρόσθετων αναγνωριστικών.

Διαχείριση πρόσθετων αναγνωριστικών

Μενού → Ρυθμίσεις → Διαχείριση χρήστη → Διαχείριση πρόσθετων αναγνωριστικών

Μπορείτε να καταχωρίσετε πρόσθετα αναγνωριστικά στη λίστα επιλέγοντας Προσθήκη στοιχείου λίστας. Εάν προστεθεί ένα στοιχείο στη λίστα, κατά τη διενέργεια μιας μέτρησης, θα ενεργοποιηθεί ένα κουμπί λίστας δίπλα στο πεδίο κειμένου (**Εικόνα 10**).

Μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα της λίστας επιλέγοντας Επεξέργασία δίπλα στο όνομα της λίστας. Κατά τη διενέργεια μιας μέτρησης, θα αντικατασταθεί ο τίτλος Πρόσθετο αναγνωριστικό (**Εικόνα 10**).

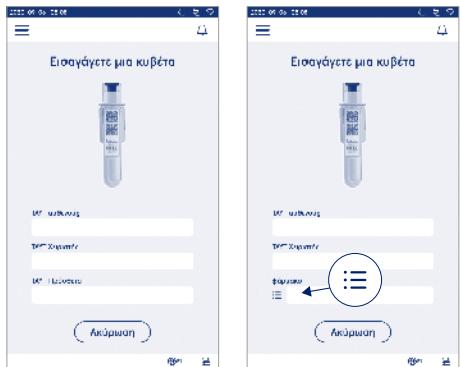

Εικόνα 10 Πρόσθετο αναγνωριστικό

Όταν έχουν προκαθοριστεί πρόσθετα αναγνωριστικά στη λίστα, ενεργοποιείται ένα κουμπί λίστας δίπλα στο πεδίο κειμένου (δεξιά). Όταν έχει γίνει επεξέργασία του ονόματος της λίστας πρόσθετων αναγνωριστικών, το όνομα θα εμφανίζεται πάνω από το πεδίο κειμένου (δεξιά).

Συνδεσιμότητα

Μενού → Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του οργάνου σε πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου ή νοσοκομείου (LIS/HIS) με σύνδεση LAN ή WLAN. Η χρήση αυτών των συνδέσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί για την αυτόματη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του οργάνου και του συστήματος στην απομακρυσμένη διαχείριση και την προβολή αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Σημείωση! Για τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος.

LIS

Μενού → Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → LIS (LIS)

- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της σύνδεσης LIS. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, μπορεί να επιλεγεί η αυτόματη μεταφορά αποτελεσμάτων. Εάν διακοπεί η σύνδεση, τα αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί αλλά δεν έχουν αποσταλεί στο LIS θα εμφανίζονται στην προβολή αποτελεσμάτων LIS εκτός σύνδεσης (βλ. Ενότητα «Λίστα LIS εκτός σύνδεσης»)
- Υπάρχει δυνατότητα επιλογής τύπου σύνδεσης. Οι διαθέσιμοι τύποι σύνδεσης είναι οι εξής:
 - » POCT1-A2
 - » LIS01-A2 (TCP/IP)
 - » LIS01-A2 (RS232)
- Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης διακομιστή LIS και της θύρας TCP.
- Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του διαστήματος συνομιλίας με χρήση του ρυθμιστικού.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της κρυπτογράφησης TLS. Υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης του πιστοποιητικού TLS από μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της επαλήθευσης του αναγνωριστικού ασθενούς. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο θα ελέγχει το αναγνωριστικό ασθενούς από το ενδιάμεσο λογισμικό POCT1-A2. Εάν είναι άκυρο το αναγνωριστικό ασθενούς που καταχωρίθηκε, το όργανο θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος.

• Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της εμφάνισης των δεδομένων ασθενούς. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το όργανο θα ανακτά τα δεδομένα ασθενούς από το ενδιάμεσο λογισμικό POCT1-A2 με βάση το αναγνωριστικό ασθενούς που καταχωρίθηκε.

- Υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής της μεταφοράς αποτελεσμάτων εκτός σύνδεσης, μεταξύ αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Όταν είναι επιλεγμένη η αυτόματη λειτουργία, τα αποτελέσματα LIS εκτός σύνδεσης θα μεταφέρονται αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση. Όταν είναι επιλεγμένη η χειροκίνητη λειτουργία, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τα αποτελέσματα που πρόκειται να μεταφερθούν στο LIS.

TCP/IP

Μενού → Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → TCP/IP

- Υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής του τύπου διεύθυνσης IP, μεταξύ στατικής IP και δυναμικής IP.
- Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης IP.
- Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της μάσκας υποδικτύου.
- Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της προεπιλεγμένης πύλης.
- Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του διακομιστή DNS.

WLAN

Μενού → Ρυθμίσεις → Συνδεσιμότητα → WLAN (LIS)

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της σύνδεσης WLAN. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, η σύνδεση μπορεί να οριστεί μέσω σάρωσης των διαθέσιμων δικτύων WLAN επιλέγοντας «Σάρωση» ή μέσω χειροκίνητης ρύθμισης. Η σάρωση θα εμφανίζει τη λίστα διαθέσιμων δικτύων WLAN. Επιλέγετε το επιθυμητό δίκτυο από τη λίστα. Εάν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα αναδύμενο παράθυρο.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η πρόσβαση στη διαχείριση ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατή από το **Mενού** → επιλέοντας **Διαχείριση ποιοτικού ελέγχου**. Οι ρυθμίσεις διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου ελέγχουν τη λειτουργία μέτρησης ποιοτικού ελέγχου που προορίζεται για την πάρακολουθήση της απόδοσης του οργάνου με χρήση κιτ αντιδραστηρίων QuikRead go και δειγμάτων ελέγχου.

Ρυθμίσεις ποιοτικού ελέγχου

Μενού → Διαχείριση ποιοτικού ελέγχου → **Ρυθμίσεις ποιοτικού ελέγχου**

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του αναγνωριστικού ελέγχου. Το όργανο θα ζητήσει από τον χρήστη την εισαγωγή του, για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του ελέγχου ποιοτικού ελέγχου, ώστε να υποδεικνύεται εάν ένα αποτέλεσμα ποιοτικού ελέγχου εμπίπτει εντός του εύρους που έχει οριστεί για το δείγμα ποιοτικού ελέγχου. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ποιοτικού ελέγχου και το αποτέλεσμα ποιοτικού ελέγχου εμπίπτει εντός του αποδεκτού εύρους, μαζί με το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται το κείμενο **Επιτυχία ποιοτικού ελέγχου**. Εάν το αποτέλεσμα ποιοτικού ελέγχου είναι εκτός εύρους, θα εμφανίζεται το κείμενο **Αποτυχία ποιοτικού ελέγχου**. Μαζί με το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται το κείμενο **Αποτέλεσμα εκτός εύρους**.



Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, είναι δυνατή η ενεργοποίηση του κλειδώματος ποιοτικού ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η χρήση του οργάνου σε περίπτωση που αποτύχει η τελευταία μέτρηση ποιοτικού

ελέγχου ή έχει λήξει το χρονοδιάγραμμα ποιοτικού ελέγχου. Μετά τη λήξη, ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μέτρηση των δειγμάτων ασθενούς πριν από τη διενέργεια επιπυχούς ποιοτικού ελέγχου. Ορίστε το χρονοδιάγραμμα και επιλέξτε καθημερινά, μετά από επιλεγμένο αριθμό δοκιμασών ή σε επιλεγμένης μημέρα. Το όργανο θα ζητήσει εισαγωγή για τα δύο τελευταία. Εάν το χρονοδιάγραμμα έχει οριστεί για καθημερινά, την επόμενη ημέρα θα ενεργοποιηθεί το κλειδώμα ποιοτικού ελέγχου εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί μέτρηση ποιοτικού ελέγχου εγκαίρως.

Προσθήκη νέου ποιοτικού ελέγχου

Μενού → Διαχείριση ποιοτικού ελέγχου → **Προσθήκη νέου ποιοτικού ελέγχου**


Η προσθήκη νέου ποιοτικού ελέγχου χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πληροφορίων σχετικά με έναν νέο ποιοτικό έλεγχο όπου είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Αναγνωριστικό έλεγχου» στις ρυθμίσεις ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος που προστίθεται θα είναι διαθέσιμος για επιλογή κατά τη διενέργεια μετρήσεων ποιοτικού ελέγχου. Το όργανο θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ελέγχου όπαν προσδιορίζει εάν ένας ποιοτικός έλεγχος ήταν επιτυχής ή απέτυχε.

Μπορείτε να καταχωρίσετε το όνομα ποιοτικού ελέγχου, ώστε να οριστεί ένα όνομα που θα εμφανίζεται στην επιλογή λίστας ποιοτικού ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της μονάδας ποιοτικού ελέγχου που εμφανίζεται με τα αποτελέσματα. Το εύρος ποιοτικού ελέγχου είναι υποχρεωτικό και χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν μια μέτρηση ποιοτικού ελέγχου με χρήση του αναγνωριστικού ελέγχου ήταν επιτυχής ή απέτυχε. Η συγκέντρωση ποιοτικού ελέγχου είναι υποχρεωτική και αποτελεί την τιμή-στόχο της μέτρησης δείγματος ελέγχου. Η λήξη της παρτίδας ποιοτικού ελέγχου είναι υποχρεωτική και χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν χρησιμοποιούνται ληγμένα αντιδραστήρια για ποιοτικό έλεγχο.

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού της ημερομηνίας λήξης του φιαλίδιου ποιοτικού ελέγχου κατά τη χρήση. Τα

φιαλίδια δειγμάτων ελέγχου των κιτ αντιδραστηρίων QuikRead go έχουν ημερομηνία λήξης και ξεχωριστό χρονικό διάστημα λήξης κατά τη χρήση, όταν ανοιχτούν. Το όργανο παρέχει την επιλογή εισαγωγής της τελευταίας ημερομηνίας χρήσης για ένα ανοιγμένο φιαλίδιο ποιοτικού ελέγχου, ώστε να διευκολύνει τη διαχείριση των χρονικών διαστημάτων λήξης των φιαλίδιων ποιοτικού ελέγχου κατά τη χρήση. Κατά τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου και την επιλογή ενός αναγνωριστικού ελέγχου, εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του ανοιγμένου φιαλίδιου, το όργανο εμφανίζει ένα αναδύομενο παράθυρο. Το αναδύομενο παράθυρο προτείνει το άνοιγμα ενός νέου φιαλίδιου και την καταχώριση ημερομηνίας λήξης ενός νέου ανοιγμένου φιαλίδιου κατά τη χρήση. Υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης πρόσθετων πληροφοριών ποιοτικού ελέγχου για κάθε αναγνωριστικό ελέγχου.

Σημείωση! Κατά την καταχώριση πληροφοριών για ένα νέο δείγμα ελέγχου, ανατρέξτε στην επισήμανση και στις οδηγίες χρήσης του δείγματος ελέγχου.

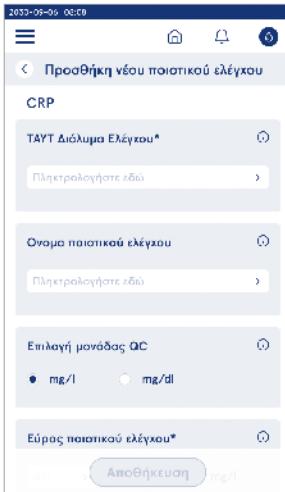

Λίστα ποιοτικού ελέγχου

Μενού → Διαχείριση ποιοτικού ελέγχου → Λίστα ποιοτικού ελέγχου

Υπάρχει δυνατότητα προβολής και αλλαγής των πληροφοριών σχετικά με τα αναγνωριστικά ελέγχου από τη λίστα ποιοτικού ελέγχου. Στην προβολή λίστας εμφανίζονται το όνομα, η ημερομηνία λήξης, η δοκιμασία και το έργο για κάθε ελέγχο.

Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης της λίστας, με χρήση των κεφαλίδων στήλης.


Προσθήκη νέου φιαλίδιου ποιοτικού ελέγχου κατά τη χρήση

Μενού → Διαχείριση ποιοτικού ελέγχου → Προσθήκη νέου φιαλίδιου ποιοτικού ελέγχου κατά τη χρήση

Υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης ημερομηνίας λήξης νέου φιαλίδιου ποιοτικού ελέγχου κατά τη χρήση για ένα υπάρχον αναγνωριστικό ελέγχου. Επιλέξτε από τη λίστα το αναγνωριστικό ελέγχου στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε ημερομηνία λήξης νέου φιαλίδιου ποιοτικού ελέγχου κατά τη χρήση. Θα εμφανιστεί ένα αναδύμενο παράθυρο όπου θα δίνονται οδηγίες για τη ρύθμιση.

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης της ημερομηνίας ως ημερομηνία ή ως αριθμός ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής της ημερομηνίας λήξης ενός ανοιγμένου φιαλίδιου που καταχωρίθμητε προηγουμένως.

Σημείωση! Ελέγχετε το χρονικό διάστημα λήξης κατά τη χρήση, στις οδηγίες χρήσης του δείγματος ελέγχου.



6. ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση στο μενού συντήρησης είναι δυνατή από το Μενού → επιλέγοντας Συντήρηση.

Ενημέρωση λογισμικού

Μενού → Συντήρηση → Ενημέρωση λογισμικού

Η ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού του οργάνου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μιας συσκευής αποθήκευσης USB. Επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού.

Αρχεία καταγραφής

Μενού → Συντήρηση → Αρχεία καταγραφής

Το όργανο καταγράφει στη μνήμη του τη μέτρηση, το σφάλμα, τη συνδεσιμότητα και τα αρχεία καταγραφής ελέγχου. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες, για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων

Μενού → Συντήρηση → Αρχεία καταγραφής → Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων

Τα σφάλματα του οργάνου αποθηκεύονται στη μνήμη του. Υπάρχει δυνατότητα προβολής προηγούμενων σφαλμάτων στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων. Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης της προβολής, αγγίζοντας μια κεφαλίδα στήλης. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των κωδικών σφαλμάτων σε συσκευή αποθήκευσης USB μέσω της επιλογής «Μεταφορά σε USB» στη γραμμή μενού.

Αρχεία καταγραφής ελέγχου σε USB

Μενού → Συντήρηση → Αρχεία καταγραφής → Αρχεία καταγραφής ελέγχου σε USB

Στα αρχεία καταγραφής ελέγχου περιλαμβάνονται πληροφορίες σύνδεσης, καταγραφές ενεργειών μέτρησης δειγμάτων, απορρίψεις αποτελεσμάτων, διαγραφές αποτελεσμάτων και διαγραφές αρχείων καταγραφής. Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της χρήσης του οργάνου.

Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αρχείων καταγραφής ελέγχου του οργάνου σε συσκευή αποθήκευσης USB.



Αρχεία καταγραφής μετρήσεων σε USB

Μενού → Συντήρηση → Αρχεία καταγραφής μετρήσεων σε USB

H Aidian χρησιμοποιεί τα αρχεία καταγραφής μετρήσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, π.χ. σε περίπτωση παραπόνων πελατών. Τα αρχεία καταγραφής μετρήσεων είναι κρυπτογραφημένα, και διαθέσιμα μόνο για το πρωταρχικό της Aidian. Περιέχουν αρχεία καταγραφής απόδοσης του οργάνου χωρίς πληροφορίες για τον ασθενή ή τον χρήστη.

Αρχεία καταγραφής συνδεσιμότητας

Μενού → Συντήρηση → Αρχεία καταγραφής συνδεσιμότητας

Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων καταγραφής συνδεσιμότητας στη μνήμη. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της συλλογής αρχείων καταγραφής LIS. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αρχείων καταγραφής συνδεσιμότητας σε συσκευή αποθήκευσης USB.

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

Μενού → Συντήρηση → Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος

Το όργανο πραγματοποιεί έλεγχο λειτουργιών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του. Για τη χειροκίνητη διενέργεια ενός αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, επιλέξτε Ναι. Μετά την ολοκλήρωση, το σύστημα θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη.

Διαχείριση αποτελεσμάτων ασθενούς

Μενού → Συντήρηση → Διαχείριση αποτελεσμάτων ασθενούς

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού ή αλλαγής της διάρκειας αποθήκευσης των αποτελεσμάτων ασθενούς. Ορίστε τον χρόνο αποθήκευσης σε έτη, ημέρες ή ώρες. Τα παλαιότερα αποτελεσμάτα ασθενών θα διαγράφονται αυτόματα μετά τον επιλεγμένο χρόνο. Εάν δεν γίνει επιλογή, το όργανο θα διαγράφει τα αποτελέσματα με βάση τον χρόνο.

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του μέγιστου αριθμού αποτελεσμάτων ασθενούς στον χώρο αποθήκευσης. Όταν επιτυχώνται το όριο, το όργανο θα διαγράφει αυτόματα το παλαιότερο αποτέλεσμα από τον χώρο αποθήκευσης.

Διαγραφή λίστας αποτελεσμάτων ασθενούς

Μενού  → Συντήρηση → Διαγραφή λίστας αποτελεσμάτων ασθενούς

Υπάρχει δυνατότητα πλήρους διαγραφής της λίστας αποτελεσμάτων ασθενούς. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προστασίας δεδομένων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μενού  → Συντήρηση → Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του οργάνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΒΟΥΤ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Στην προβολή *Πληροφορίες* εμφανίζονται ο σειριακός αριθμός του οργάνου, η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και οι πληροφορίες σύνδεσης. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα ονομασίας του οργάνου. Μόλις δοθεί το όνομα του οργάνου, θα εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της θύρων σε όλες τις προβολές.

Η πρόσβαση στην επιλογή «Πληροφορίες» είναι δυνατή από το Μενού  επιλέγοντας *Πληροφορίες*.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

To QuikRead go Plus Instrument είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι φιλικό προς τον χρήστη, χωρίς να χρειάζεται τακτική συντήρηση. Για τις απαιτήσεις επισκευής και συντήρησης, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή.

Βαθμονόμηση του οργάνου

Το όργανο είναι βαθμονομημένο από το εργοστάσιο. Ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας του οργάνου πραγματοποιείται με τη διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου κατά την εκκίνηση και σε κάθε μέτρηση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Τα δεδομένα βαθμονόμησης που ορίζουν κάθε δοκιμασία είναι κωδικοποιημένα στις επικέτες των κυβετών. Το όργανο διαβάζει αυτόματα αυτές τις πληροφορίες, σε κάθε μέτρηση.

Καθαρισμός του οργάνου

Καθαρίζετε ανά διαστήματα το εξωτερικό του οργάνου με ένα πανί που δεν αφήνει χνουδιά, εμποτισμένο με νερό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στο όργανο από τις άκρες της οθόνης, το άνοιγμα του βοθρίου μέτρησης ή τους συνδέσμους. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή διαβρωτικές ουσίες. Θα πρέπει να σκουπίζετε αμέσως την έκχυση δυνητικά μολυσματικού υλικού με απορροφητικό χαρτί και να ταμπονάρετε τις μολυσμένες περιοχές με ένα σύνθετος απολυμαντικό ή αιθυλική αλκοόλη 70%. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό εκχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των γαντιών, θα πρέπει να απορρίπτονται ως βιολογικώς επικίνδυνα απόβλητα.

Αποδεκτά απολυμαντικά:

- Αιθυλική αλκοόλη 70%
- Ισοπροπανόλη 70%
- Υποχλωριώδες νάτριο 0,5%
- Γλουταραλδεϋδη 2%

Ενημέρωση λογισμικού

Υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του λογισμικού του οργάνου. Μεταβείτε στην ενημέρωση λογισμικού μέσω της διαδρομής Μενού  → Συντήρηση → Ενημέρωση λογισμικού και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον τοπικό προμηθευτή.

Αλλαγή της μπαταρίας ρολογιού

Το όργανο διαθέτει μπαταρία για το εσωτερικό ρολόι, ώστε να διατηρείται η ώρα όταν είναι απενεργοποιημένο. Εάν είναι χαμηλή η φόρτιση της μπαταρίας ρολογιού, εμφανίζεται μια προειδοποίηση. Η μπαταρία ρολογιού είναι δυνατό να αντικατασταθεί με μια μπαταρία τύπου CR 2032 3V (Εικόνα 3).

9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Δήλωση συμμόρφωσης

Το QuikRead go Plus Instrument συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 για τα *in vitro* διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την οδηγία 2011/65/ΕΕ για την περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαζί με την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και την οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα αποβλητικά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το QuikRead go Plus Instrument συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και ατροσίας, όπως περιγράφονται στο πρότυπο IEC 61326-2-6:2012. Το όργανο πληρού τις απαιτήσεις κατηγορίας A της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Το QuikRead go Plus Instrument συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Το όργανο συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το όργανο διαθέτει έναν προγραμματισμένο εκ των προτέρων μικροεπεξεργαστή που ελέγχει τα στάδια του προσδιορισμού και την επεξεργασία δεδομένων. Στον γραμμιστό κώδικα κάθε κυβέτας, περιέχονται δεδομένα ταυτοποίησης της δοκιμασίας, χρονισμού και καμπύλης βαθμονόμησης ή τιμής αποκοπής. Μόλις ενεργοποιηθεί ο μικροεπεξεργαστής από την επικέτα της κυβέτας, ελέγχει και καθοδηγεί όλα τα στάδια του προσδιορισμού και μετατρέπει τις τιμές απορρόφησης των δειγμάτων σε μονάδες συγκέντρωσης ή τιμές αποκοπής.

Φωτόμετρο

Το φωτόμετρο του QuikRead go Plus Instrument αποτελείται από ένα βοθρίο μέτρησης, τρεις λυχνίες LED και ανιχνεύεται φωτός. Το φωτόμετρο έχει σχεδιαστεί και βαθμονομηθεί τόσο για φωτομετρικές όσο και για θολοσιμετρικές μετρήσεις.

Οθόνη αφής

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη βασίζεται σε μια εύχρηστη οθόνη αφής χωρητικού τύπου. Παρέχει στον χρήστη μηνύματα, προτροπές και σκίτσα για τη διενέργεια κάθε σταδίου του προσδιορισμού και εμφανίζει αποτελέσματα δοκιμασών και μηνύματα σφάλματος.

Διαστάσεις και απαιτήσεις ισχύος

- Βάρος: 2,0 kg χωρίς τροφοδοτικό
- Μέγεθος: 26,9 x 16,6 x 13,9 cm
- Απαιτήσεις ισχύος
 - Τάση: 100-240 V AC
 - Συχνότητα: 50-60 Hz
 - Κατανάλωση ισχύος:
 - Αδράνεια 4 W
 - Αναμονή 1 W
 - Μέγ. 35 W (χωρίς εξωτερικά εξαρτήματα)
 - Είσοδος 18V = 3.3A

Αναγνωριστικό οργάνου

Κάθε QuikRead go Plus Instrument διαθέτει έναν μοναδικό σειριακό αριθμό που βρίσκεται στην επικέτα, στο κάτω μέρος του οργάνου, και στην προβολή About (Πληροφορίες) στην οποία μπορείτε να μεταβείτε από το **Μενού** ☰.

Μνήμη

Το QuikRead go Plus Instrument διαθέτει εσωτερική μνήμη για το ιστορικό αποτελεσμάτων και τα αρχεία καταγραφής. Το όργανο μπορεί να αποθηκεύσει 6.000 αποτελέσματα ασθενών και 6.000 αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου.

Τροφοδοτικό

Η τροφοδοσία του οργάνου πραγματοποιείται από ένα τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί με το όργανο. Εκτός από το τροφοδοτικό, το όργανο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μπαταρία ως πηγή ρεύματος. Ένας εσωτερικός διακόπτης μέσα στον σύνδεσμο του καλώδιου πραγματοποιεί αυτόματη μετάβαση από τη χρήση μπαταρίας στη χρήση ρεύματος. Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της μπαταρίας, ανατρέξτε στην Ενότητα «Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας».

Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας

Wi-Fi διπλής ζώνης 2,4 GHz/5 GHz και μονάδα Bluetooth Μοντέλο Panasonic: PAN9028.

Σύνδεση LIS

Για τη σύνδεση, χρησιμοποιούνται τα εξής:

- Ένας σύνδεσμος RJ-45 και μια υποστηριζόμενη σύνδεση Ethernet 10BASET/ 100BASE-TX/1000BASE-TX. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο συνετραμμένου χύγους χωρίς θωράκιση.
 - Μία σύνδεση WLAN.
 - Δεν υποστηρίζεται η ισχύς μέσω Ethernet (PoE).
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας, για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύνδεση USB

Το όργανο διαθέτει τρεις συνδέσμους USB τύπου A και δύο συνδέσμους USB τύπου C. Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτυπωτές, συσκευές ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα, πληκτρολόγια και συσκευές αποθήκευσης USB.

Τεχνική υποστήριξη

To QuikRead go Plus Instrument έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μη χρειάζεται τακτική συντήρηση και διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του οργάνου, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή. Πριν από την αποστολή του οργάνου στην τεχνική υποστήριξη, διαγράψτε όλα τα ασποτέλεσματα ασθενών από την προβολή συντήρησης, επιλέγοντας τη διαγραφή λίστας ασποτελεσμάτων ασθενούς, και καθαρίστε το εξωτερικό του οργάνου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του οργάνου».

Εγγύηση

Η εγγύηση του κατασκευαστή για το QuikRead go Plus Instrument καλύπτει ελαπτώματα όσον αφορά τα υλικά ή την κατασκευή, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Για να ισχύει η εγγύηση, πρέπει να είναι άθικτη η σφραγίδα εγγύησης (**Εικόνα 3**). Ο κατασκευαστής συμφωνεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το όργανο εάν αυτό καταστεί μη λειτουργικό λόγω βλάβης οποιουδήποτε εσωτερικού μέρους του οργάνου. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν έχει υποχρέωση να τροποποιήσει ή να ενημερώσει το όργανο μετά την κατασκευή του, παρά μόνον εάν εντοπιστεί κατασκευαστικό ελάττωμα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του οργάνου, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή.

Απόρριψη

To QuikRead go Plus Instrument είναι μια ηλεκτρονική συσκευή χαμηλής τάσης. Ένα χρησιμοποιημένο QuikRead go Plus Instrument πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυνητικώς βιολογικά επικίνδυνο απόβλητο. Το όργανο θα πρέπει να απορρίπτεται ως απόβλητο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ 2012/19/EU) εάν οι τοπικοί και εθνικοί νόμοι δεν απαιτούν τη συλλογή και την απόρριψη του οργάνου ως δυνητικώς μολυσματικό κλινικό απόβλητο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη του οργάνου στον ιστόποτο μας [aidian.eu](#).

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Η απόρριψη της μονάδας μπαταρίας και της εσωτερικής μπαταρίας ρολογιού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανόνες συλλογής μπαταριών που βασίζονται στην Οδηγία 2006/66/EK ή τον Κανονισμό 2023/1542/EU σχετικά με τις μπαταρίες.

Ιστορικό αναθεώρησης

Το ιστορικό αναθεώρησης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [aidian.eu](#).

Ζώνες συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων:

Τεχνολογίες που υποστηρίζονται	Τρόπος λειτουργίας	Ζώνη	Εύρος συχνότητας	Μέγιστη αγώγιμη μεσή ισχύς εξόδου		Απολαβή κεραίας (ενσωματωμένη κεραία τάση)	Μέγιστη ακτινοβολούμενη μεσή ισχύς εξόδου
				[MHz]	[dBm]		
Bluetooth	Βασικός ρυθμός (BR)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4	2.1	<10	
Bluetooth	Ενισχυμένος ρυθμός δεδομένων (EDR)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4	2.1	<10	
Bluetooth	Χαμηλή ενέργεια (LE)	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	4	2.1	<10	
WLAN	IEEE 802.11b/g/n	2.4 GHz	2 400... 2 483.5	16	2.1	<19	
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 150... 5 250	16	1.5	<18	
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 250... 5 350	16	1.5	<18	
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 470... 5 725	16	1.5	<18	
WLAN	IEEE 802.11a/n/ac	5 GHz	5 725... 5 825	16	1.5	<18	

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το QuikRead go Plus Instrument εμφανίζει μηνύματα σφάλματος και καθοδηγεί τον χρήστη σε περίπτωση που ανιχνεύσει σφάλματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και ανατρέξτε στον πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων στις παρούσες οδηγίες χρήσης του και QuikRead go.

Σημείωση! Για περισσότερη υποστήριξη σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση aidian.eu ή επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή.

Μήνυμα σφάλματος / Αντιμετώπιση προβλημάτων	Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος με το μήνυμα «Επανεκκινήστε το QuikRead go Plus».	Προσωρινή δυσλειτουργία του οργάνου.	Επανεκκινήστε το όργανο. Εάν αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται συχνά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος με το μήνυμα «Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών».	Μόνιμη δυσλειτουργία του οργάνου.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, για να συνεχιστεί η λειτουργία.»	Είναι χαμηλή η φόρτιση της μπαταρίας.	Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στον σύνδεσμο τροφοδοσίας του QuikRead go Plus Instrument.
Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Η θέση της κυβέτας δεν είναι σωστή. Αφαιρέστε την κυβέτα.».	Έχουν απομείνει υπολείμματα από το φύλλο σφράγισης κυβέτας στον δακτύλιο της κυβέτας.	Αφαιρέστε την κυβέτα όταν την ανυψώσει το όργανο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υπολείμματα κατά τη διενέργεια της επόμενης μέτρησης.
	Υπάρχει μηχανική δυσλειτουργία στο όργανο.	Ελέγχετε το πάνω στοιχείο. Εάν δεν ισχύει, επανεκκινήστε το όργανο. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Μήνυμα σφάλματος / Αντιμετώπιση προβλημάτων	Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
«Απαγορεύεται η μέτρηση.»	Λείπει ένα πώμα αντιδραστηρίου ή χρησιμοποιείται μια κυβέτα.	Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει πώμα αντιδραστηρίου στην κυβέτα και ότι δεν είναι πιεσμένο το εσωτερικό χρωματιστό τρήμα του πώματος.
	Απέτυχε η ανάγνωση δεδομένων παρτίδας από τον γραμμωτό κώδικα.	Δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ακυρώστε τη δοκιμασία.
	Έληξε η παρτίδα κιτ.	Απορρίψτε τη ληγμένη παρτίδα κιτ. Χρησιμοποιήστε μια νέα.
	Η θερμοκρασία της κυβέτας είναι πολύ χαμηλή.	Αφήστε την κυβέτα να θερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Δοκιμάστε ξανά την ίδια κυβέτα.
	Η θερμοκρασία της κυβέτας είναι πολύ υψηλή.	Αφήστε την κυβέτα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Δοκιμάστε ξανά την ίδια κυβέτα.
«Η δοκιμασία ακυρώθηκε.»	Το τυφλό είναι πολύ υψηλό.	Δοκιμάστε ξανά την ίδια κυβέτα. Η διαδικασία μέτρησης τυφλού δεν έχει ολοκληρωθεί ή το δείγμα ενδεχομένως περιέχει παρεμβαλλόμενες ουσίες. Στη δεύτερη περίπτωση, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η δοκιμασία.
	Ασταθές τυφλό.	
	Σφάλμα όσον αφορά την προσθήκη αντιδραστηρίου.	Πραγματοποιήστε νέα δοκιμασία. Προέκυψε κάποιο πρόβλημα κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει κλείσει σωστά.
To QuikRead go Plus Instrument δεν εκκινείται.	Αποτυχία οργάνου.	Πραγματοποιήστε νέα δοκιμασία. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
	Δεν είναι συνδεδεμένη η μονάδα τροφοδοσίας.	Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας και δοκιμάστε ξανά.
	Η μπαταρία έχει αδειάσει.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και δοκιμάστε ξανά.
	Υπάρχει ηλεκτρονική δυσλειτουργία στο όργανο.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Μήνυμα σφάλματος / Αντιμετώπιση προβλημάτων	Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί σωστά.	Ο πίνακας αφής δεν ανταποκρίνεται καθόλου.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Δεν ακούγονται οι ήχοι συναγερμού του οργάνου.	Η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο.	Ρυθμίστε την ένταση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα «Γλώσσα, οθόνη, ήχος».
	Υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα ήχου του οργάνου.	Επανεκκινήστε το QuikRead go Plus Instrument. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει.	Είναι απενεργοποιημένος ο εκτυπωτής ή δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο εκτυπωτή ή υπάρχει δυσλειτουργία στον εκτυπωτή ή δεν είναι σωστές οι ρυθμίσεις.	Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος. Ελέγχτε τις ρυθμίσεις. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκκινήστε το όργανο και τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την εκτύπωση από το μενού Results (Αποτελέσματα). Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Η συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα δεν λειτουργεί.	Δεν είναι συνδεδεμένη η συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα ή υπάρχει δυσλειτουργία στη συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα ή δεν είναι σωστές οι ρυθμίσεις.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα είναι συνδεδεμένη. Ελέγχτε τις ρυθμίσεις. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκκινήστε το όργανο και επαναλάβετε την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται συχνά.	Η χωρητικότητα αποθήκευσης της μπαταρίας μειώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής της.	Αντικαταστήστε την παλιά μπαταρία με μια νέα, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα «Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας».
Εμφανίζεται μια προειδοποίηση σχετικά με την μπαταρία ρολογιού.	Η εσωτερική μπαταρία ρολογιού είναι άδεια.	Αντικαταστήστε την μπαταρία ρολογιού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα «Άλλαγή της μπαταρίας ρολογιού».

Δικαιώματα ρόλων χρήστη

Ενέργεια	Γενικός χρήστης	Διαχειριστής
Μέτρηση ασθενούς	X	X
Προβολή λίστας αποτελεσμάτων ασθενούς	- / X*	X
Προβολή λίστας αποτελεσμάτων LIS εκτός σύνδεσης	- / X*	X
Μέτρηση ποιοτικού ελέγχου	X	X
Προβολή αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου	X	X
Προσθήκη νέου αναγνωριστικού ελέγχου	X	X
Απαλοιφή όλων των πληροφοριών ασθενούς	-	X
Μεταφορά αποτελεσμάτων σε USB	- / X*	X
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	X**	X
Ορισμός κωδικού πρόσβασης διαχειριστή	-	X
Ρυθμίσεις	X***	X
Εξοικονόμηση ενέργειας	-	X
Προσωρινή αλλαγή: Εξοικονόμηση ενέργειας	X	-
Γλώσσα, φωτεινότητα οθόνης, ένταση	-	X
Προσωρινή αλλαγή: γλώσσα, φωτεινότητα οθόνης, ένταση	X	X
Συντήρηση	-	X
Συντήρηση: αρχείο καταγραφής σφαλμάτων	X***	X
Πληροφορίες	X***	X

*Εάν έχει ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή ** Μόνο τοπικός χρήστης. Υπάρχουν περιορισμοί όταν είναι ενεργή η λίστα απομακρυσμένων χειριστών. *** Μόνο προβολή

QuikRead go Plus

Aidian, QuikRead in QuikRead go sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Aidian Oy.

Aidian, QuikRead i QuikRead go su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Aidian Oy.

Aidian, QuikRead i QuikRead go zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Aidian Oy.

Οι ονομασίες Aidian, QuikRead και QuikRead go είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Aidian Oy.



Aidian Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, FI-02200 Espoo, Finland
P.O. Box 83, FI-02101 Espoo, Finland
+358 10 309 3000, aidian.eu

